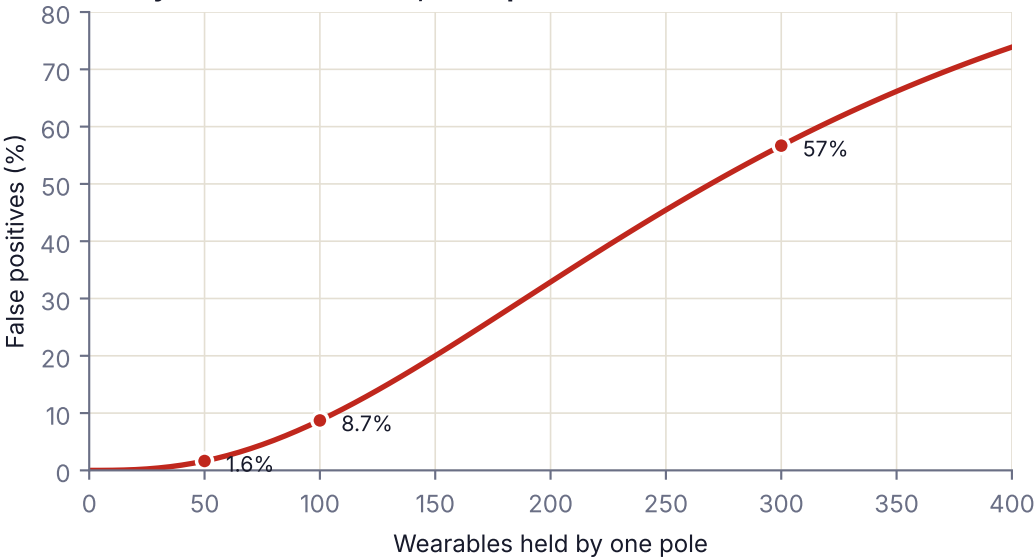
64-byte Bloom heartbeat, three probes (calculated)
False positives (%)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Wearables held by one pole
1.6%
8.7%
57%