검량선 보고서

검량선: Cal_NPOC(처리장검량선)_260402_0902
의 보정: 2026-04-02 오전 9:02:08 +0900 **매소드:** NPOC(처리장검량선)
디렉토리: C:\ProgramData\IDC\multiWin\Calibration\2026\04
파일명: 260402090208.ajc

이용자: user1
보정 채널: **NPOC**
선형 회귀 [µg]: c = (k1·Ieff + k0) / V
k0 = 0.098505 k1 = 7.686E-4
잔류 표준 편차: 670.02AU
매소드 표준 편차: 1.03mg/l
매소드 변동 계수: 3.1224% **검출 한계:** 2.82mg/l
복제 품질: 0.99956 **검출 한계:** 5.64mg/l
상관 계수: 0.99978 **정량 한계:** 11.15mg/l

고정 시료 용량이 있는 보정: 500.0µl

번호	복제	C-공칭	m-공칭	I-네트	C-활성화	c-델타
BV	1-1			1,240AU/ml		
1	1-1	0.000mg/l	0µg	0!	0.197mg/l	
2	1-1	5.000mg/l	2.50µg	2,954AU	4.738mg/l	-5.24%
3	1-1	10.000mg/l	5.00µg	5,913AU	9.286mg/l	-7.14%
4	1-1	50.000mg/l	25.00µg	3.335E4AU	51.453mg/l	2.91%
5	1-1	100.000mg/l	50.00µg	6.449E4AU	99.326mg/l	-0.67%

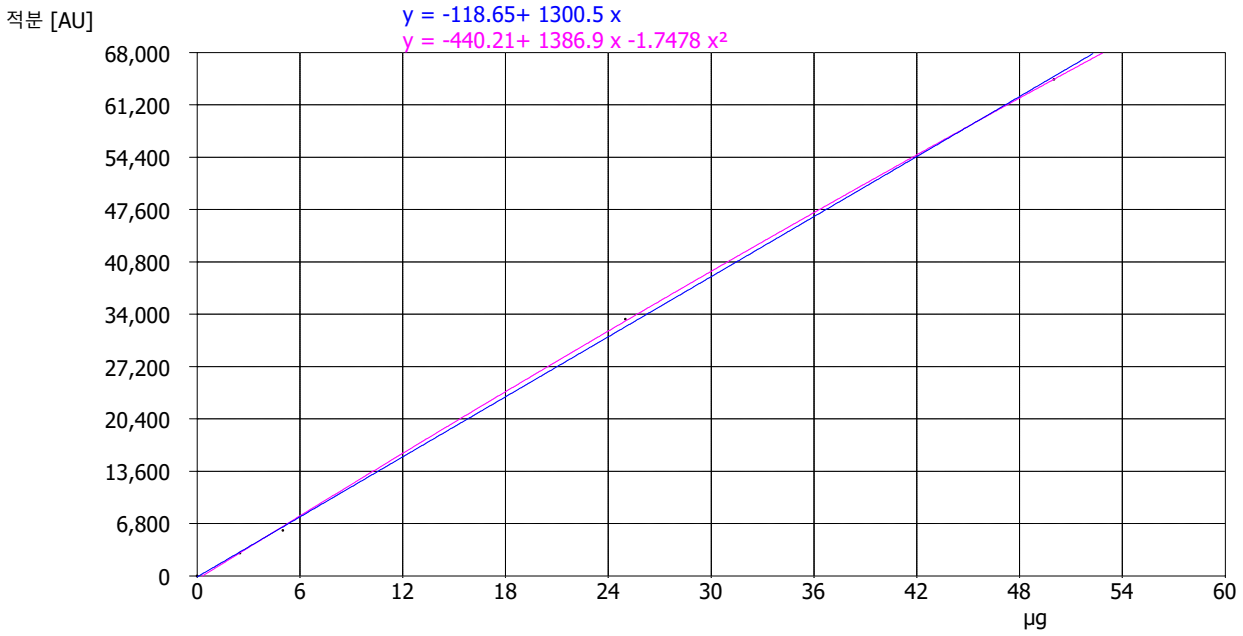

분석표

분석표: 260402처리장

시료 ID			분석 시간				래크 위치
매소드		변수	시료 용량	복제	희석제	종류	밀도
변수	농도 ± SD	적분 [AU]	검량선 기능				DF
BK			2026-04-02 오전 11:01:47				3
NPOC(처리장BK)		NPOC	1000µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	225.9µg/l	165.8AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	107.2µg/l	164.9AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
중흥농축기			2026-04-02 오전 11:16:10				4
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	45.29mg/l	1.166E4AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	2.08mg/l	640.7AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
중흥탈수기			2026-04-02 오전 11:28:04				5
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	35.86mg/l	9,204AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	2.08mg/l	640.4AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
중흥유입			2026-04-02 오전 11:40:10				6
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	57.32mg/l	1.479E4AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	2.08mg/l	641.4AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
중흥유량조정조			2026-04-02 오전 11:52:21				7
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	45.13mg/l	1.162E4AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	1.95mg/l	599.0AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
중흥기존침전지			2026-04-02 오후 12:04:26				8
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	17.56mg/l	4,441AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	1.41mg/l	434.0AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
중흥증설침전지			2026-04-02 오후 12:16:21				9
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	17.78mg/l	4,499AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	840.4µg/l	258.6AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
중흥기존응집침전지			2026-04-02 오후 12:27:49				10
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	15.90mg/l	4,008AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	919.3µg/l	282.9AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
중흥증설응집침전지			2026-04-02 오후 12:39:03				11
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	15.82mg/l	3,988AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	812.4µg/l	250.0AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
여과기			2026-04-02 오후 12:51:12				12
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	16.53mg/l	4,173AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	1.34mg/l	411.3AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
활성탄			2026-04-02 오후 1:04:03				13
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	16.01mg/l	4,038AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	1.22mg/l	374.6AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
중흥방류			2026-04-02 오후 1:15:28				14
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	14.86mg/l	3,737AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	694.2µg/l	213.6AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
월내농축기			2026-04-02 오후 1:29:07				15
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	63.74mg/l	1.646E4AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	5.74mg/l	1,767AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
월내탈수기			2026-04-02 오후 1:41:44				16
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	48.28mg/l	1.244E4AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	3.50mg/l	1,076AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
월내유입			2026-04-02 오후 1:53:17				17
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	70.50mg/l	1.822E4AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	4.74mg/l	1,457AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1

분석표

분석표: 260402처리장

시료 ID			분석 시간				래크 위치
매소드		변수	시료 용량	복제	희석제	종류	밀도
변수	농도 ± SD	적분 [AU]	검량선 기능				DF
월내유량조정조			2026-04-02 오후 2:05:17				18
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	55.67mg/l	1.436E4AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	3.14mg/l	966.0AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
월내침전지			2026-04-02 오후 2:18:21				19
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	45.72mg/l	1.177E4AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	3.07mg/l	946.0AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
월내가압부상조			2026-04-02 오후 2:32:01				20
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	30.59mg/l	7,832AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	2.10mg/l	646.3AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
월내방류			2026-04-02 오후 2:43:37				21
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	18.56mg/l	4,702AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	929.0µg/l	285.9AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
CCV			2026-04-02 오후 2:55:25				22
NPOC(처리장검량선)		NPOC	500.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	53.41mg/l	3.462E4AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	349.6µg/l	268.9AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
4단계농축기			2026-04-02 오후 3:09:14				23
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	61.52mg/l	1.588E4AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	643.5µg/l	198.0AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
4단계탈수기			2026-04-02 오후 3:21:39				24
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	59.97mg/l	1.548E4AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	414.7µg/l	127.6AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
4단계유입			2026-04-02 오후 3:35:10				25
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	68.71mg/l	1.775E4AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	2.11mg/l	648.6AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
4단계유량조정조			2026-04-02 오후 3:47:39				26
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	52.72mg/l	1.359E4AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	1.88mg/l	578.9AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
4단계침전지			2026-04-02 오후 3:59:53				27
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	16.18mg/l	4,081AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	958.9µg/l	295.0AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
4단계가압부상조			2026-04-02 오후 4:12:09				28
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	16.14mg/l	4,072AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	1.26mg/l	389.1AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
4단계방류			2026-04-02 오후 4:24:23				29
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	9.38mg/l	2,313AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	541.6µg/l	166.6AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
율촌유입			2026-04-02 오후 4:35:50				30
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	32.12mg/l	8,229AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	1.11mg/l	341.6AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
율촌분배조			2026-04-02 오후 4:47:49				31
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	30.89mg/l	7,911AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	701.9µg/l	216.0AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
율촌기존고후			2026-04-02 오후 5:05:01				32
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	24.63mg/l	6,280AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	1.13mg/l	348.7AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1

분석표

분석표: 260402처리장

시료 ID			분석 시간				래크 위치
매소드		변수	시료 용량	복제	희석제	종류	밀도
변수	농도 ± SD	적분 [AU]	검량선 기능				DF
율촌증설고후			2026-04-02 오후 5:18:37				33
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	19.90mg/l	5,051AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	621.9µg/l	191.3AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
율촌방류			2026-04-02 오후 5:30:10				34
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	7.99mg/l	1,952AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	708.9µg/l	218.1AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
세풍유입			2026-04-02 오후 5:42:17				35
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	8.52mg/l	2,088AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	375.1µg/l	115.4AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
세풍분배조			2026-04-02 오후 5:53:28				36
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	8.76mg/l	2,152AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	352.7µg/l	108.5AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
세풍방류			2026-04-02 오후 6:06:52				37
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	4.54mg/l	1,054AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	604.6µg/l	186.0AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
24시펌프			2026-04-02 오후 6:19:14				38
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	84.17mg/l	2.177E4AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	2.66mg/l	817.0AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
07시펌프			2026-04-02 오후 6:32:11				39
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	82.88mg/l	2.144E4AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	4.26mg/l	1,310AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
중흥무산소조유입(기존)100			2026-04-02 오후 6:44:41				40
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	5.95mg/l	1,421AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	874.0µg/l	268.9AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
중흥무산소조유입(증설)100			2026-04-02 오후 6:57:59				41
NPOC(처리장시료)		NPOC	200.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	3.24mg/l	714.4AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	597.5µg/l	183.9AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1
CCV			2026-04-02 오후 7:38:00				44
NPOC(처리장검량선)		NPOC	500.0µl	1 (1)	1 안에서 1	시료	
NPOC	53.44mg/l	3.464E4AU	c = (7.686E-4*I + 0.098505)/V				1
IC	230.7µg/l	177.5AU	c = (6.500E-4*I + 0)/V				1