CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Sistema de Recepción de Análisis de Laboratorio

SIRALAB

Manual de Usuario

Contenido

OBJETIVO. 3

MÓDULOS 3

1. ACCESO AL SISTEMA 4

Ingreso al Sistema. 5

2. LABORATORIO 9

2.1. Órdenes de Trabajo. 10

OBJETIVO.

Este documento contiene la descripción detallada de la funcionalidad del "Sistema de Recepción de Análisis de Laboratorio (SIRALAB) que permite registrar los resultados de los análisis de los laboratorios que cuenten con la acreditación de la entidad autorizada por la Secretaría de Economía y aprobación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con el objetivo de proporcionar al Sistema Integral de Recaudación y Fiscalización de la CONAGUA (SIRFIC) la información necesaria que sirva de insumo para las declaraciones de pago por concepto de derechos por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales.

OBJETIVO ESPECIFICO

- Presentar los módulos y controles de la aplicación, con el propósito de describir el funcionamiento del sistema.
- Guiar al usuario de Laboratorio para gestionar el envío de análisis.

PROPÓSITO

El presente documento va dirigido a los usuarios de laboratorios aprobados de la CONAGUA, responsables del envío de los resultados de análisis de los contribuyentes.

MÓDULOS


El sistema tiene el nombre: **Sistema de Recepción de Análisis de Laboratorio (SIRALAB)**. Consta de los siguientes módulos:

- ✓ Acceso al sistema.
- ✓ Registro de laboratorio.
- ✓ Laboratorio.

NOTA:
Para el correcto funcionamiento del Sistema de Recepción de Análisis de Laboratorio (SIRALAB) es necesario contar con la Version 7 Update 67 de Java o posterior.

1. ACCESO AL SISTEMA

Para tener acceso al Sistema de Recepción de Análisis de Laboratorio (SIRALAB), se debe ingresar a la siguiente dirección de Internet http://www.conagua.gob.mx/siralab/, a continuación se debe visualizar la siguiente pantalla:

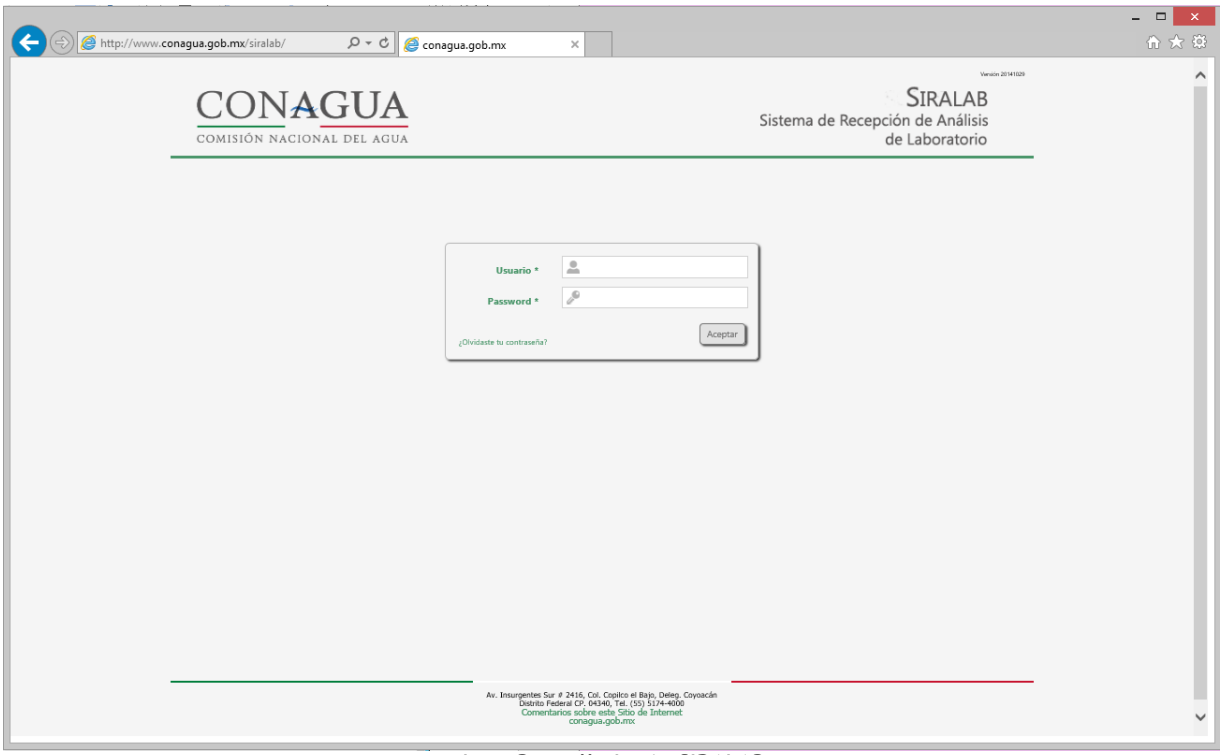


Img. Pantalla Login SIRALAB

Ingreso al Sistema.


Dentro de la página de acceso al sistema (Login) proporcionar los datos "**Usuario**" y "**Contraseña**", en seguida hacer clic sobre el botón "**Aceptar**" como se muestra a continuación:

NOTA: Al ingresar por primera vez, el "Usuario" y "Password" son el RFC del laboratorio.

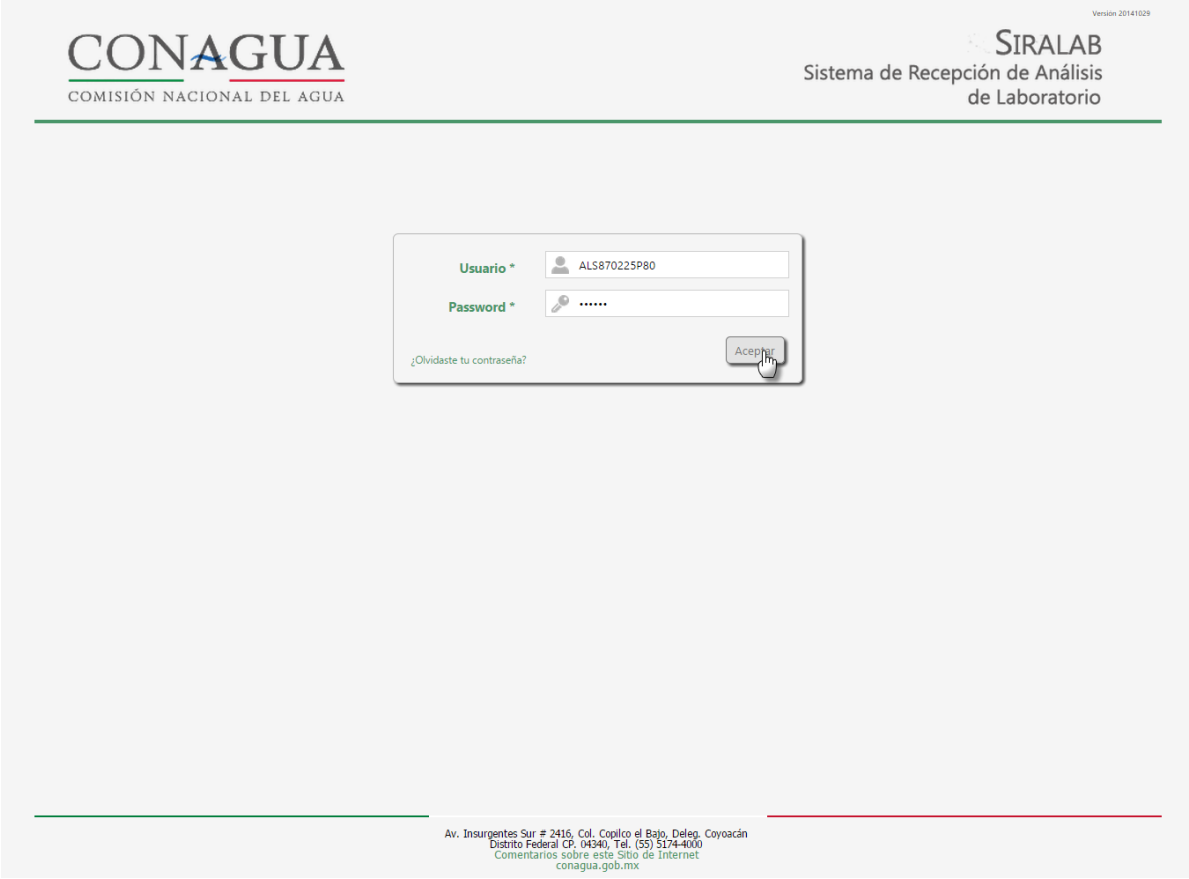


Img. Login.

Si no se proporcionan los datos "Usuario" y/o "Contraseña", la aplicación muestra un aviso de "Campo requerido" como se ve a continuación:

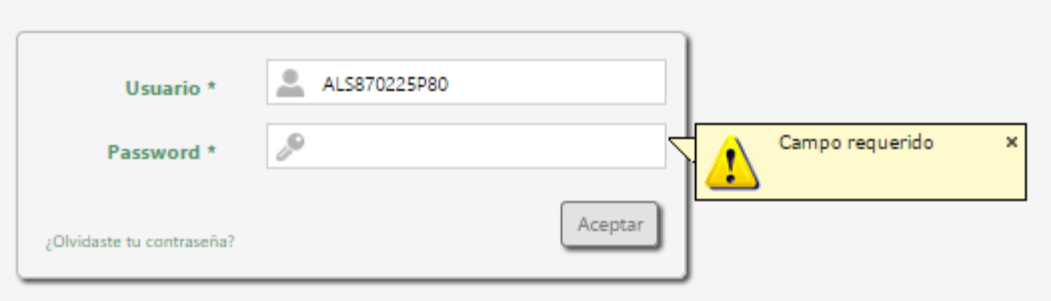

Img. Campo requerido.

Si se proporciona un usuario erróneo, el sistema muestra el siguiente mensaje de aviso:

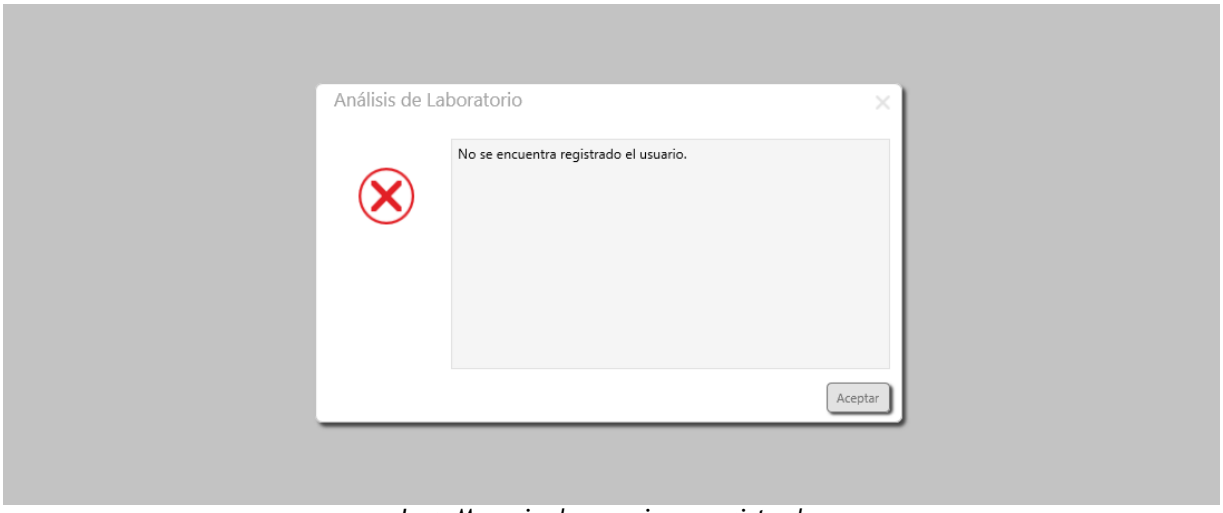


Img. Mensaje de usuario no registrado.

Hacer clic sobre el botón **"Aceptar"** para cerrar la ventana.

Si se proporcionan erróneamente el dato **"Password"**, el sistema envía el mensaje:

"Su contraseña de usuario no es correcta"

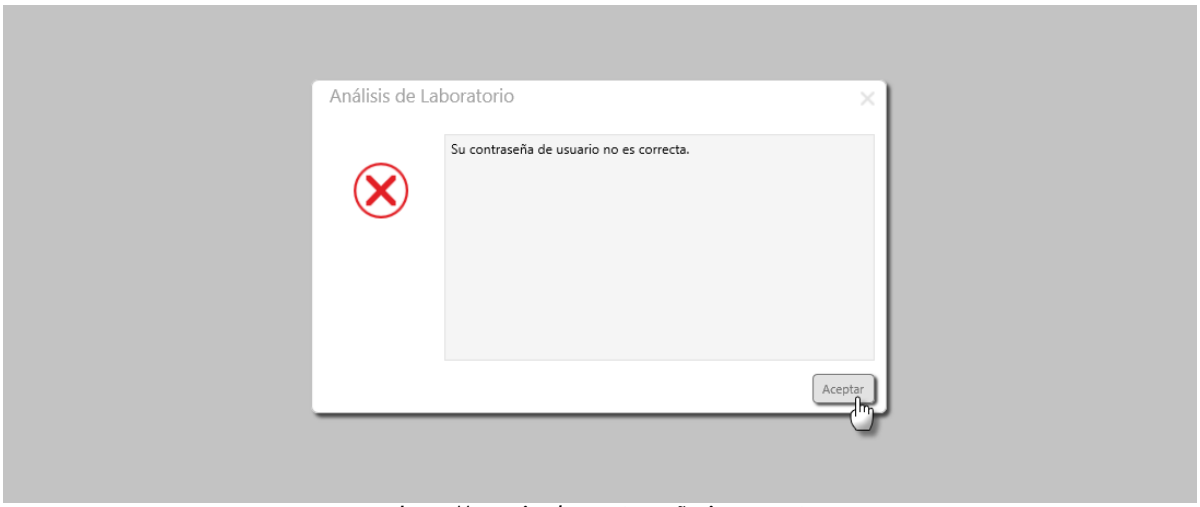

Img. Mensaje de contraseña incorrecta.


Hacer clic en el botón **"Aceptar"** para cerrar la ventana de aviso.

Una vez que el usuario de Laboratorio ingresa al SIRALAB, se presenta la siguiente pantalla:



Img. Pantalla de inicio SIRALAB.

En donde se tienen los siguientes elementos y funciones:

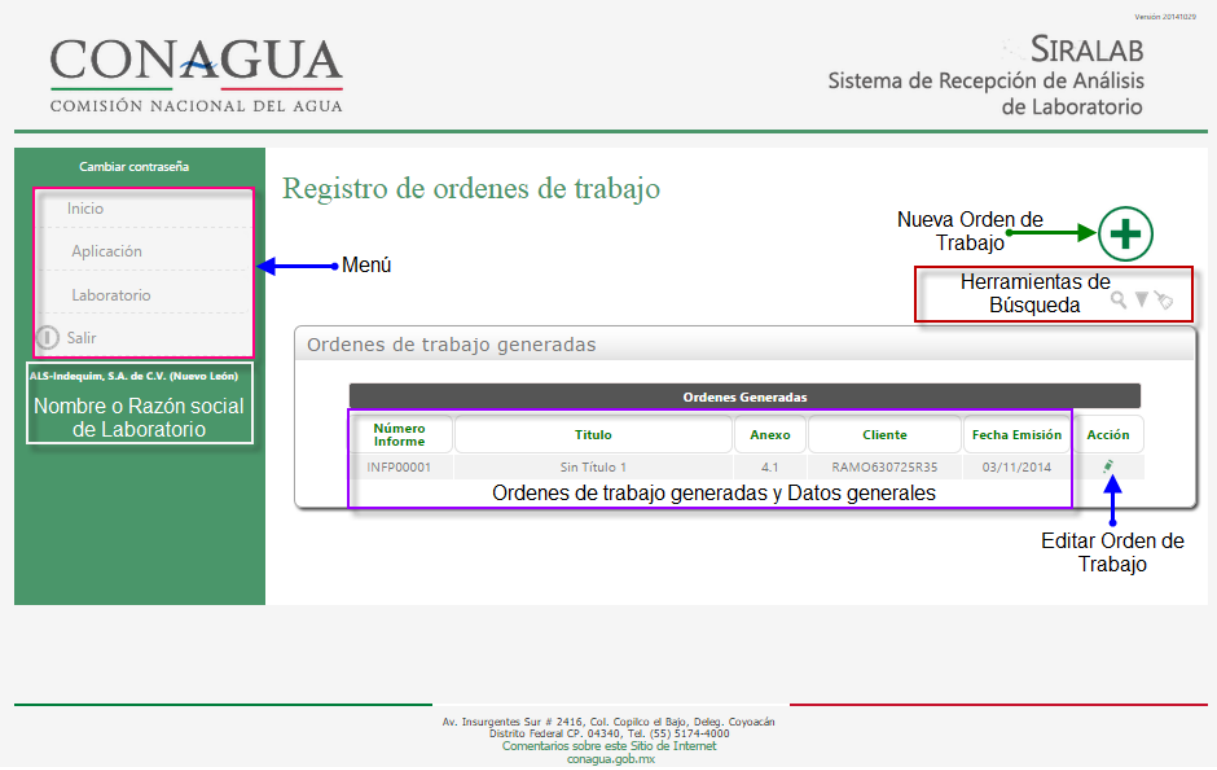

Img. Elementos de la pantalla de Inicio.

El menú del Sistema de Recepción de Análisis de Laboratorio (SIRALAB) cuenta con la siguiente estructura:

- **Inicio.** Al seleccionar ésta opción, el sistema se sitúa en la pantalla principal del sistema sin importar en qué módulo se esté trabajando o consultando información.
- **Aplicación.** Al seleccionar ésta opción se despliegan dos opciones:
  - **Inicio.** Al seleccionar ésta opción, el sistema se sitúa en la pantalla principal del sistema sin importar en qué módulo se esté trabajando o consultando información.
  - **Salir.** Esta opción cierra la sesión del Laboratorio y regresa a la pantalla Login.
- **Laboratorio.** Ésta opción cuenta con dos opciones adicionales:
  - **Clientes.** Ésta opción permite realizar
    - **Búsqueda de clientes.**
    - **Agregar un nuevo cliente.**
  - **Ordenes de trabajo.** Enlista las órdenes de trabajo generadas.
- **Salir.** Esta opción cierra la sesión del Laboratorio y regresa a la pantalla Login.

2. LABORATORIO

El módulo **"Laboratorio"** cuenta con la opción "Ordenes de Trabajo", como se muestra a continuación:



Img. Opción Laboratorio.

2.1. Ordenes de Trabajo.

La opción Órdenes de Trabajo permite:

2.1.1. Agregar Órdenes de Trabajo.
2.1.2. Editar Órdenes de Trabajo.
2.1.3. Buscar Órdenes de Trabajo.

2.1. Órdenes de Trabajo.

Para ingresar a la opción Órdenes de Trabajo hacer clic en la opción **"Laboratorio"** del menú:



Img. Seleccionar opción Laboratorio.

Posteriormente seleccionar la opción **"Órdenes de Trabajo"**:



Img. Seleccionar opción Órdenes de trabajo.

Una vez que se ha ingresado a dicha opción, se visualiza la siguiente pantalla:



Img. Pantalla de Ordenes de trabajo.

La opción Órdenes de Trabajo permite:

2.1.1. Agregar Órdenes de Trabajo.
2.1.2. Buscar Órdenes de Trabajo.
2.1.3. Consultar Órdenes de Trabajo.

2.2.1. Agregar Órdenes de Trabajo.

NOTA:


Para poder registrar y enviar a la CONAGUA, los resultados de los análisis de laboratorio, es necesario que le informe al contribuyente que ingrese al Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico "Declar@gua" (http://201.116.60.171/DECLARAGUA/) y registre o actualice sus datos en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes, pues de lo contrario el sistema no permitirá la captura y envío de la información.

Para agregar una orden de trabajo, hacer clic sobre el botón "Nueva orden de trabajo" ubicada en la página de Órdenes de Trabajo.



Img. Selección de Nueva Orden de Trabajo.

Después de haber seleccionado la opción de Nueva orden de trabajo, el sistema muestra la siguiente pantalla:

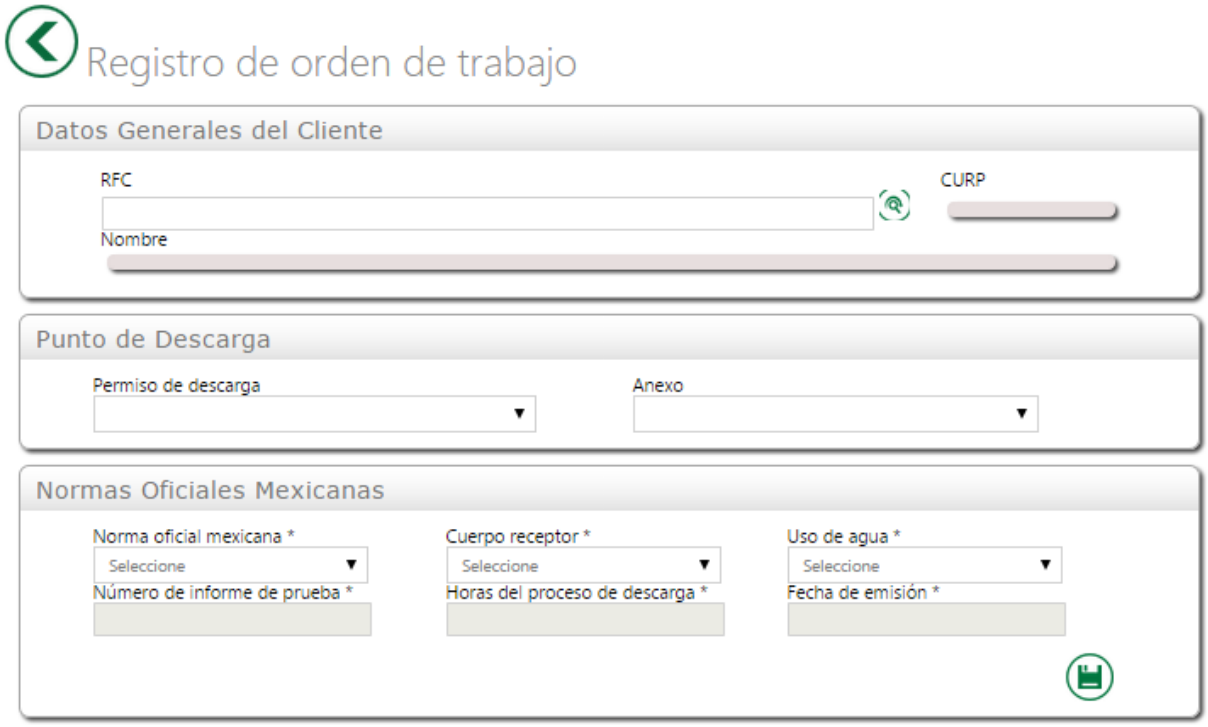


Img. Pantalla de captura de registro de orden de trabajo.

En donde se encuentran las siguientes secciones:

a) Datos generales del cliente.
b) Punto de descarga.
c) Normas Oficiales Mexicanas.

a) Datos generales del cliente.

En esta sección se captura el RFC del cliente:

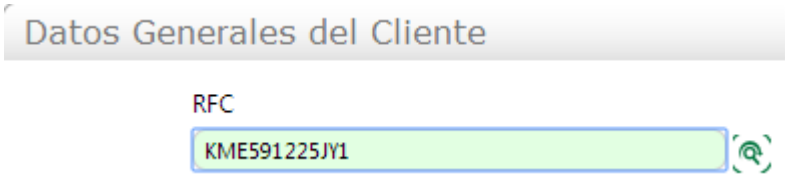

Img. Captura de RFC del cliente.


Después de realizar la captura del RFC, hacer clic sobre el icono de **"Buscar RFC"**:



Img. Buscar RFC.

El sistema realiza una validación del RFC, en el proceso de validación existen dos escenarios:


1. En caso de que el cliente no haya actualizado sus datos, se muestra el siguiente mensaje de error:

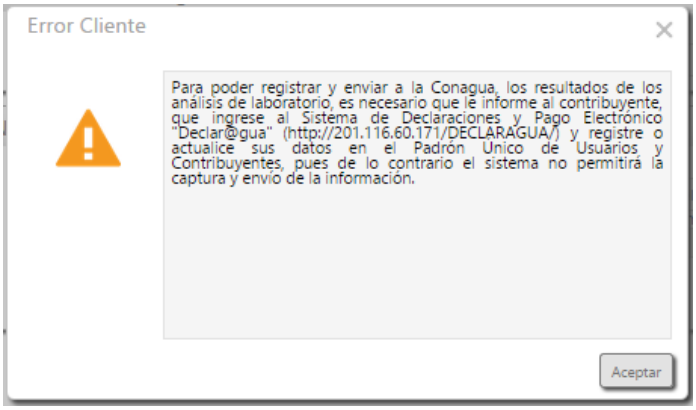

Img. Mensaje de error.


Hacer clic sobre el botón **"Aceptar"** para cerrar el mensaje.

2. Si el RFC proporcionado cuenta con los datos actualizados, el sistema captura los siguientes datos desde la información precargada en el registro del cliente:

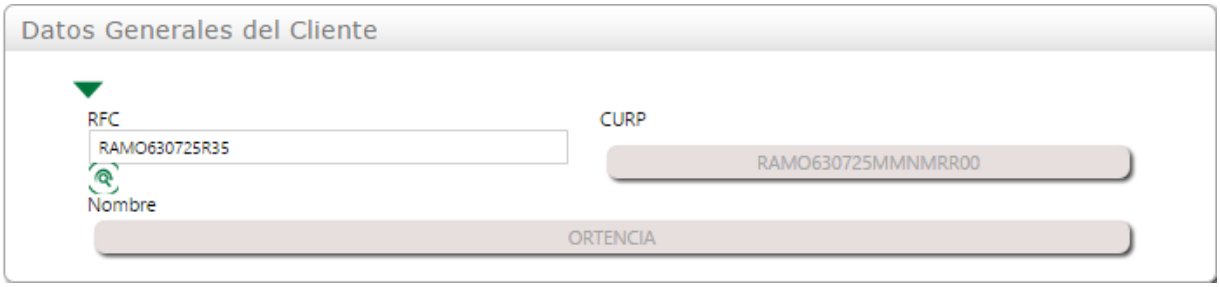


Img. Datos generales del cliente.

Hacer clic sobre la flecha verde para expandir la información completa del cliente.

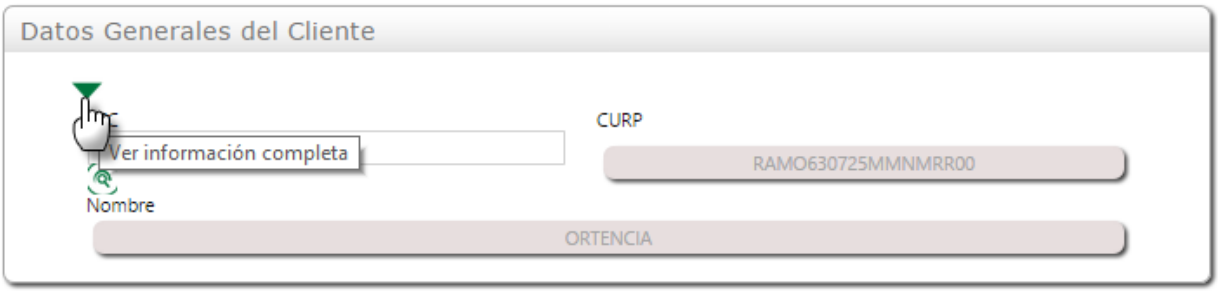


Img. Ver información completa del cliente.

El sistema incrementa el tamaño de la sección de Datos Generales y muestra la información completa:

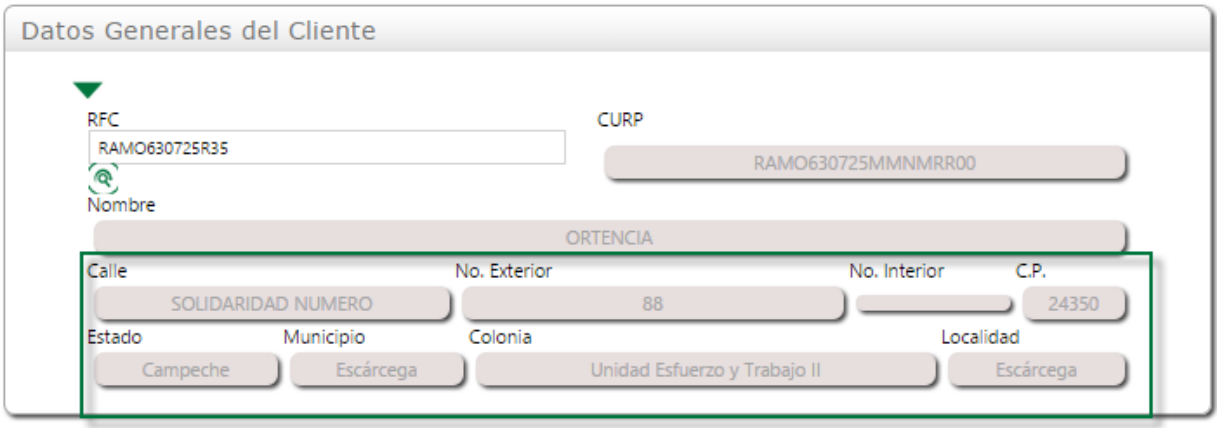

Img. Información completa.


El único dato editable es el RFC del Contribuyente:

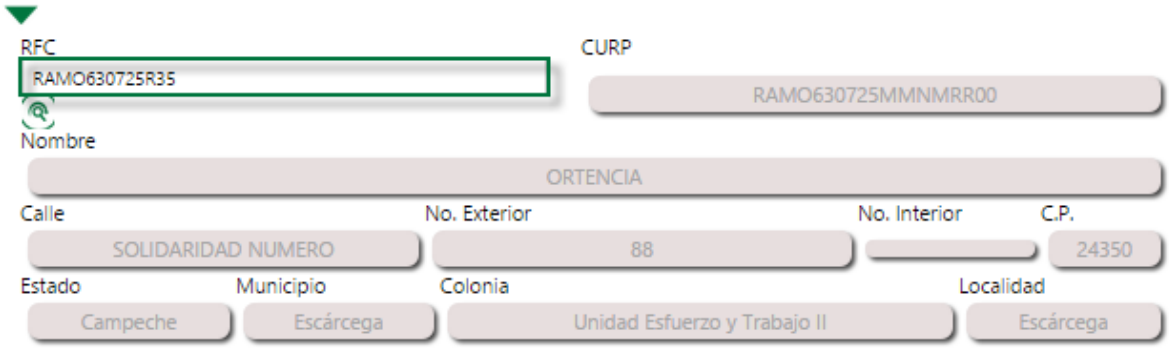

Img. RFC, dato editable.


Los datos del nombre y domicilio fiscal son inferidos desde el registro del cliente, por lo tanto no son editables en ésta sección.

A continuación capturar el **Punto de Descarga**:

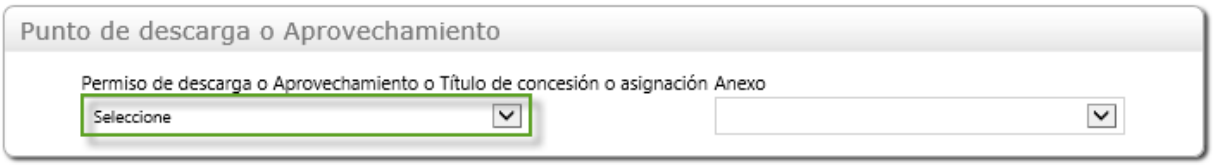


Img. Desplegar listado de Permiso de Descarga.

Al desplegar el campo de Permiso de descarga, aparecen los títulos asociados al contribuyente, seleccionar el título correspondiente:

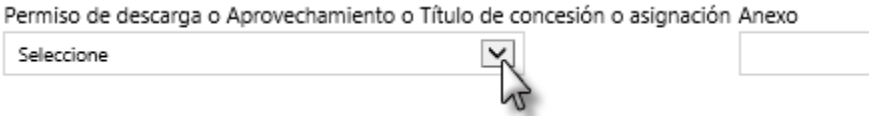


Img. Selección del Permiso de descarga.

Posteriormente seleccionar el **Anexo** (el anexo está asociado al título registrado):

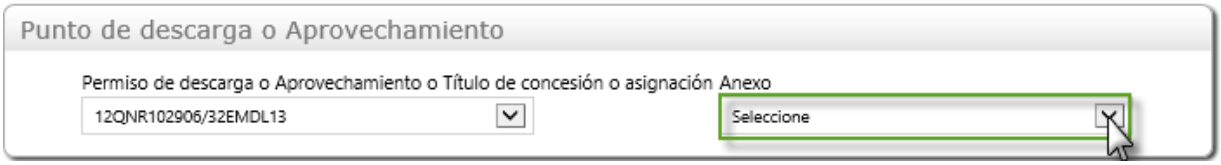

Img. Seleccionar listado Anexo.


Hacer clic sobre el Anexo correspondiente:

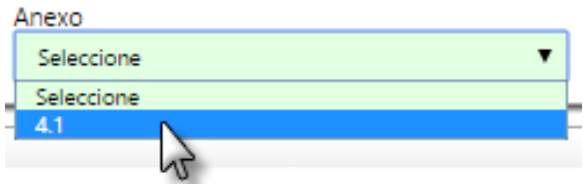

Img. Selección de Anexo.


Cuando se ha seleccionado el Anexo correspondiente, los campos que siguen en la sección de Punto de Descarga se infieren del registro previo de dicho título y anexo.

Para ver la información completa del punto de descarga, hacer clic sobre la flecha invertida de color verde:

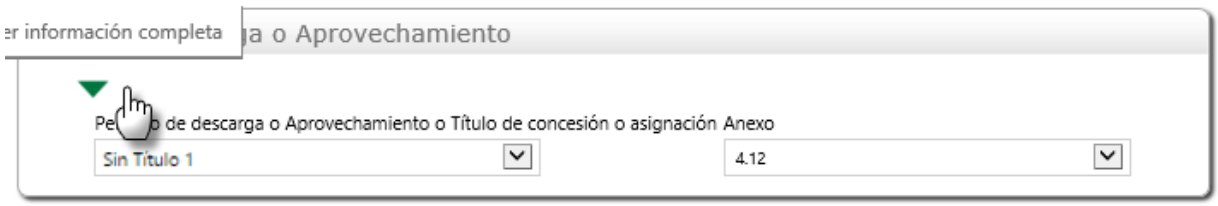

Img. Ver información completa de Punto de Descarga.


El sistema despliega la información completa del punto de descarga:

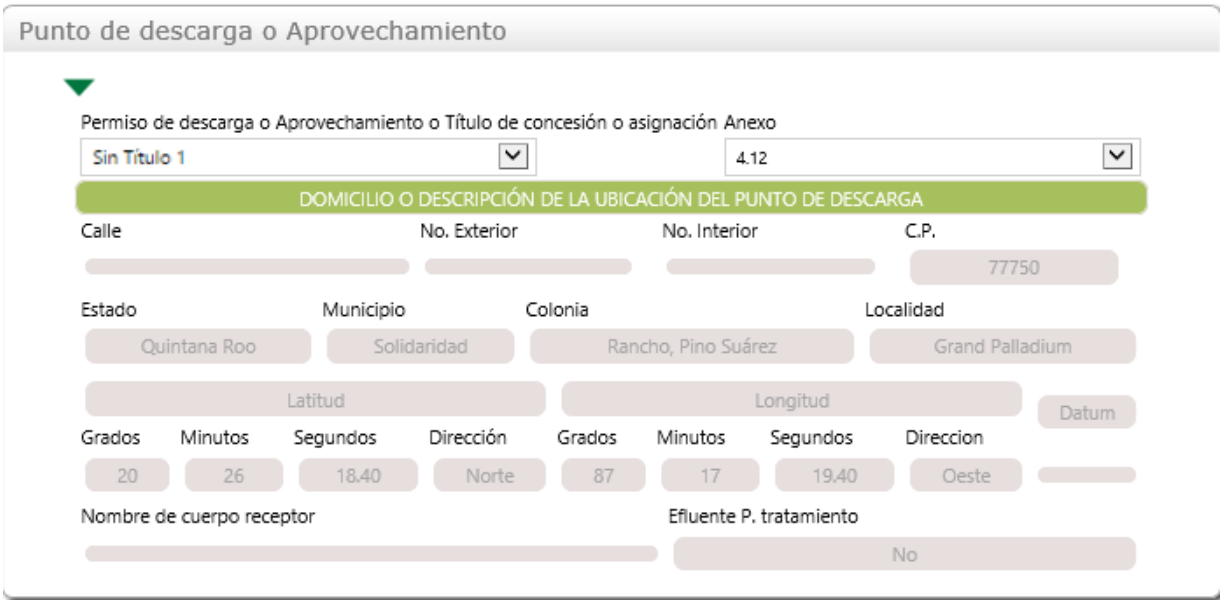

Img. Información completa del Punto de Descarga.

Hacer clic sobre el botón "**Guardar**" para registrar los cambios:

El siguiente paso para registrar la orden de trabajo, es capturar la información relacionada con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), la ventana de captura se visualiza como se muestra a continuación:

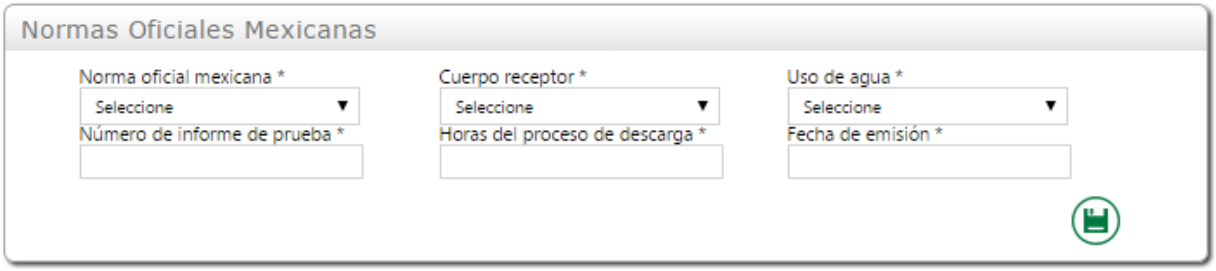


Img. Sección de NOM

Nota:

Existen diferentes combinaciones posibles en ésta sección, ya que cada campo ofrece valores a seleccionar según las opciones seleccionadas en los campos antecesores.


Para efectos de éste ejemplo, se toma en cuenta sólo una combinación.

Seleccionar una Norma Oficial Mexicana, para ver el listado de NOM hacer clic sobre la flecha color negro:

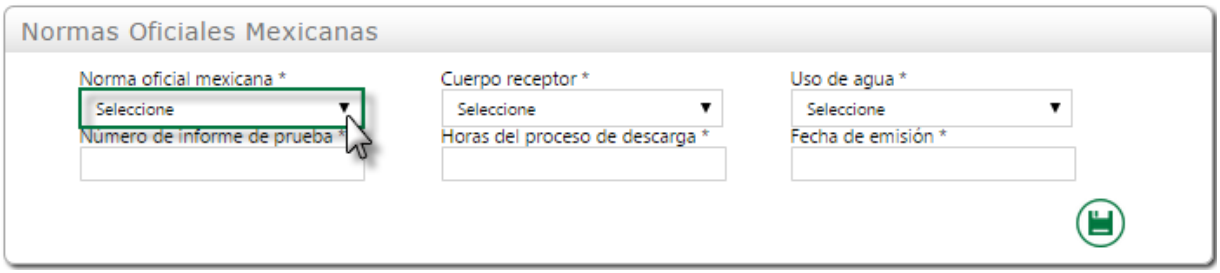


Img. Desglosar listado de NOM

Seleccionar Norma oficial mexicana:




Img. NOM

Seleccionar Cuerpo receptor:

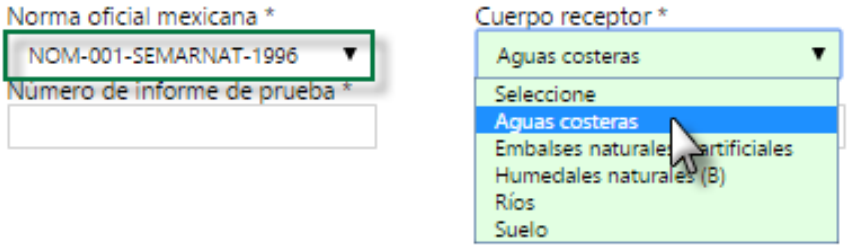


Img. Selección de cuerpo receptor.

Seleccionar Uso de Agua:

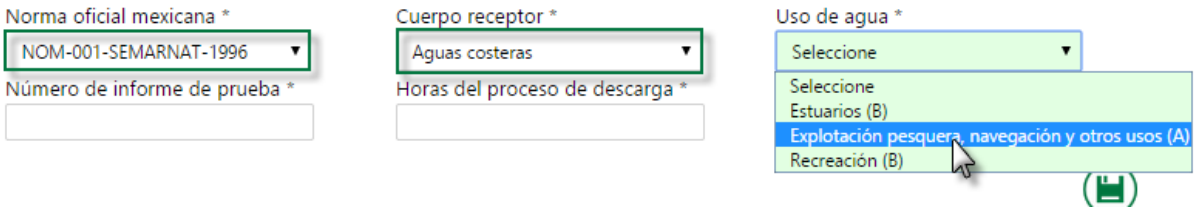


Img. Selección de Uso de agua.

Posteriormente capturar el Número de informe de prueba y Horas del proceso de descarga:

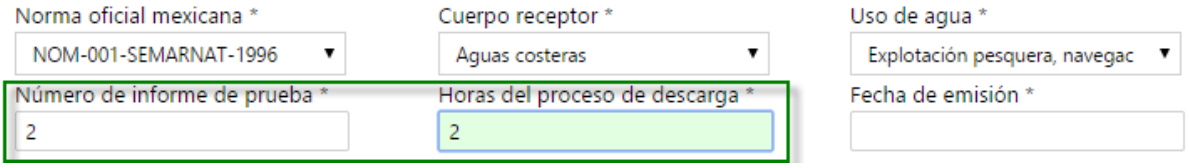

Img. Captura datos.

A continuación se debe seleccionar la Fecha de emisión, para esto, al hacer clic sobre el cuadro de texto perteneciente al campo, el sistema muestra una ventana emergente de calendario, como se muestra a continuación, ubicando el calendario en la fecha en curso:

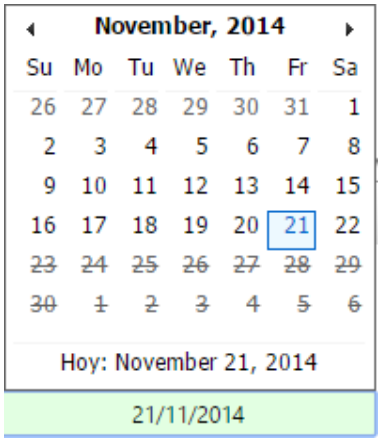

Img. Fecha de emisión.

Los días posteriores al día actual se encuentran inhabilitados, por lo que la selección de la fecha sólo puede ser del día en curso o una fecha anterior.

Con esto se ha terminado el registro de orden de trabajo:



Img. Registro de orden de trabajo.

Hacer clic sobre el botón **"Guardar"** para almacenar el registro de datos:




Img. Guardar OT

El sistema ejecuta la acción y muestra el siguiente mensaje de aviso con la leyenda:


Orden de trabajo generada exitosamente

Hacer clic sobre el botón **Aceptar** para cerrar el mensaje de aviso como se muestra a continuación

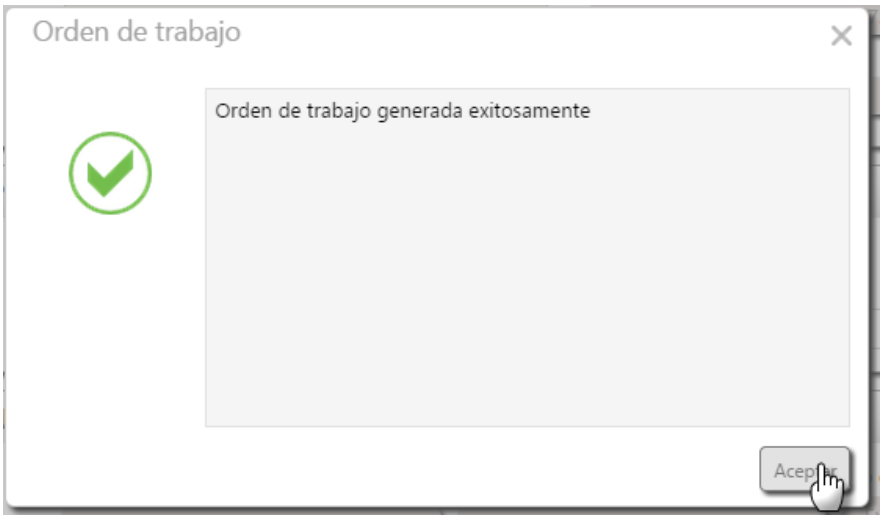

Img. Mensaje de aviso.


Una vez que se ha guardado la Orden de Trabajo, se muestra la siguiente pantalla con los siguientes elementos:

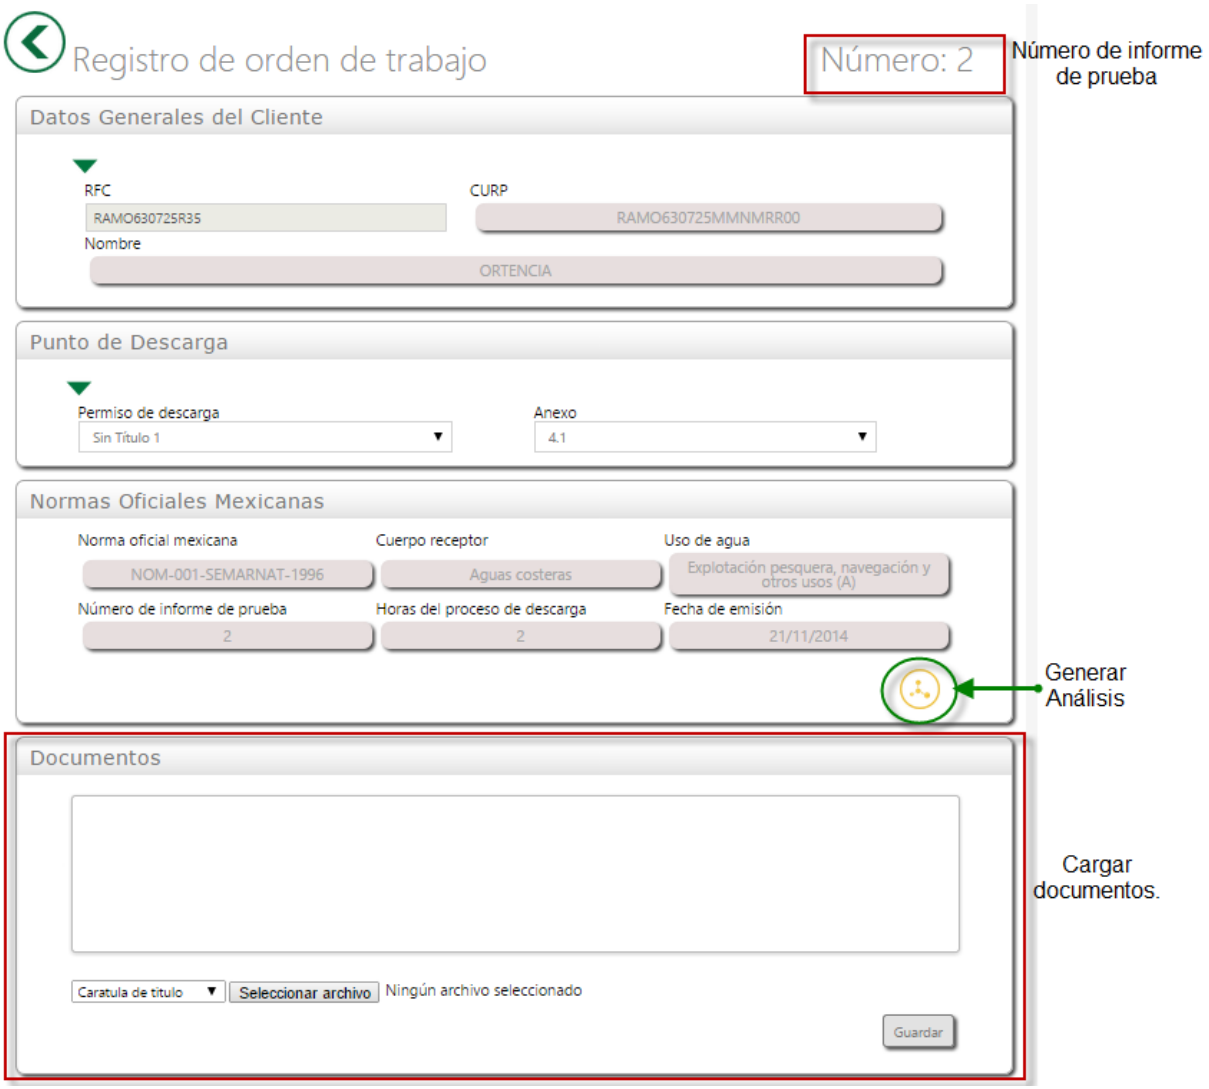

Img. Orden de trabajo generada.


- **Generar análisis.**

Para generar un análisis, hacer clic sobre el botón situado en la sección de Normas Oficiales Mexicanas:

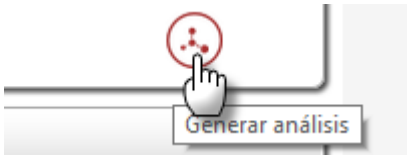

Img. Generar análisis.

Al ejecutar la acción el sistema genera el análisis y muestra la siguiente ventana de aviso:

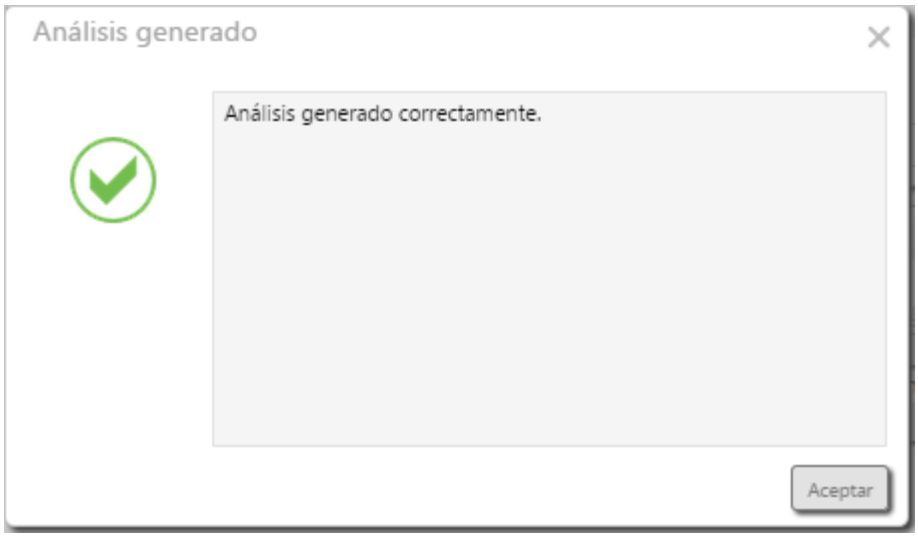

Img. Notificación de análisis.

Hacer clic sobre el botón **Aceptar** para cerrar la ventana.

Una vez que se ha generado el análisis, se muestra en la pantalla de "Registro de orden de trabajo" la sección **Análisis:**



Img. Análisis generados.

En donde se pueden realizar las siguientes acciones:



Img. Acciones del Análisis generado.


- **Editar análisis.**

Para editar un análisis, hacer clic sobre la opción **Editar:**



Img. Editar análisis


Al ejecutar la acción, el sistema muestra una nueva pantalla:

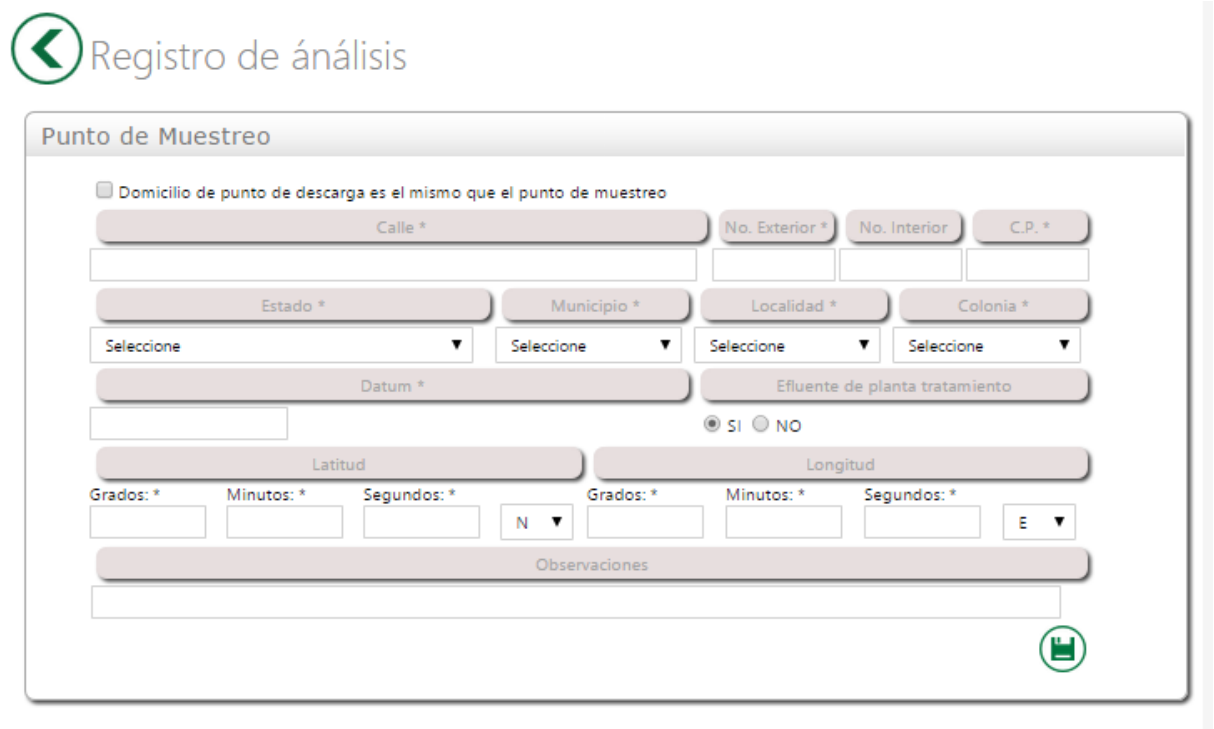

Img. Pantalla de Punto de muestreo.

Capturar los datos solicitados.


Si el domicilio de punto de descarga es el mismo que el punto de muestreo seleccionar la opción superior:

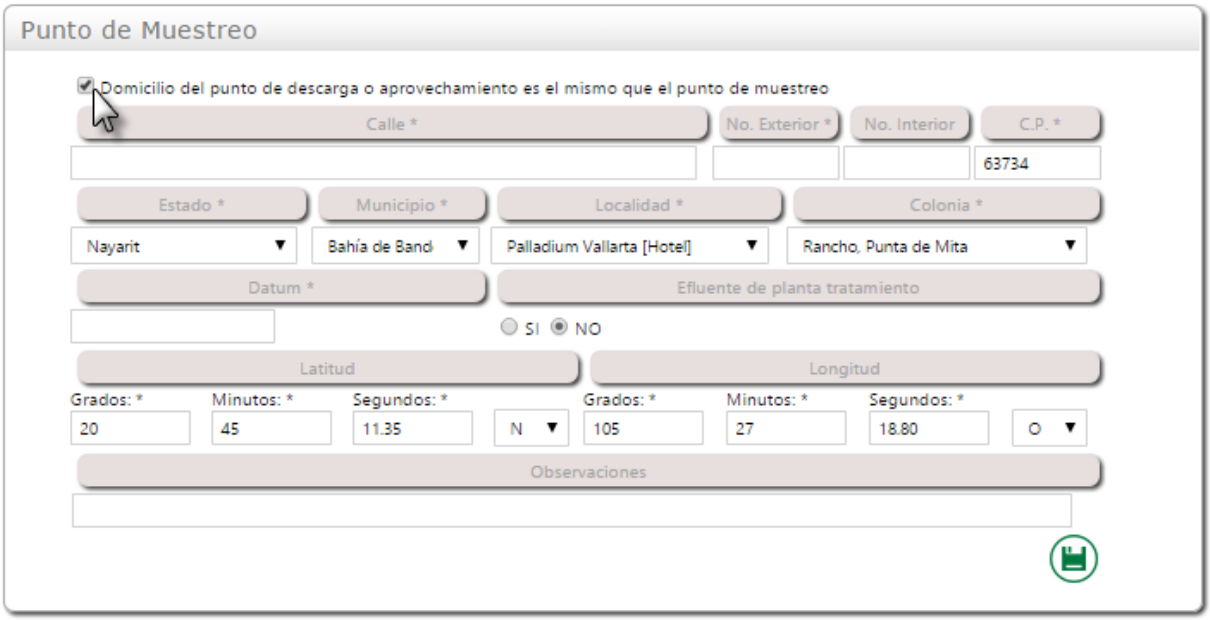

Img. Punto de muestreo.

Al seleccionar dicha opción los datos del formulario son extraídos de los datos del punto de descarga.

Se pueden editar los datos y agregar Observaciones.

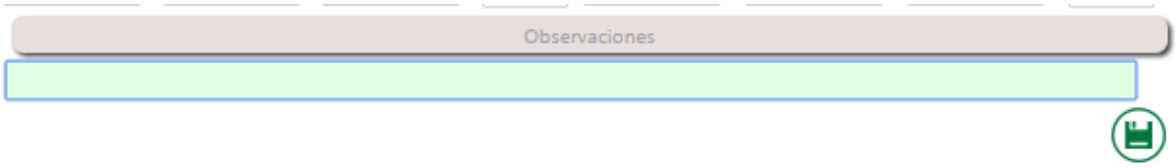

Img. Observaciones.

Hacer clic sobre la opción **"Guardar"**; el sistema envía un mensaje de aviso:



Img. Muestras generadas.

Hacer clic sobre el botón **Aceptar** para cerrar la ventana.

El sistema muestra la siguiente sección en la pantalla de Registro de Análisis:



Img. Muestras simples.

Hacer clic sobre la opción Editar para modificar los Datos de la muestra:



Img. Opción Editar.

El sistema muestra la siguiente pantalla tras seleccionar la opción Editar:



Img. Datos de la muestra.


En la primera sección de la pantalla son los Datos del Signatario.

- Si el laboratorio realiza el muestreo hacer clic sobre el botón de selección **Sí:**




Img. Datos del signatario.

Seleccionar entonces el Nombre del signatario:

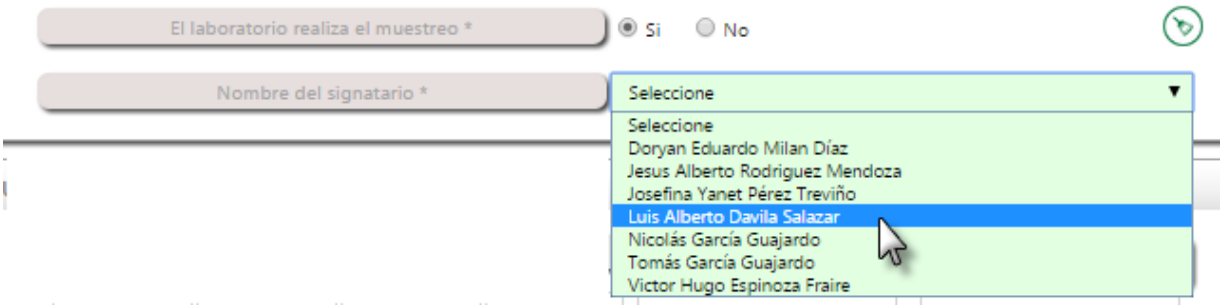


Img. Selección del nombre del signatario

- Si el laboratorio No realiza el muestreo:

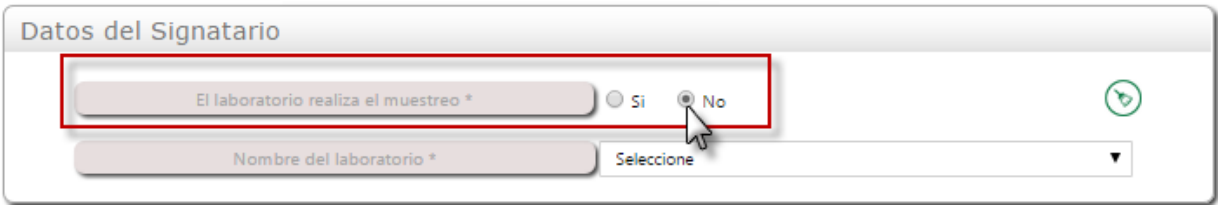


Img. Laboratorio no realiza muestreo.

Seleccionar entonces, el nombre del laboratorio que realizó el muestreo:

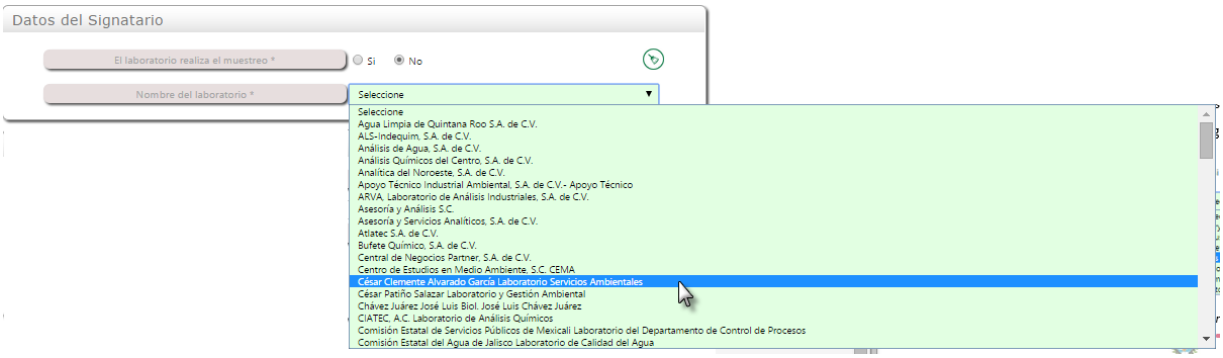


Img. Selección de laboratorio.

Y en seguida seleccionar el Nombre del signatario asociado al laboratorio seleccionado:

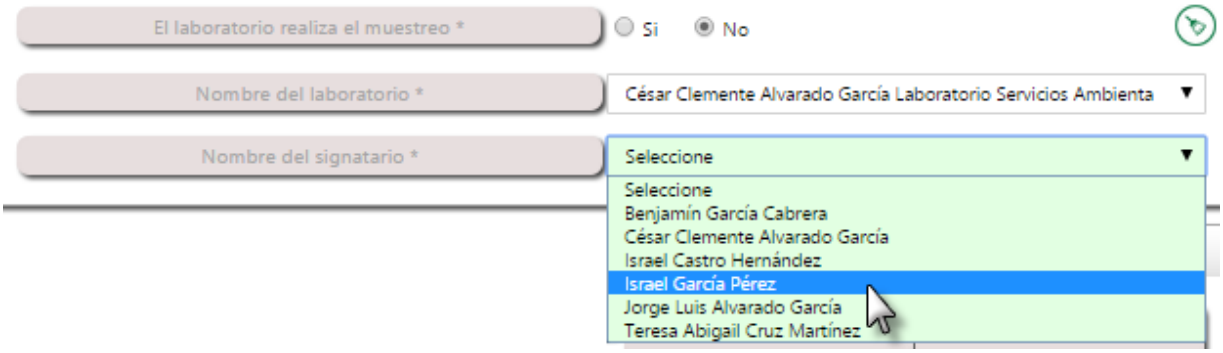


Img. Selección del nombre de signatario.

A continuación se encuentra la sección de Datos de la muestra:

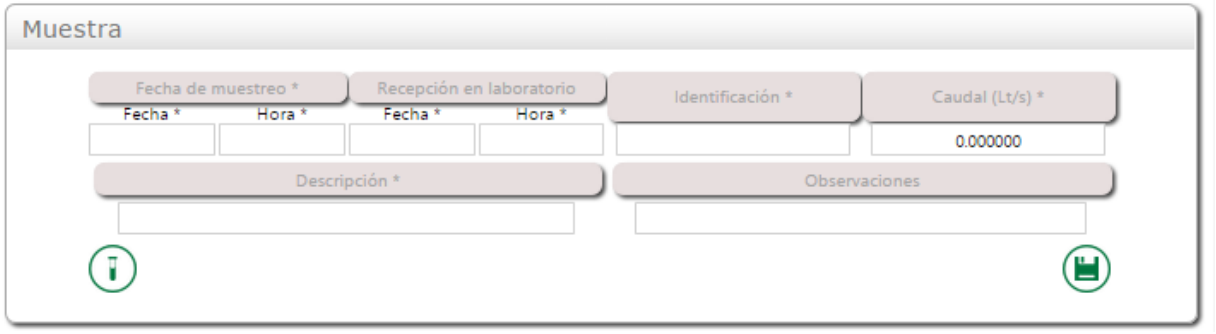

Img. Datos de muestra.

Capturar los datos de la muestra:

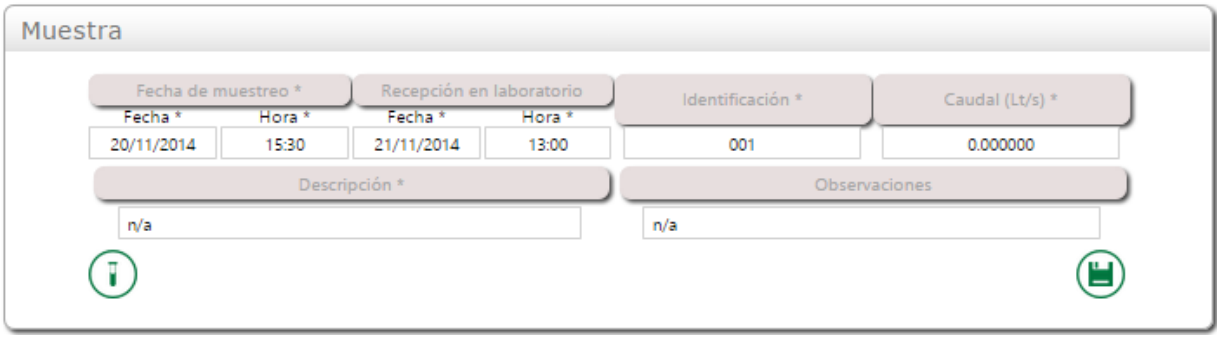


Img. Datos de muestra.

La sección de Muestra cuenta con dos opciones:

- Regresar a las muestras
- Guardar


Hacer clic sobre Guardar para registrar los cambios; el sistema muestra el siguiente mensaje de aviso:

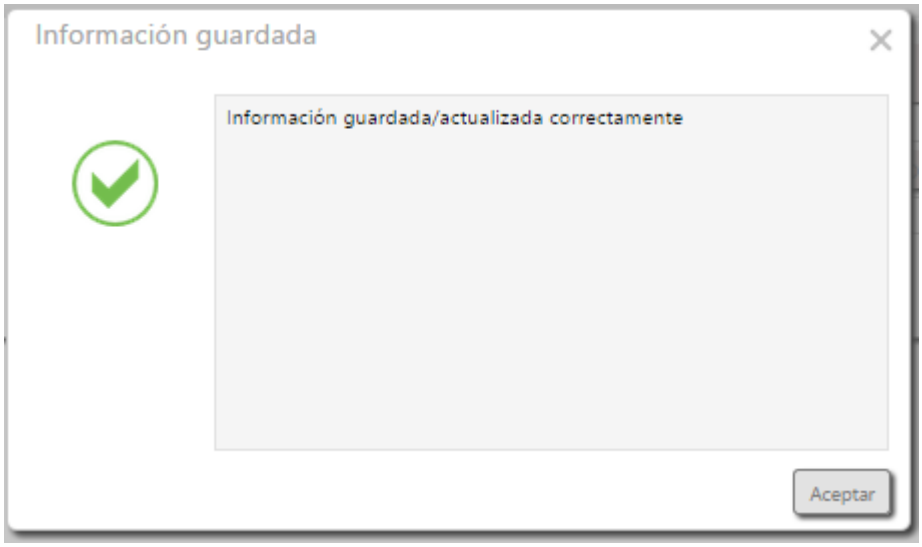

Img. Información guardada.

Hacer clic sobre el botón **Aceptar** para cerar la ventana.


En seguida, el sistema muestra una nueva sección en donde se encuentra una tabla de Parámetros:

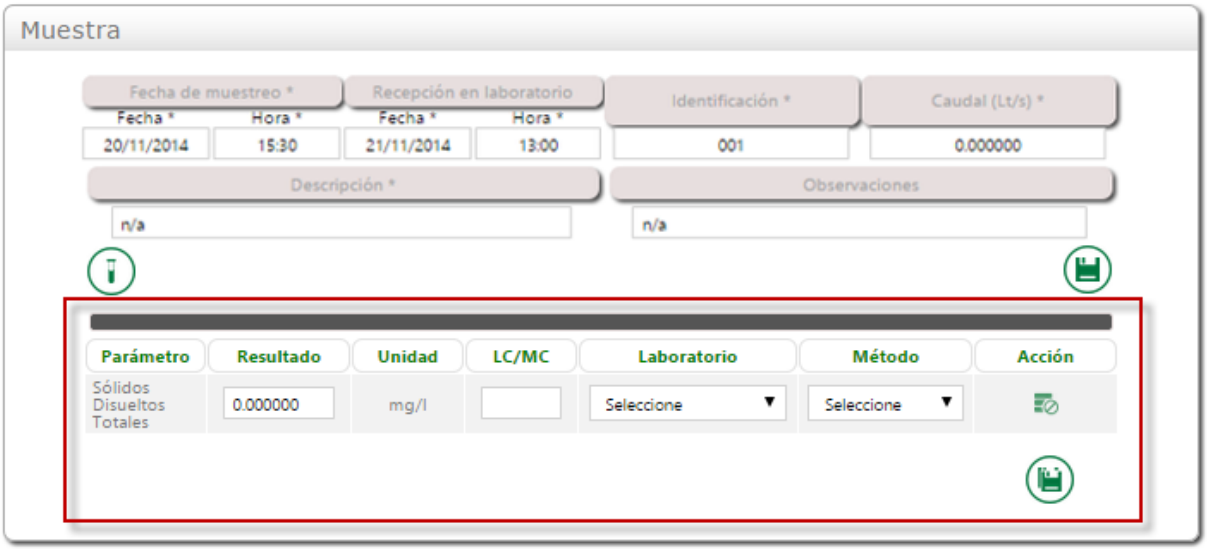

Img. Tabla de parámetros.

Capturar:

- Resultado.
- LC/MC
- Laboratorio.
- Método.
- Acción.
  - Exenta.
  - Parámetro no analizado.

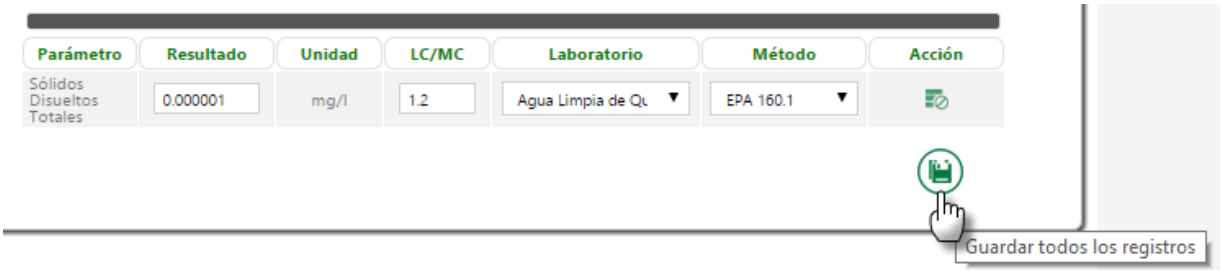

Img. Guardar registros.

El sistema se mantiene en la pantalla de Datos de la Muestra, hacer clic sobre la flecha hacia atrás para regresar a la página anterior.



Img. Regresar a la pantalla anterior.

Al regresar a la página antecesora, se muestra en la sección de Muestra simple, sus características:



Img. Datos de Muestra Simple.

Cargar la evidencia, para esto hacer clic sobre el botón “Documentos”:



Img. Cargar documentos.

Al ejecutar la acción el sistema muestra una ventana para realizar la carga de documentos:



Img. Carga de evidencia.

Seleccionar el documento a adjuntar, éste puede ser:

- Hoja de campo.
- Laboratorio de apoyo.




Img. Selección del tipo de documento.

Posteriormente hacer clic sobre el botón **"Seleccionar archivo"**:




Img. Seleccionar archivo.

El sistema muestra una ventana de exploración de archivos para realizar la búsqueda y selección de archivos:

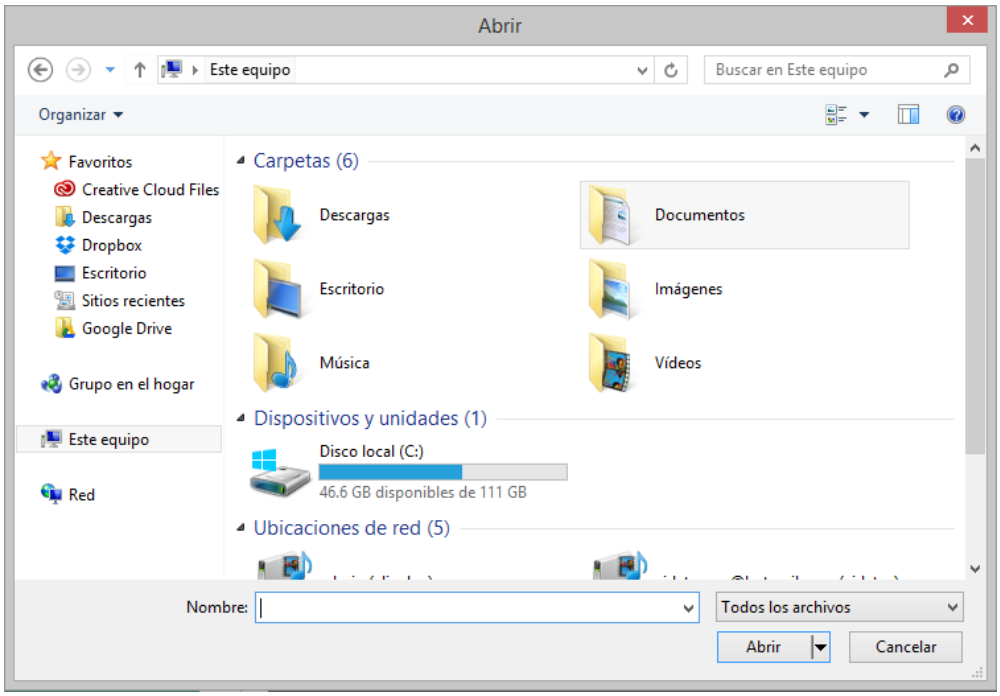


Img. Explorador de archivos.

Seleccionar documento:

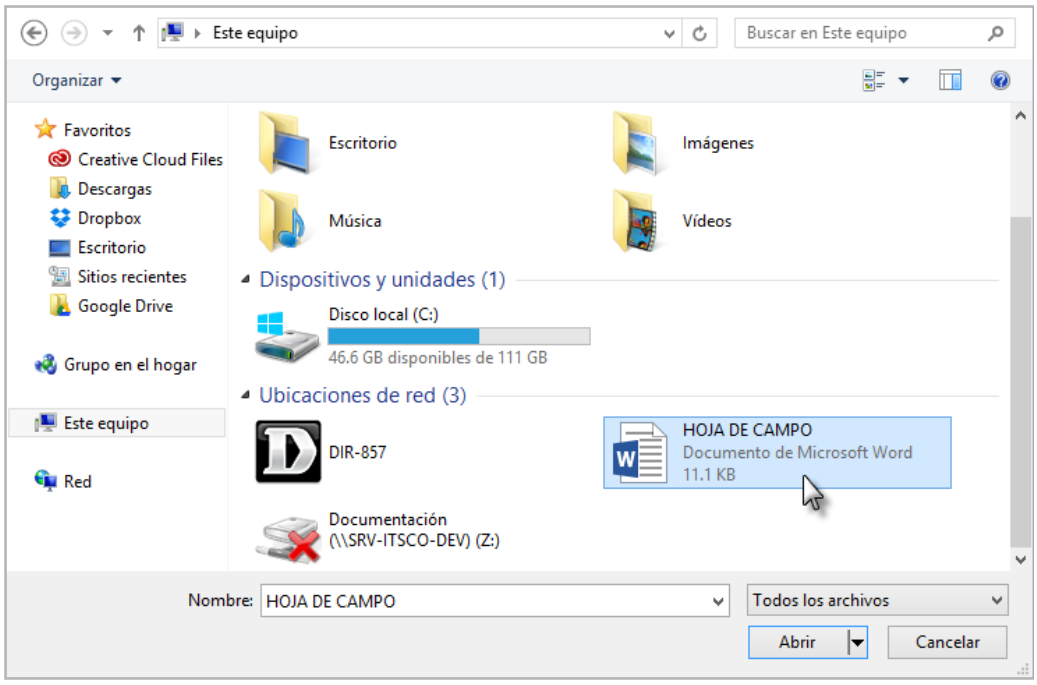


Img. Selección de Hoja de campo.

Hacer clic sobre la opción **Abrir:**

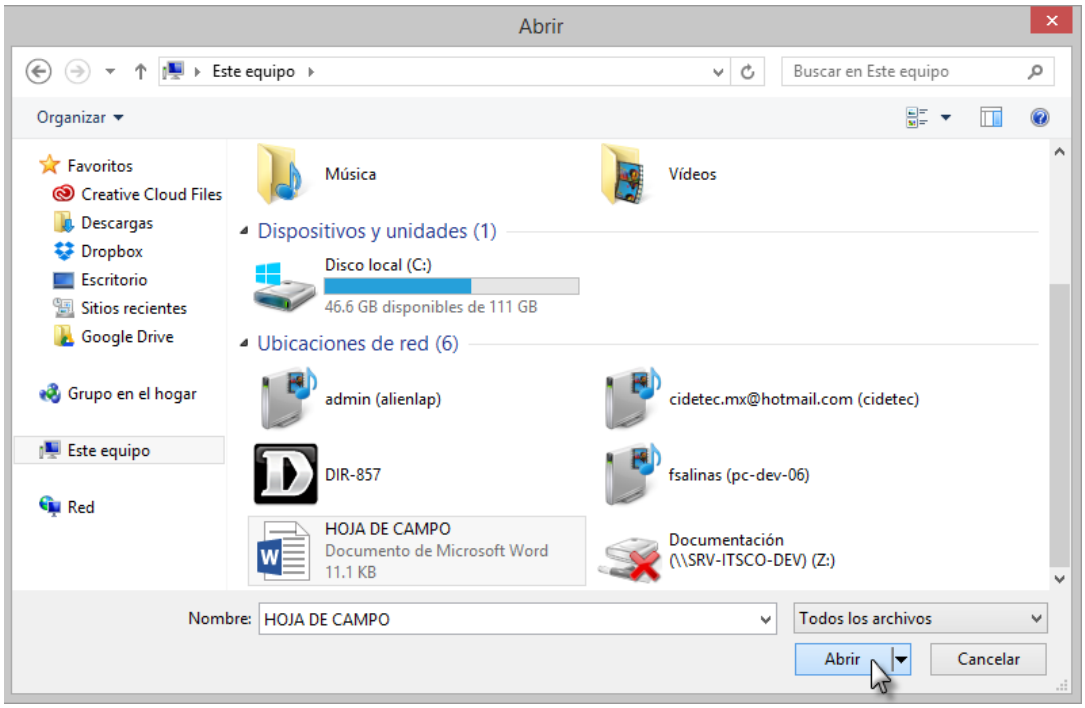


Img. Abrir documento.

Al hacer clic sobre el botón **Abrir** el sistema cierra la ventana de explorador de archivos y muestra el progreso de la carga de evidencia:

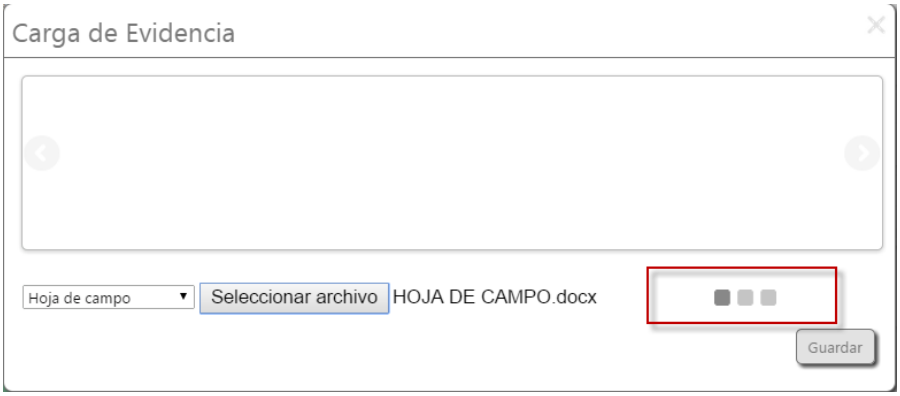

Img. Carga de evidencia.

Una vez que se ha cargado el archivo, se muestra el archivo cargado:

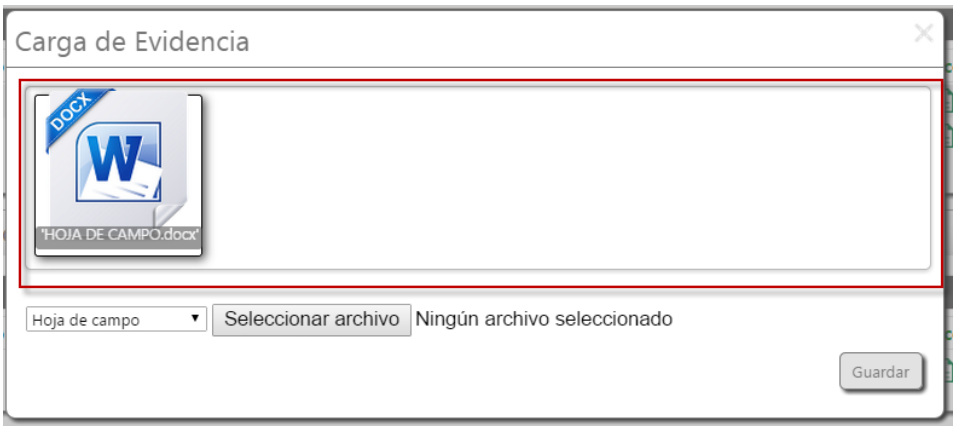

Img. Documento adjunto.

Adjuntar cuantos documentos sean necesarios.

Hacer clic sobre el botón **Guardar** para almacenar el documento cargado:



Img. Guardar cambios.

Editar todas las muestras:



Img. Edición de todas las muestras.

Cuando se han capturado todos los datos de las Muestras, hacer clic sobre el botón de la Matraz para generar muestra compuesta:




Img. Generar muestra compuesta.

El sistema envía un mensaje de aviso con la leyenda:

Muestra compuesta generada exitosamente.


Hacer clic sobre el botón **Aceptar** para cerrar la ventana:

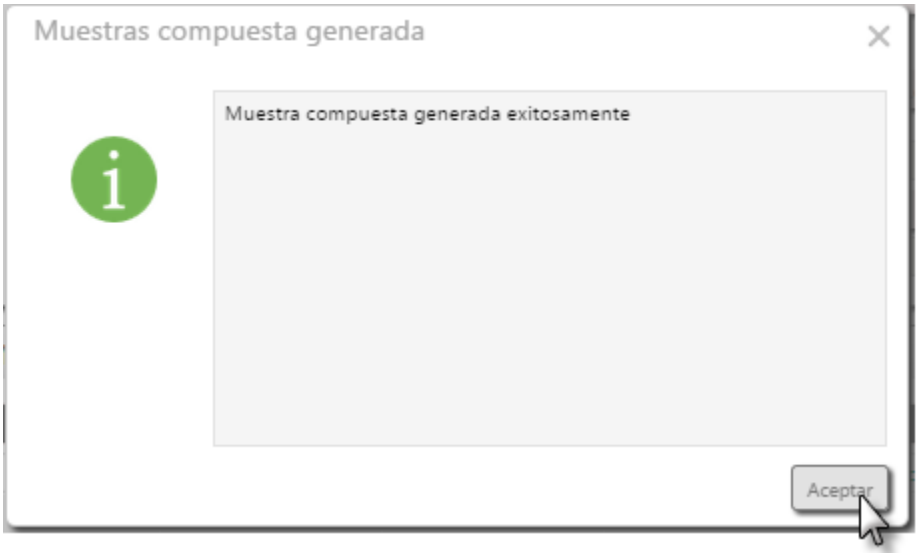

Img. Muestra compuesta generada.

Con esto se ha generado una muestra compuesta.

A continuación, en la pantalla de Registro de análisis, se muestra la sección “Muestra compuesta”:

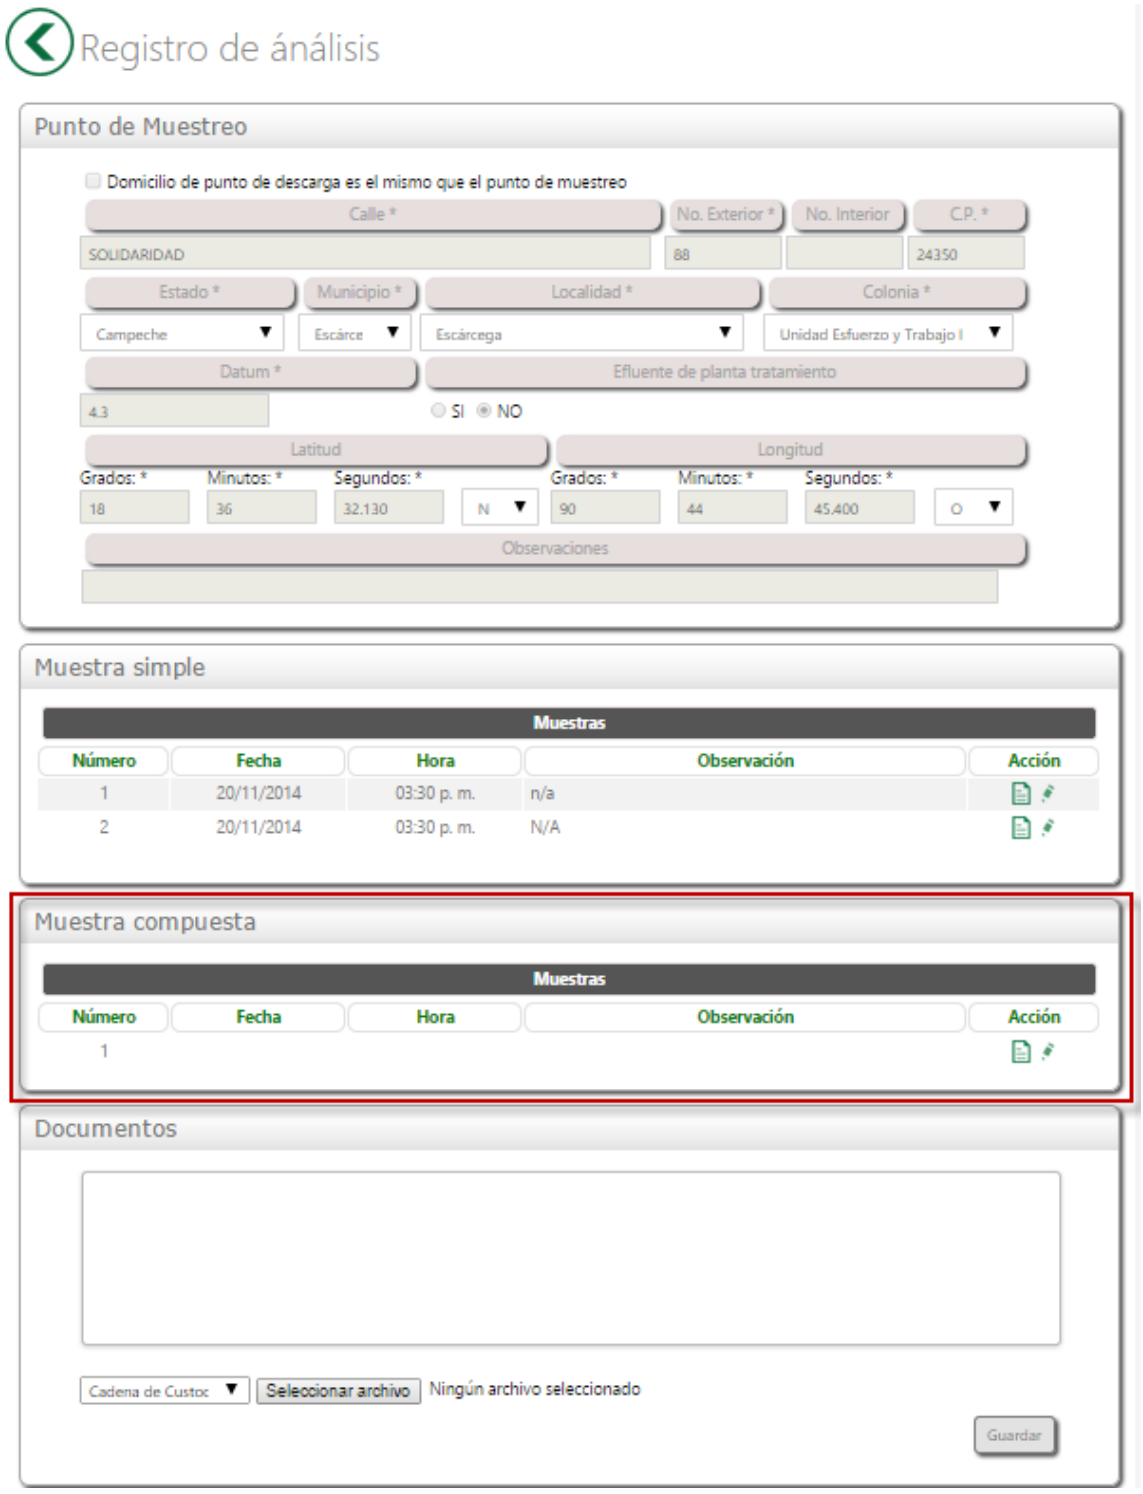

Img. Adición de muestra compuesta.

Hacer clic sobre el botón **Editar** situado en la Muestra compuesta:




Img. Editar muestra compuesta.

El sistema muestra la siguiente pantalla:




Img. Datos de la muestra.

Capturar los datos:

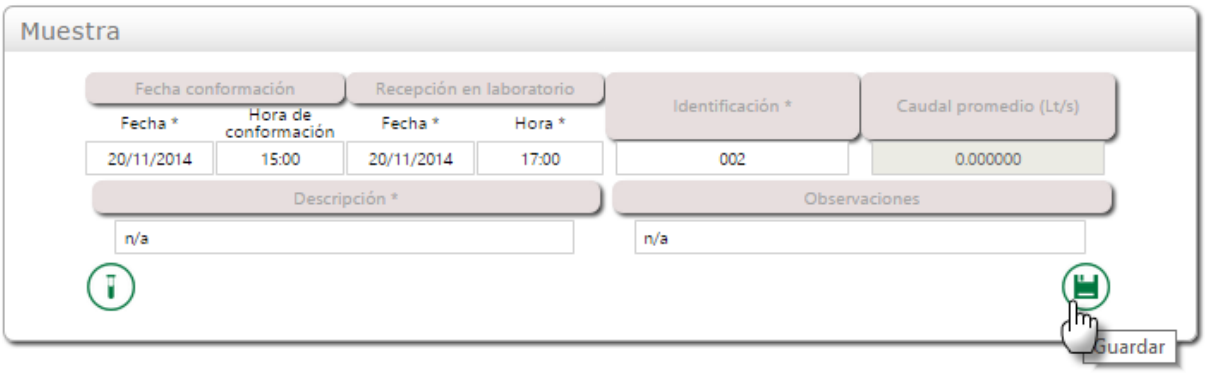

Img. Capturar datos muestra compuesta.

Guardar datos:

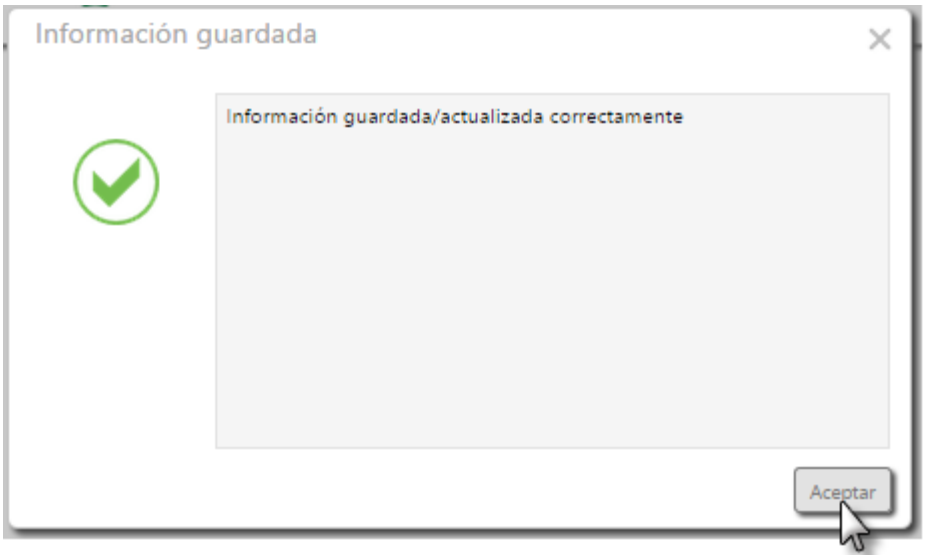

Img. Información guardada exitosamente.

Hacer clic en Regresar a la página anterior para volver a la pantalla de registro de análisis:




Img. Regresar a la página anterior.

La información de la muestra compuesta se encuentra capturada:



Img. Muestra compuesta.

La última sección de la página de Registro de análisis es la sección **Documentos:**

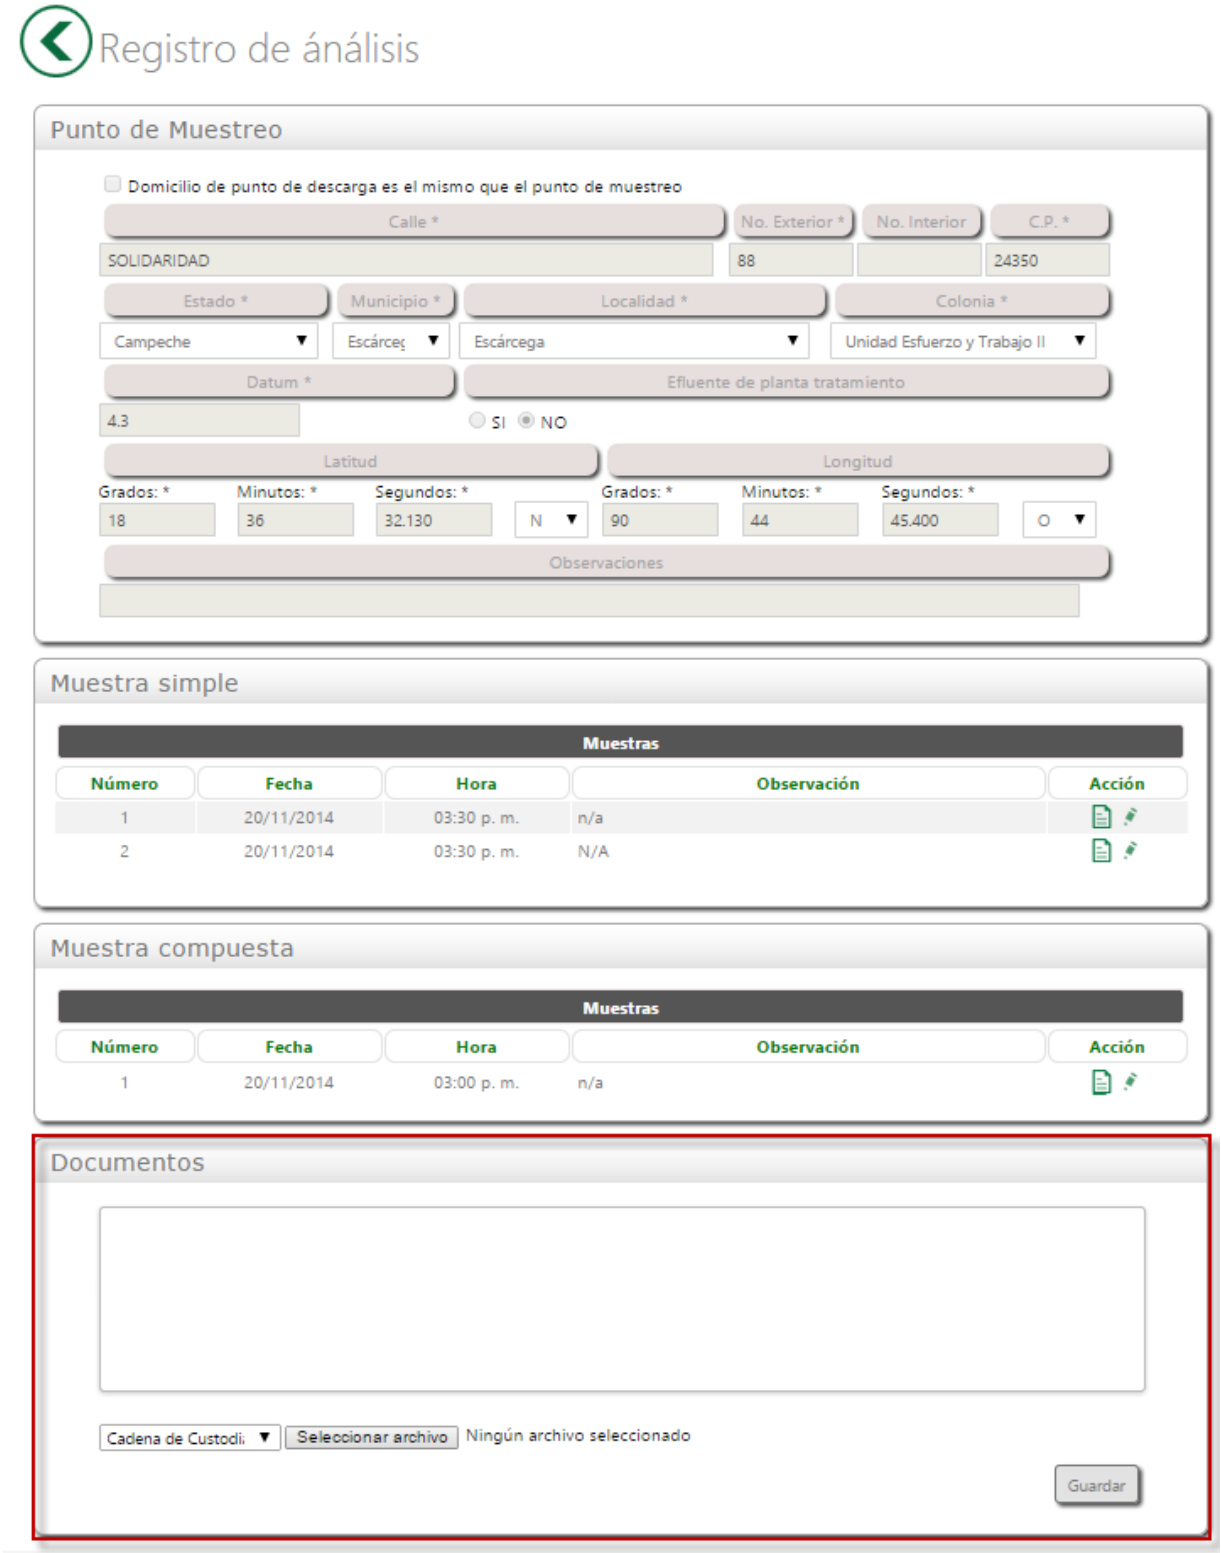


Img. Carga de documentos.

En esta sección se permite adjuntar la **Cadena de Custodia.**

Repetir el proceso de adjuntar documentos que se mostró en la sección de Muestra Simple.


Hacer clic sobre el botón **Guardar** para salvar los cambios generados.

Para regresar al Registro de Orden de Trabajo, hacer clic sobre la flecha de **Regresar a la página anterior:**

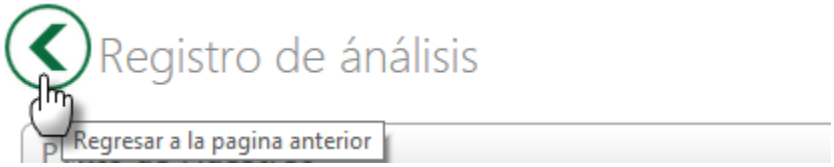


Img. Regresar a la página anterior.

Al regresar se muestra la siguiente pantalla:

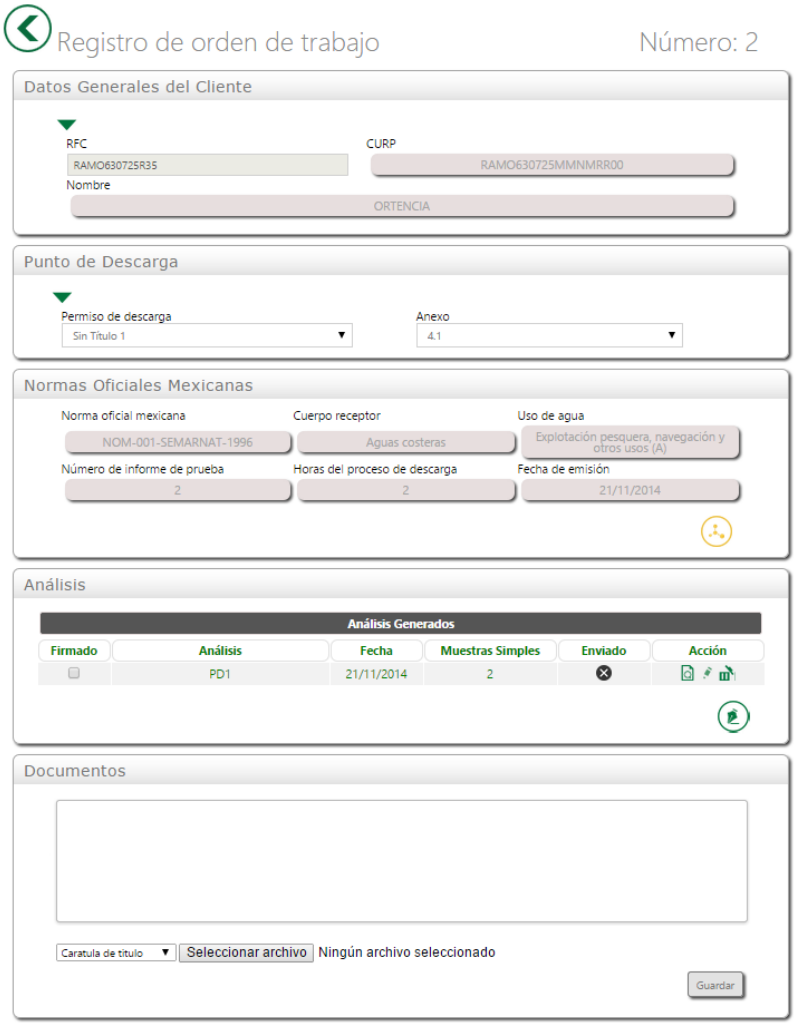

Img. Registro de orden de trabajo

Se pueden adjuntar documentos en el Registro de Orden de Trabajo:

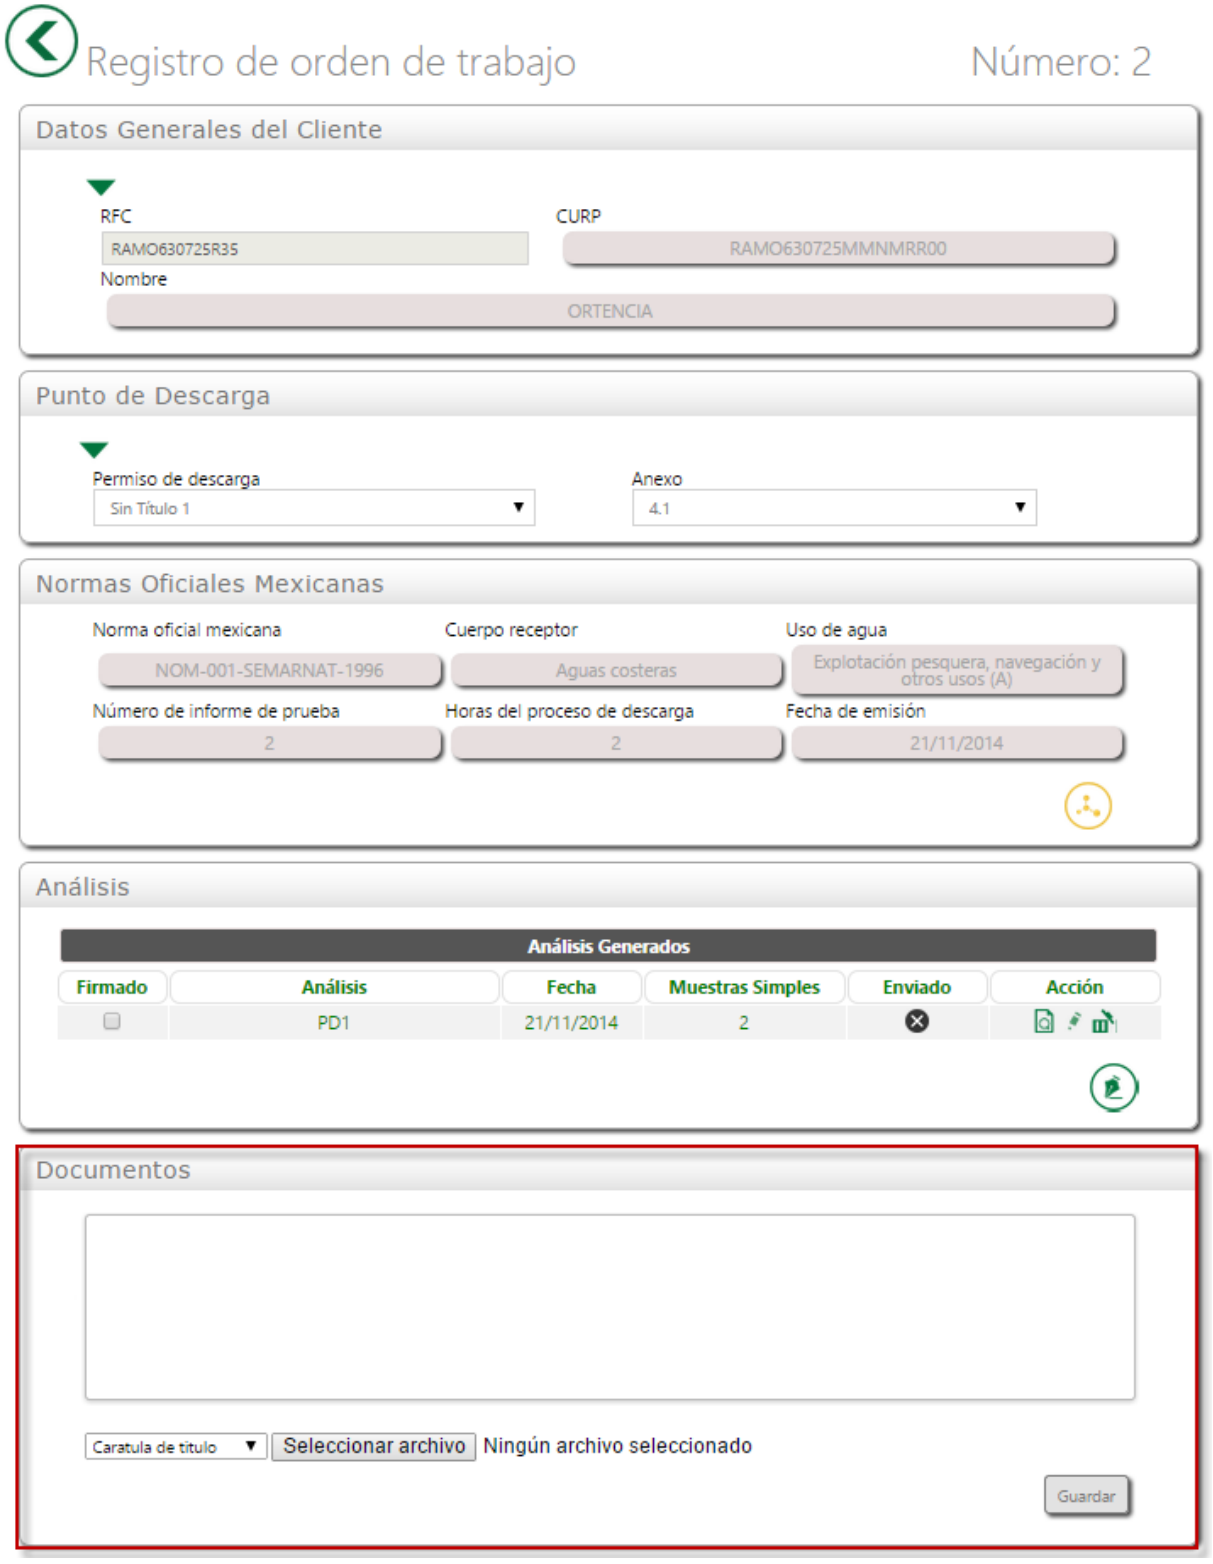

Img. Adjuntar documentos.

Seleccionar el tipo de documento, éste puede ser:

- Caratula de título.
- Imagen de ubicación.

Adjuntar documento y hacer clic sobre el botón **Guardar.**

- **Firmar Análisis.**

Hacer clic sobre el botón **Firmas y enviar** que se encuentra ubicado en la sección de Análisis:



Img. Firmar y enviar análisis.


2.2.2. Editar órdenes de trabajo.

Para editar las órdenes de trabajo generadas, hacer clic sobre la opción **Editar** de la orden de trabajo a modificar:



Img. Editar Orden de Trabajo.

El sistema muestra la siguiente pantalla:

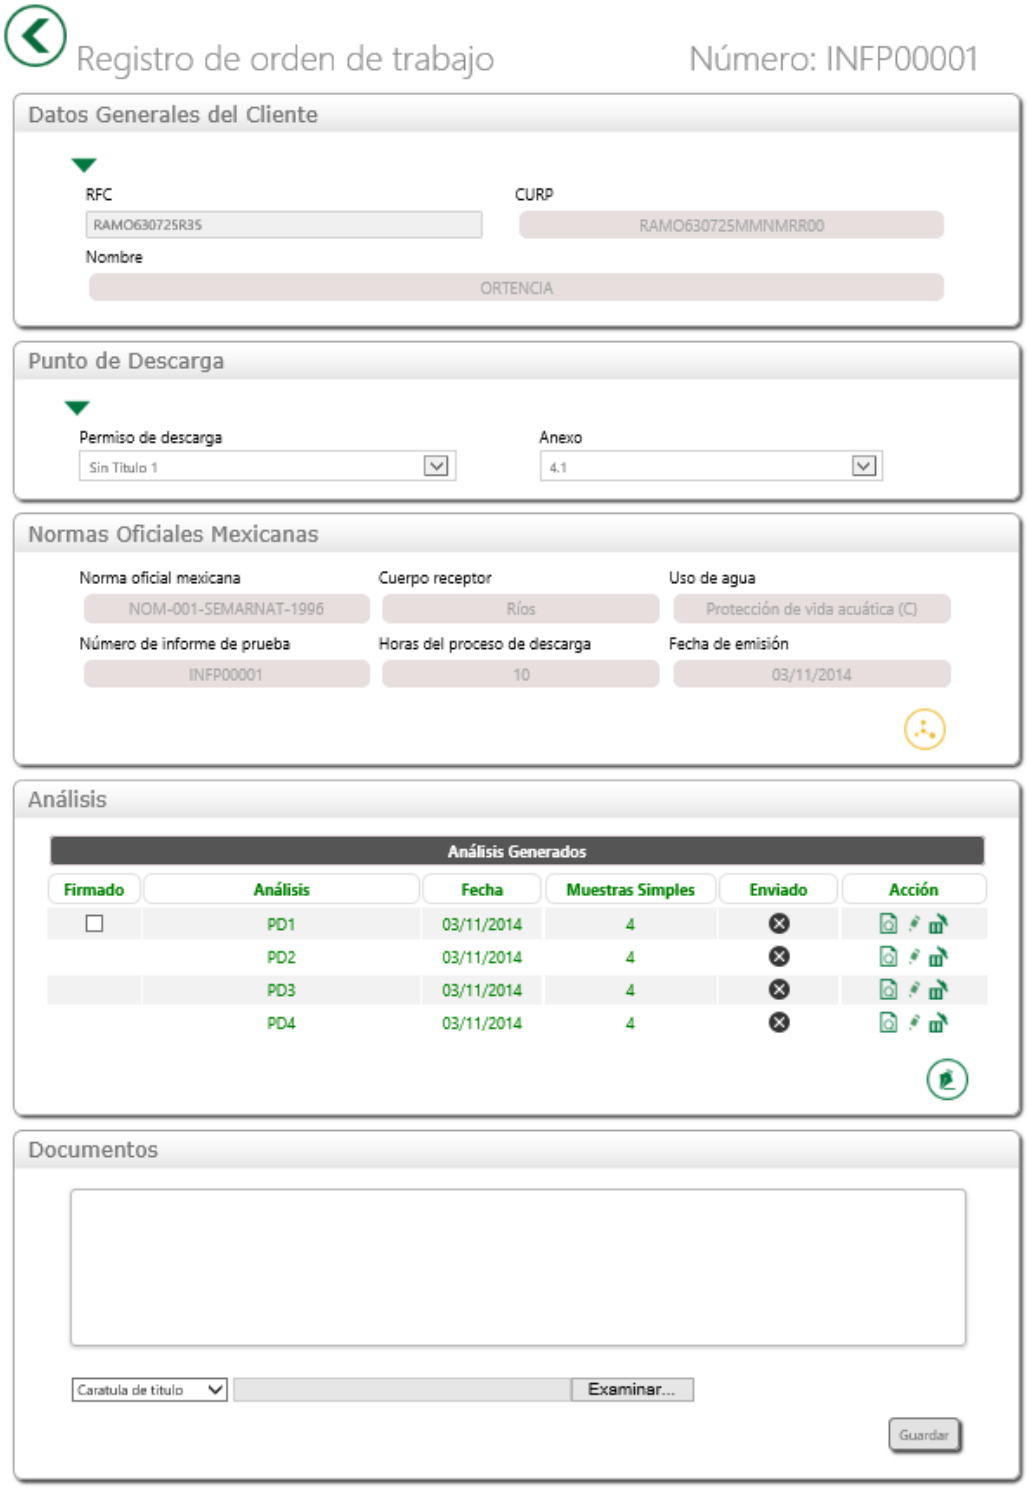


Img. Editar Orden de Trabajo

Editar los datos correspondientes y guardar los cambios.

Una vez que se han terminado de registrar todos los datos de los Análisis Generados se puede realizar un Firmado Masivo.

El Firmado Masivo permite firmar y enviar todos los análisis seleccionados ejecutando una sola vez la opción **"Firmar y enviar".**

Para esto, seleccionar todos los Análisis deseados:

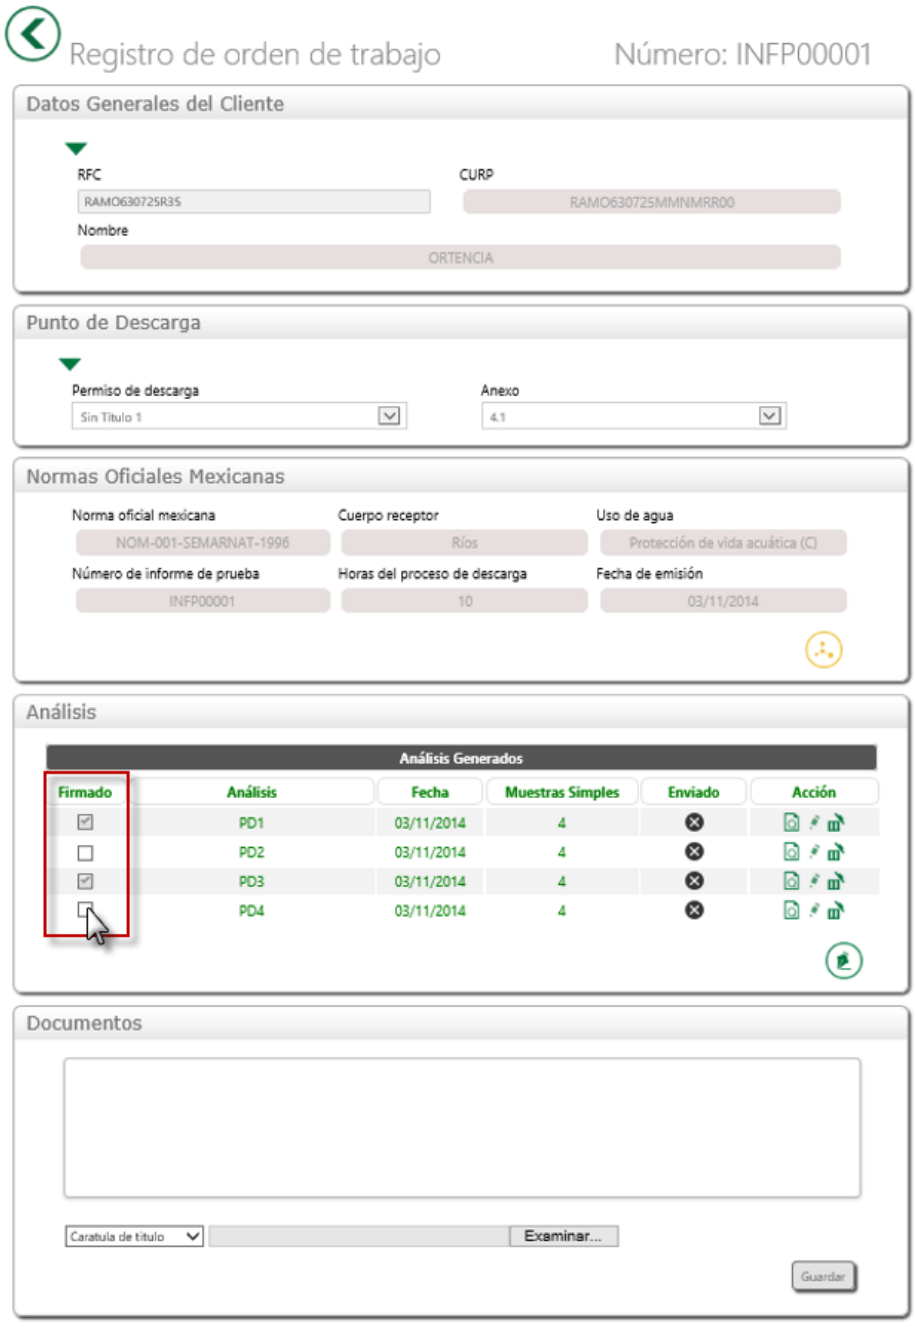

Img. Seleccionar análisis.

A continuación hacer clic sobre la opción **Firmar y enviar:**



Img. Firmar y enviar.

2.2.3. Buscar Órdenes de Trabajo.

Para realizar una búsqueda de Orden de Trabajo, hacer clic sobre la opción **Avanzados,** ubicado en la sección de búsqueda de la pantalla de Registro de órdenes de trabajo:



Img. Búsqueda a través de Avanzados.

El sistema despliega una ventana para realizar la búsqueda de una Orden de Trabajo a través de los siguientes parámetros:


- RFC.
- Folio.
- Fecha Inicial.
- Fecha Final.

Capturar uno o más datos para ejecutar la búsqueda:



Img. Búsqueda avanzada.

Después de capturar la información hacer clic sobre el botón **Buscar:**

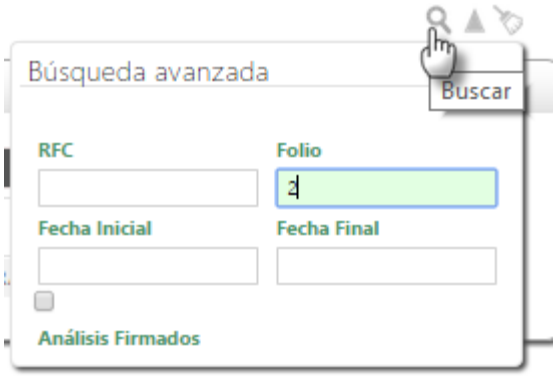

Img. Buscar por Folio.

El sistema muestra los resultados que coinciden con el criterio de búsqueda:



Img. Resultados de búsqueda.

Para limpiar los datos capturados en Búsqueda avanzada, hacer clic sobre el botón **Limpiar:**



Img. Limpiar búsqueda.

Enseguida se muestra el listado completo de Órdenes de Trabajo generadas:



Img. Listado completo de OT

3. Salir del Sistema.

Para salir del Sistema de Recepción de Análisis de Laboratorio hacer clic sobre la opción **Salir:**



Img. Salir.

El sistema cierra la sesión actual y muestra la página de Acceso al Sistema (Login):

