24 Agosto 00

Se construyeron bujes de Al para la TRP30 en la celda 2PTBB3 y 3PTBB3.

13:30 Se prepara la celda 2PTBB3 para medir en ella.

Agua a 22,7 °C para formar los vasos

2PTBB3 Transfer patrones (Guildline) 23.0010

En la 2PTBB3: Centro termómetro al nivel de agua EXTERNO = 20 cm ± 0,5 cm

14:25 Se inicia una prueba para optimizar el puente respecto a la fotón de 25 Ω

La configuración actual del programa parece

14:50 perfecta: pel prototipo

Se comienza a preparar la celda doble en el termo con aislación térmica fabricada con cinta de enmascarar.

15:10 Se fundió primero abajo (el hielo en las terminaciones) para poder ver el bloqueo moverse. Se fundió y agregó agua

(2) GAN = 5×10^4 GAR = 0

en el tubo central junto con la rondela de acrílico.

15:15 & deliem el programa y se coloca el termómetro en la celda doble.

15:30 Recien empezó a balancear bien pero viene bajando.

15:35 Durante el primer ciclo (en la 2PTB83) no se registraron las corrientes.

Celda Doble

Se comienza a subir en modo manual

G. = 5×10^4 GAR = 0 impedancia = 100 Ω

W = 25 Hz ΔW = 0.1 Hz (igual que el anterior)

$2\sqrt{2}$: 2.81780 $1\sqrt{2}$; 1,40704

15:46 2 ; 1.98890 1 ; 0.99419

16:30 Después de observar la celda doble (el

2PTB83 nivel del punto triple estaría exactamente en la parte superior del sensor de la TRP30) y el bloque superior

Tamsiente 22 ± 1
Humedad ~ 75%

de hielo girotor. El infierno no podría verse, pero por lógica (no hay hielo fuera) no debe hallarse solidificado.

$2\sqrt{2}$: 2,81174 2 : 1.98889

$1\sqrt{2}$: 1,40703 1 :

17:05 Se inicia otro ciclo con la celda doble

Celda $2\sqrt{2}$: 2,81173 2 : 1,98890

Doble $1\sqrt{2}$: 1,40701 1 : 0.99417

18:10

2PTB83 $2\sqrt{2}$: 2.81174 2 : 1.98891

$1\sqrt{2}$: 1.40702 1 : 0.99420

18;45 $2\sqrt{2}$: 2.81173 2 : 1.98889

Celda $1\sqrt{2}$: 1.40702 1 ; 0.99417

Doble

Al finalizar se verificó la empaquetadura de hielo exterior (bastante duro y compactado) y que los dos bloques de hielo se movían bien.

(4)

antes de empezar se verificó que el hielo gire

19:25 | $2\sqrt{2}$: 2.81174 | 2 : 1.98888

2PTB83 | $1\sqrt{2}$: 1.40702 | 1 : 0.99417

25 de agosto 00

10:02 Se inicia la preparación de la 2PTB83 para seguir midiendo.

Se empaquetó el termo potalosio con la aislación de cinta aislante.

10:22 Se colocó la TRP30 en la 2PTB83

T baño resistor patrón 23.0005 °C

2PTB83 | $2\sqrt{2}$: 2.81169 | 2 : 1.98887

$1\sqrt{2}$: 1.40701 | 1 : 0.99416

11:00 Otro ciclo | $2\sqrt{2}$: 2.81168 | 2 : 1.98886

2do | $1\sqrt{2}$: 1.40703 | 1 : 0.99418

10:40 Se inicia la preparación de la 3PTB83 deslizante.

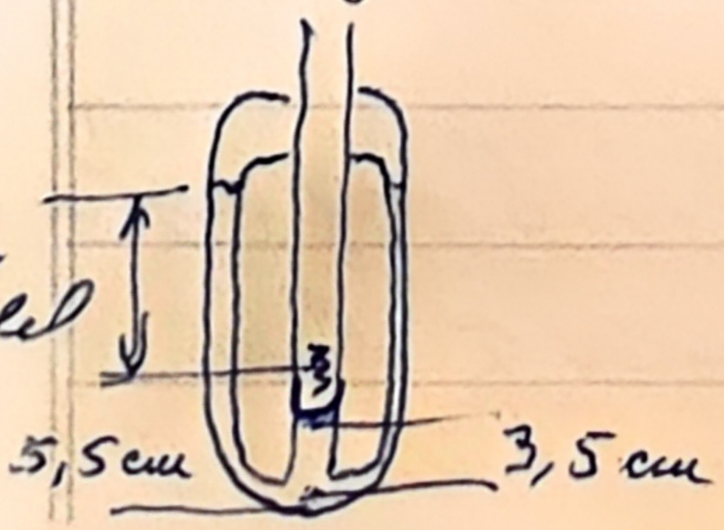

El hielo flota en ambas direcciones.

11:35 Semicio hacia abajo (normal) 3PTBB3

$2\sqrt{2}$: 2.81170 2 : 1.98888

$1\sqrt{2}$: 1.40703 1 : 0.99417

12:05 Se invierte (invertido) (Algo pasó)

$2\sqrt{2}$: 2.81170 2 : 1.98889

$1\sqrt{2}$: 1.40703 1 :

12:40 Se pone normal

$2\sqrt{2}$: 2.81170 2 ; 1.98887

$1\sqrt{2}$: 1.40703 1 : 0.99420

13:15 Se desarma la celda 3PTBB3 y parece O.K. Tal vez solo se mojó el cable.

Se vuelve a calibrar en la 2PTBB3

$2\sqrt{2}$: 2.81173 2 : 1.98886

$1\sqrt{2}$: 1.40703 1 :

La 3PTBB3 esta aparentemente bien.

(6) Tamb. 21 °C 50% humedad.

30 de agosto 00

8:40 Se inicia la empaquetadura del termo con aislación (papel de enmascarar)

Temperatura baño resistores 23.0015 °C

9:20 Se terminó de preparar la 2PTB83 el sensor de la TRP30 esta 20 cm bajo el nivel de agua exterior.

Archivo 00831wt.dat

9:40 $2\sqrt{2}$: 2,81191 2 : 1.98895

2PTB83 $1\sqrt{2}$: 1.40709 1 : 0.99423

9:55

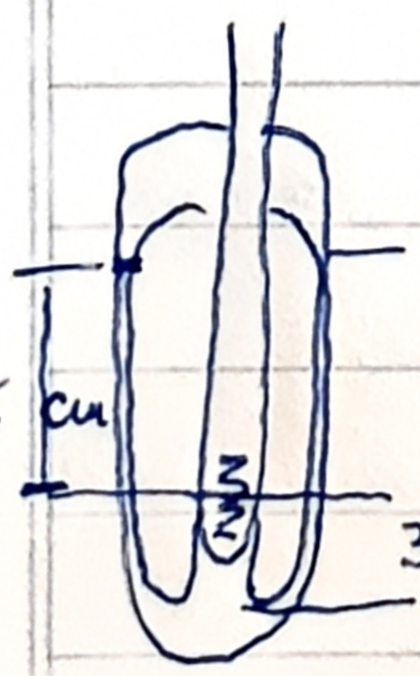

hoy más agua fundida que anteriormente invertido el nivel de agua externo está justo en el medio del sensor.

hoy flota más que en la p. 5

10:05 $2\sqrt{2}$: 2.811910 2 ; 1.98893

2PTB83 $1\sqrt{2}$: 1.40710 1 : 0.99423

2da posada

10:30 Se inician los monitoreos preparando la
3PTB83 celda a rotor 3PTB83

10:40 posición normal 1ro
3PTB83 $2\sqrt{2}$: 2.81185 2: 1.98901
$1\sqrt{2}$: 1.40710 1: 0.99424

el último valor se estabilizó muy alto?

11:09 Se inicia la primera rotación. hacia arriba
3PTB83 $2\sqrt{2}$: 2.81190 2: 1.98901
$1\sqrt{2}$: 1.40710 1: 0.99425

posición normal 2da
11:35 $2\sqrt{2}$: 2.81190 2: 1.98896
3PTB83 $1\sqrt{2}$: 1.40700

2da
12:00 Segunda rotación (hacia arriba)
$2\sqrt{2}$: 2.81185 2: 1.98898
3PTB83 $1\sqrt{2}$: 1.40713 1: 0,99424