


质谱-自动进样器-六通阀 同步流程



说明：
1. 添加一个与快速进样六通阀同步的复选框，勾选了FastSampler就表示要同步
Synchronize with Devices
☐ Fast Sampler

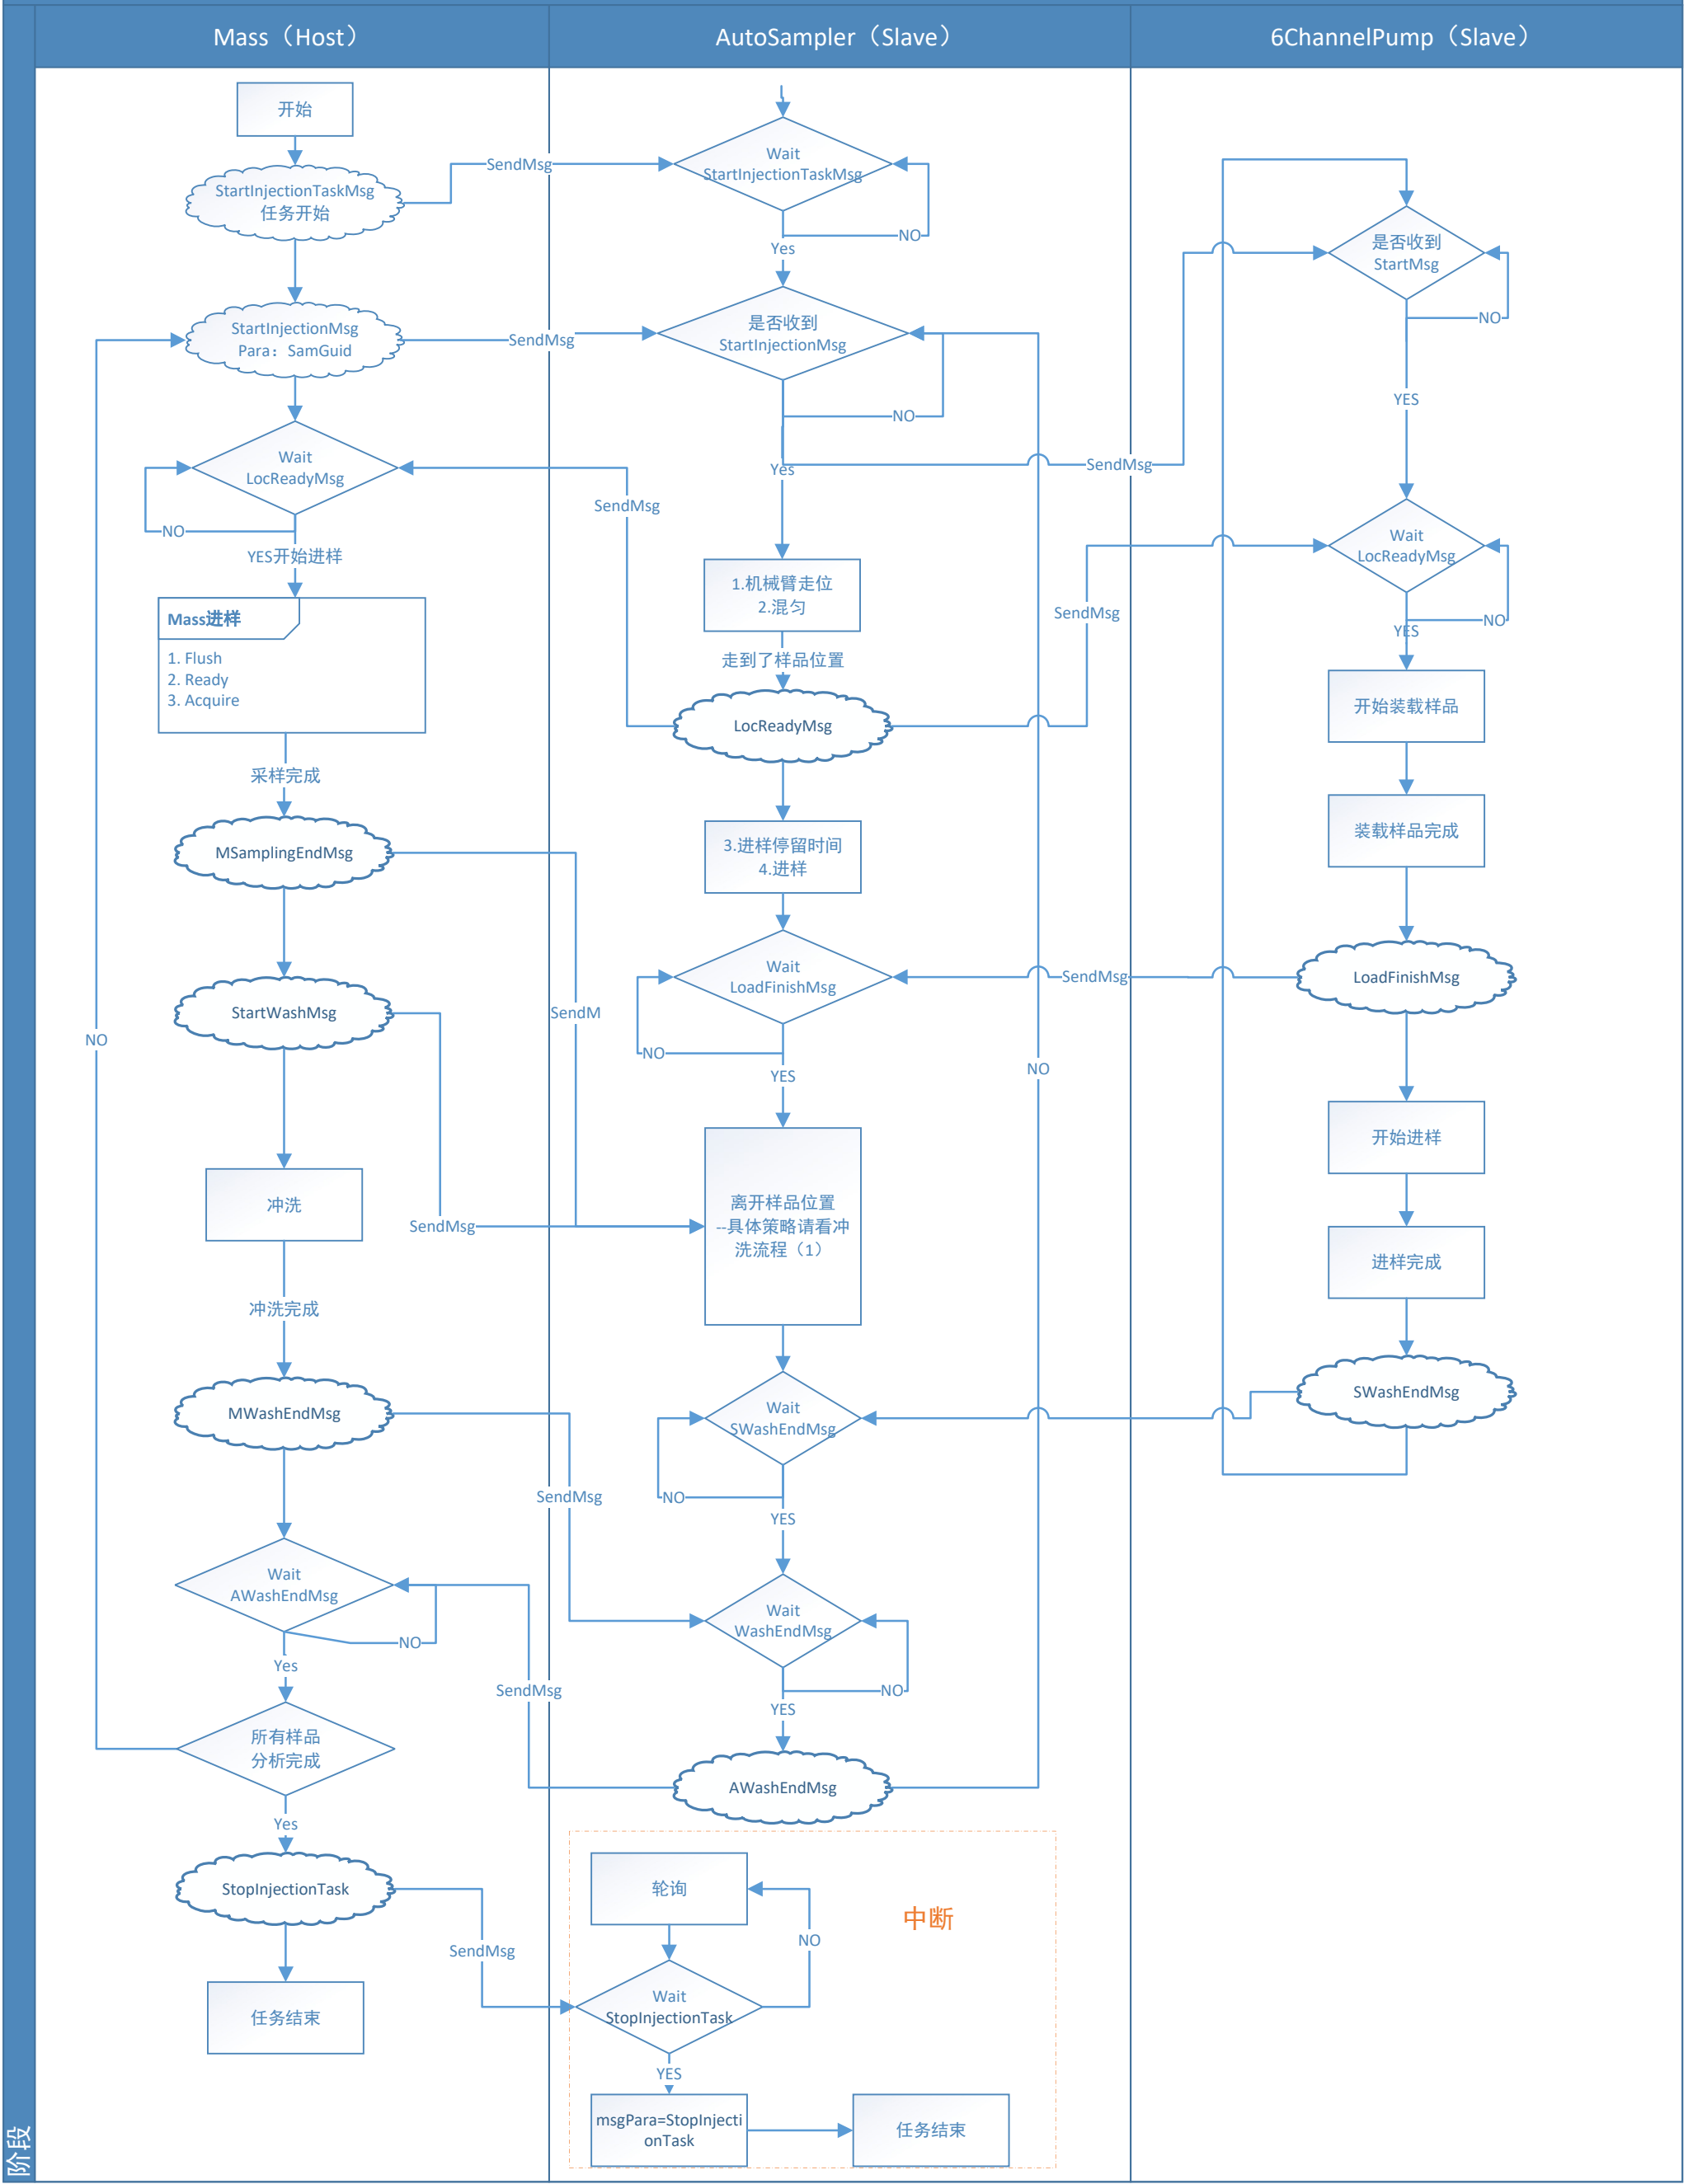