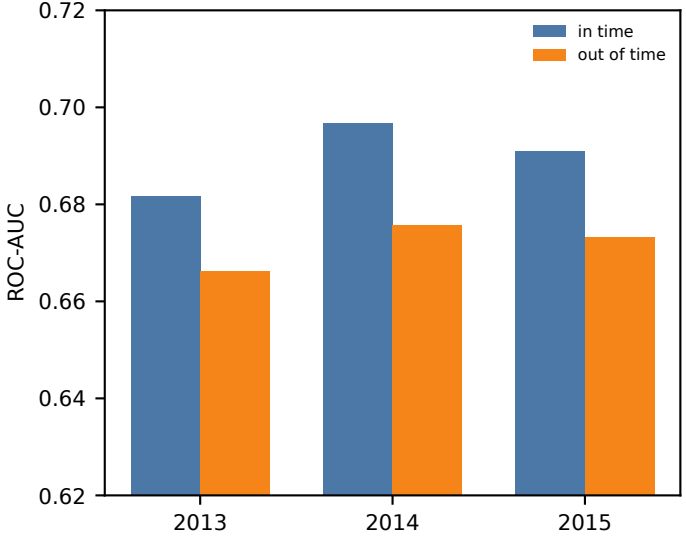
ROC-AUC
0.72
0.70
0.68
0.66
0.64
0.62
in time
out of time
2013
2014
2015

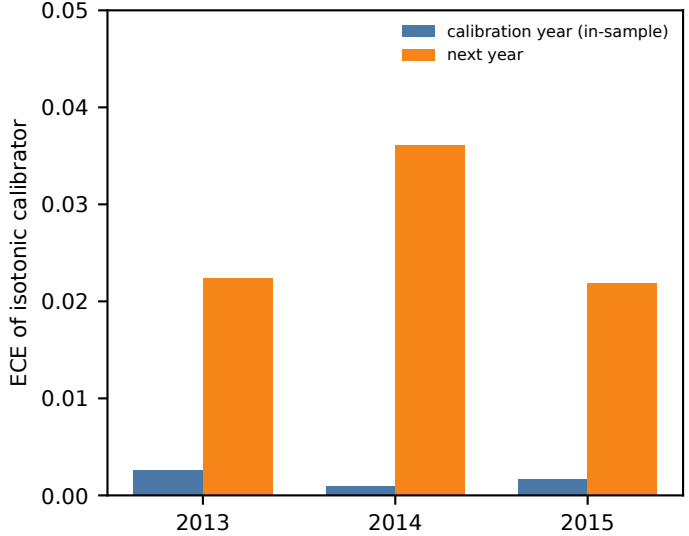
ECE of isotonic calibrator
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
calibration year (in-sample)
next year
2013
2014
2015

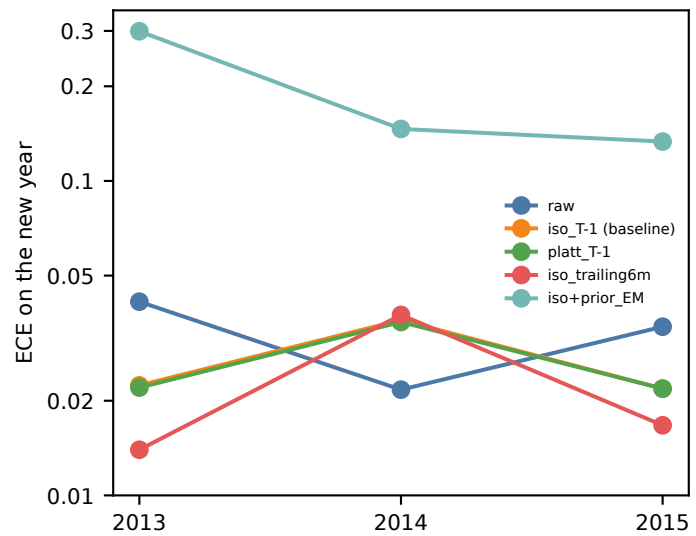
ECE on the new year
0.3
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
raw
iso_T-1 (baseline)
platt_T-1
iso_trailing6m
iso+prior_EM
2013
2014
2015