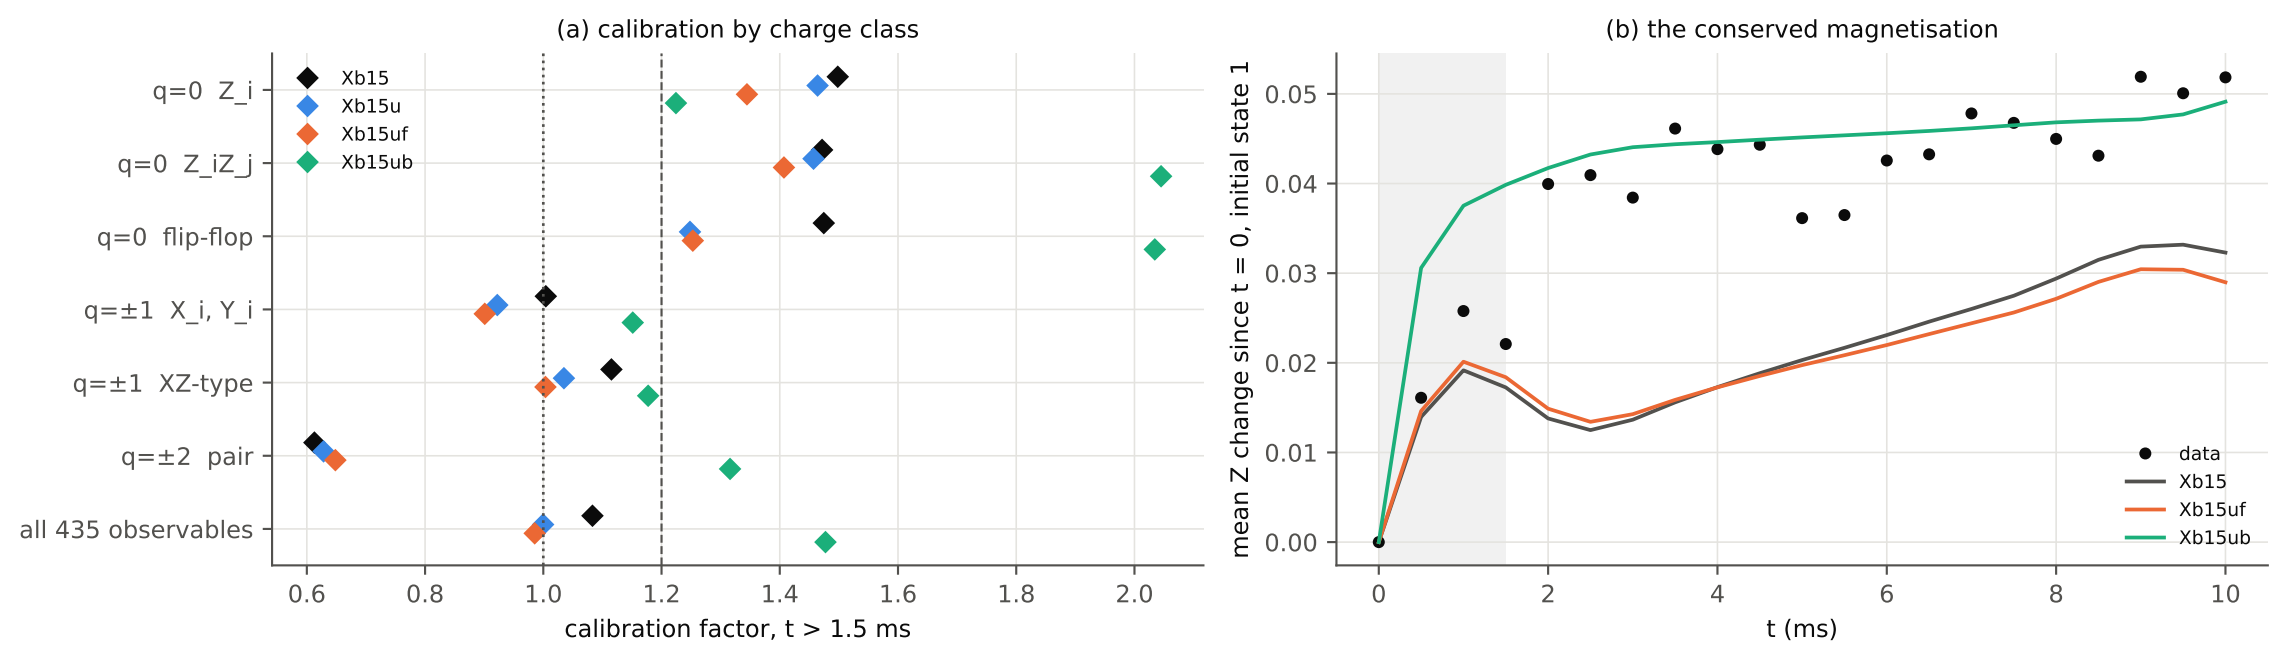
(a) calibration by charge class
Xb15
Xb15u
Xb15uf
Xb15ub
q=0 Z_i
q=0 Z_iZ_j
q=0 flip-flop
q=±1 X_i, Y_i
q=±1 XZ-type
q=±2 pair
all 435 observables
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
calibration factor, t > 1.5 ms
(b) the conserved magnetisation
mean Z change since t = 0, initial state 1
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0
2
4
6
8
10
t (ms)
data
Xb15
Xb15uf
Xb15ub