就诊及诊疗记录状态机

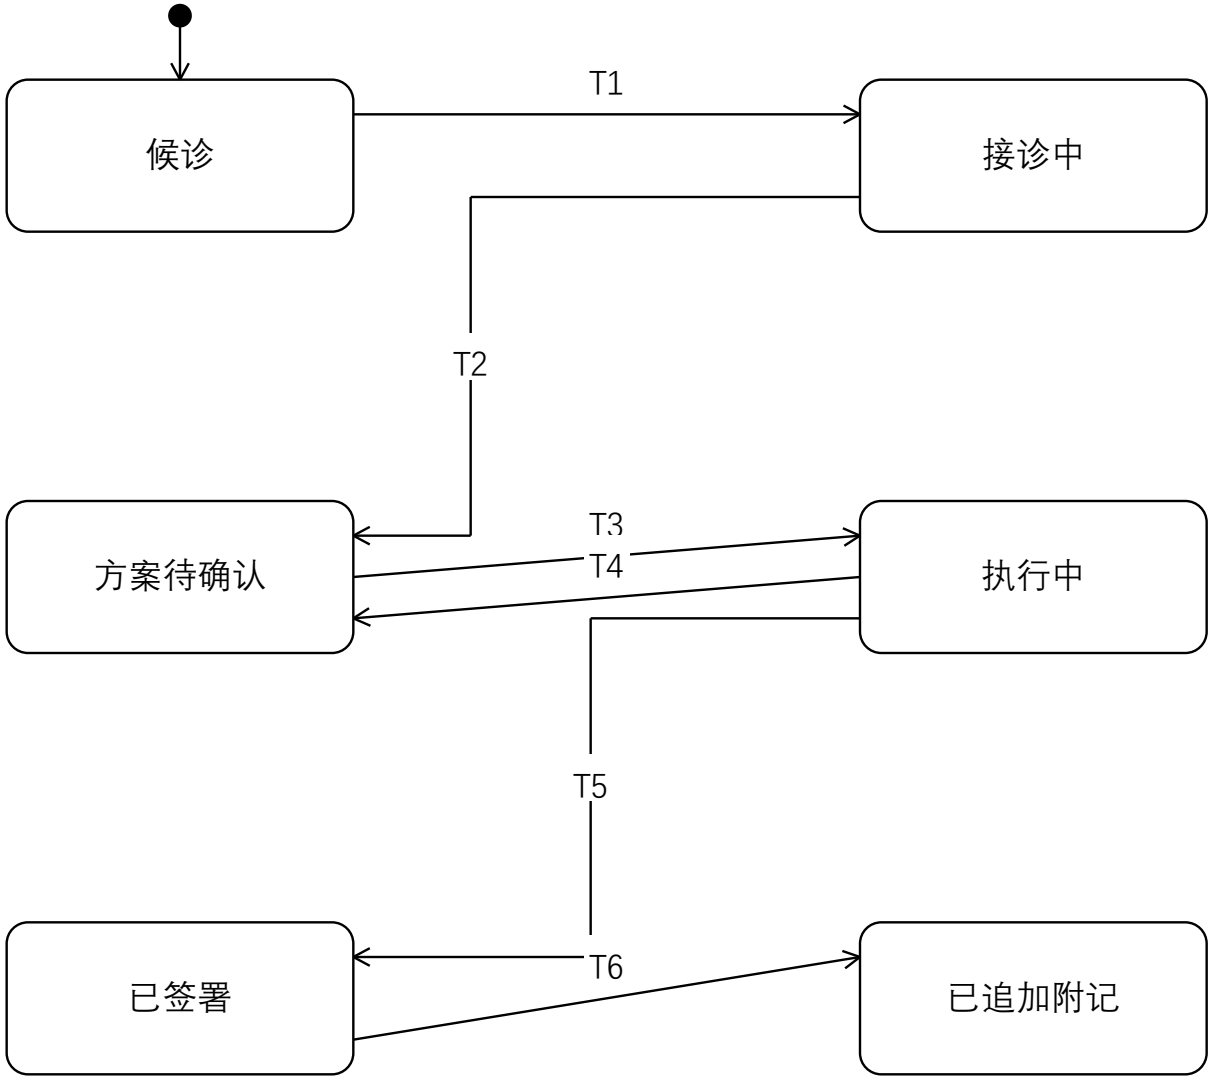

状态间转换由T编号识别；事件、条件和动作见随图转换表。