同じ説明用の候補を二つの検査範囲で確認する

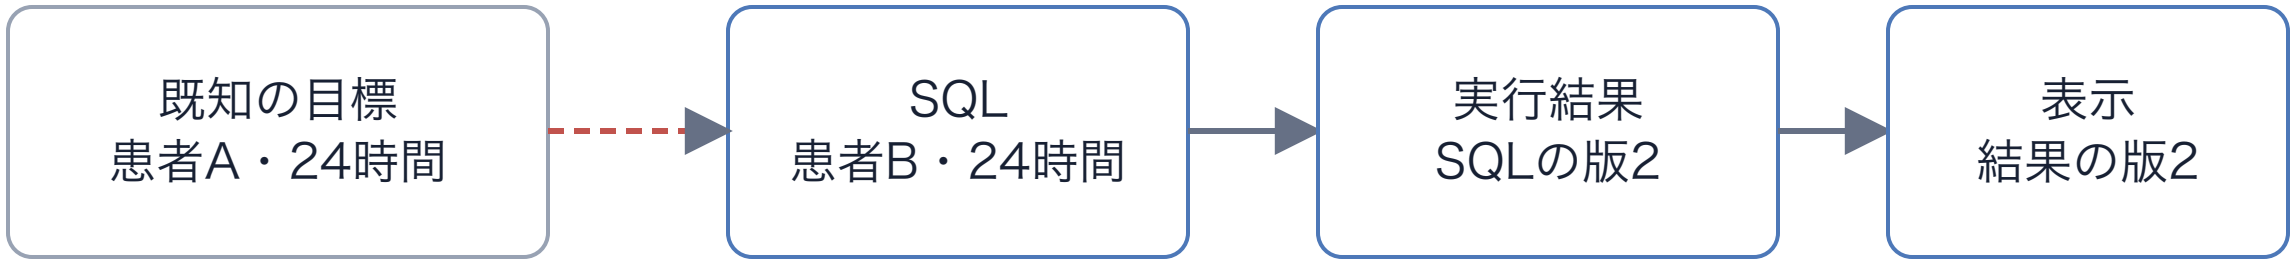

局所検査は通過
SQLの形式と成果物の互換性を検査
目標患者との照合はしない

参照情報との層間検査は拒否
患者Bが目標の患者Aと異なる
患者の不整合を報告・位置は採点しない