
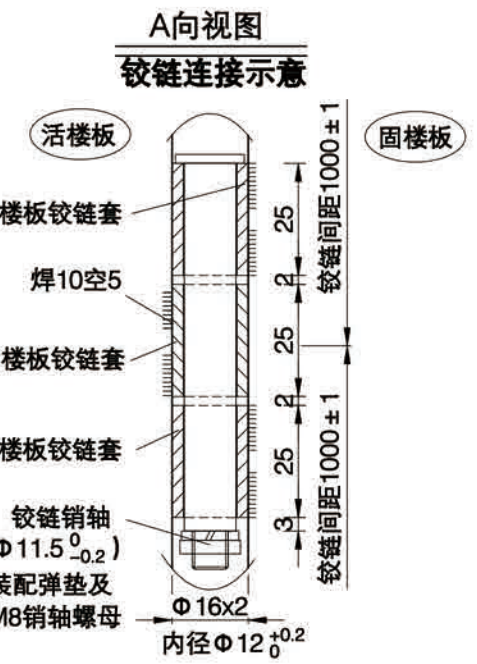
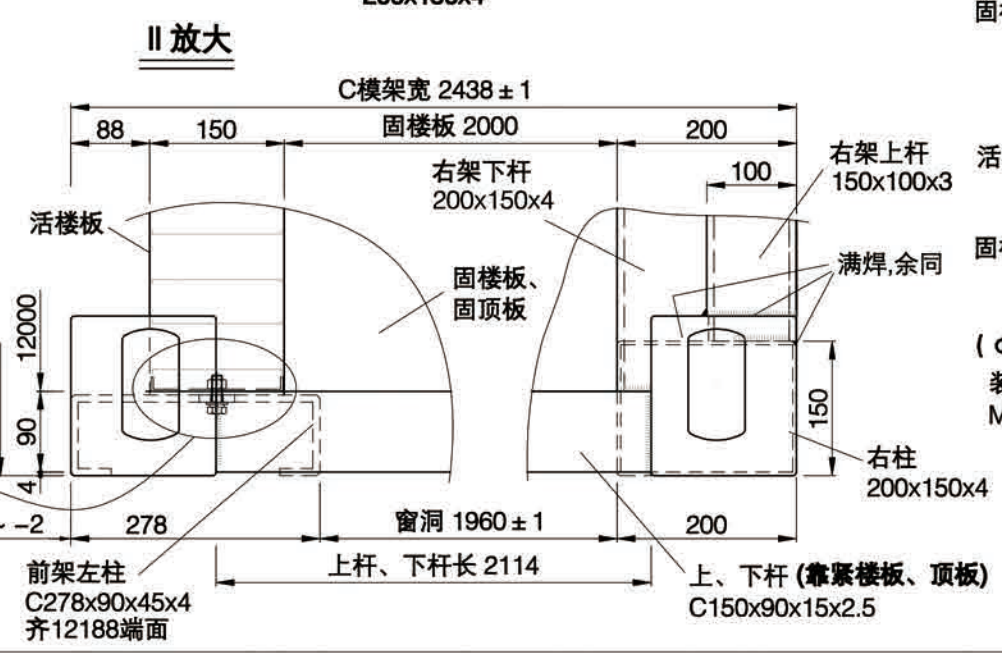
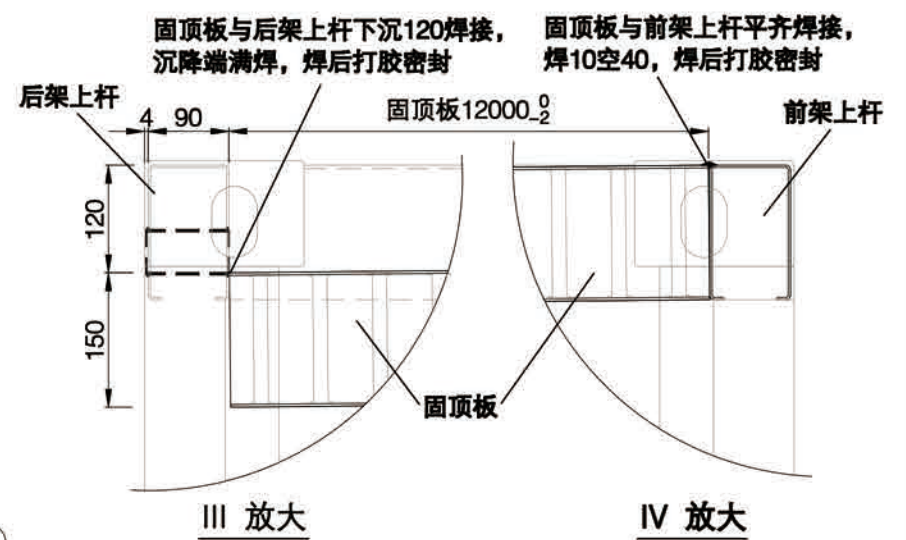
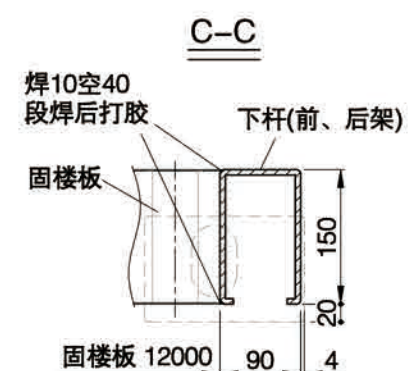
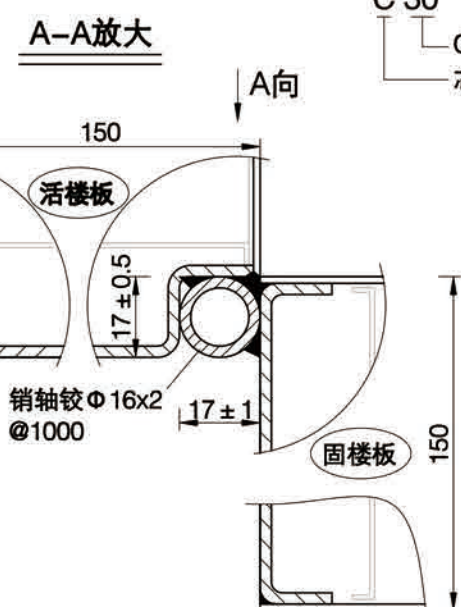
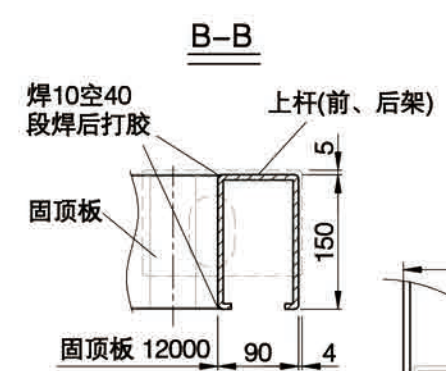
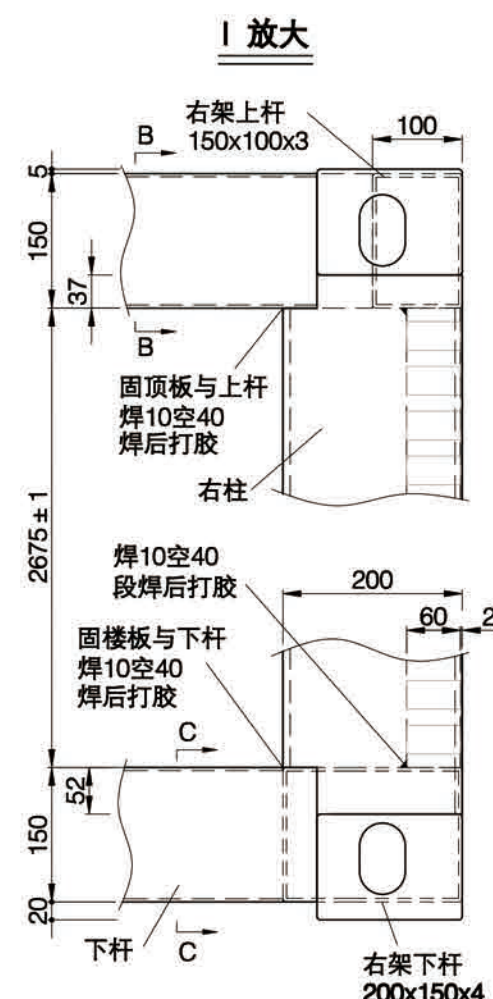
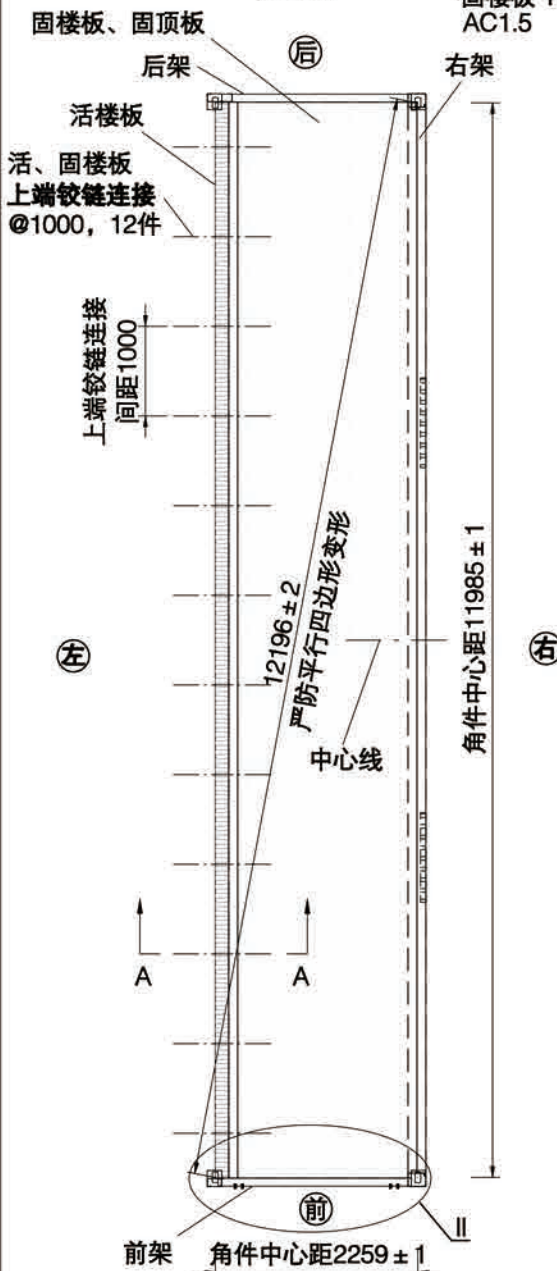
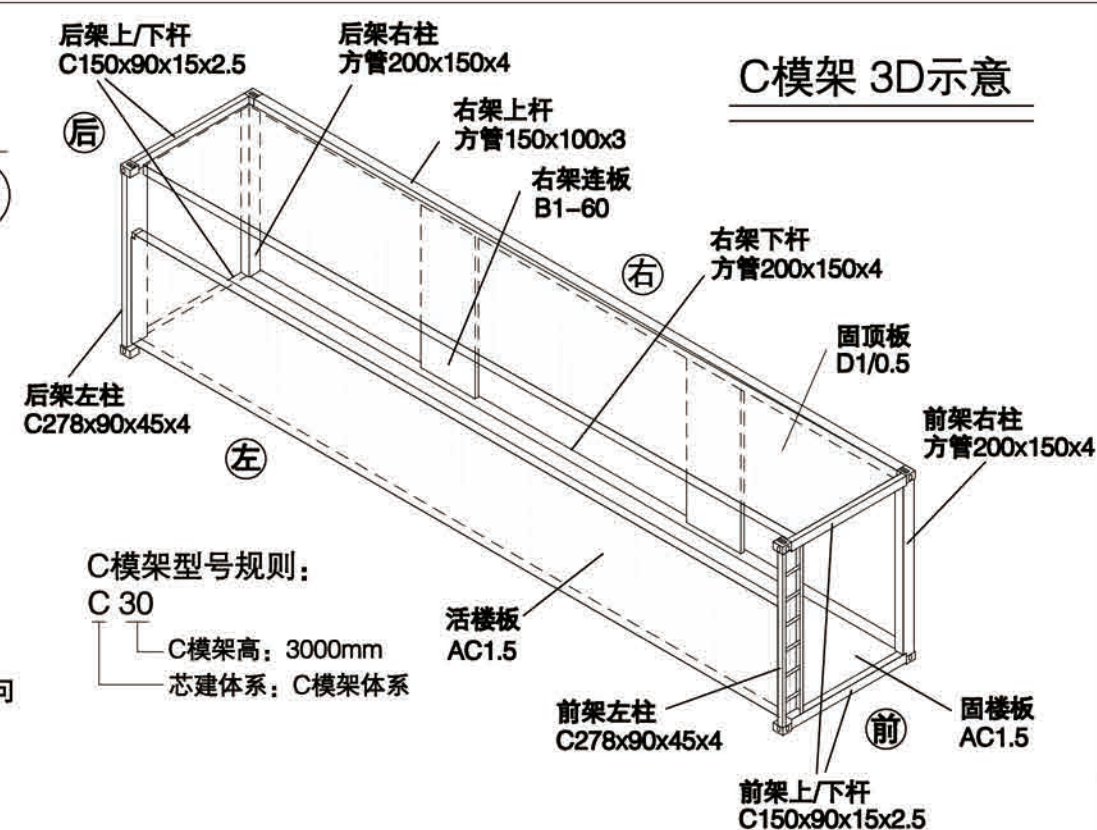
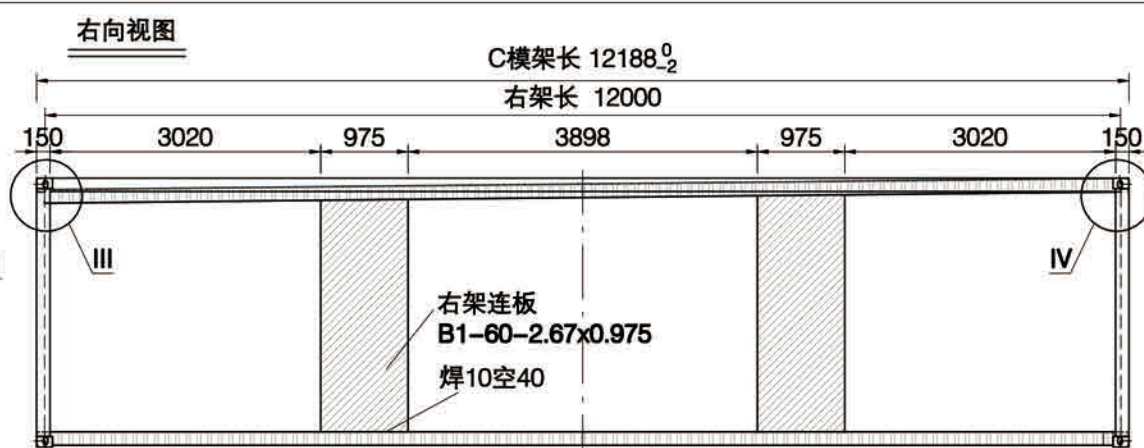


### C模架

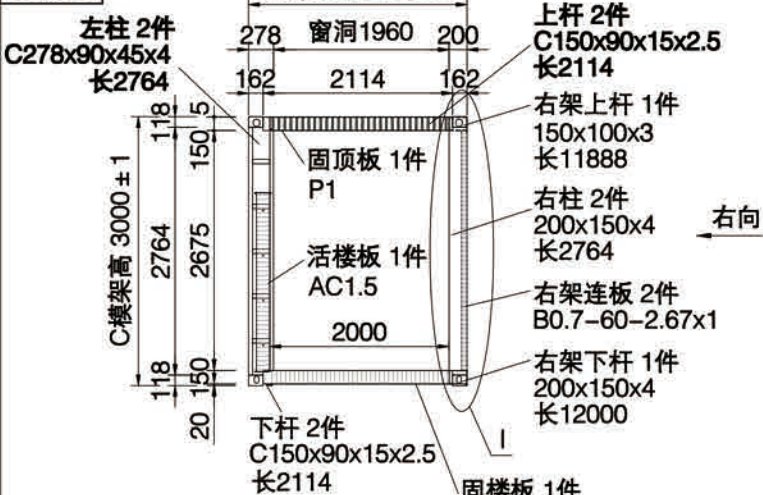

NO	名称	图号	规格/尺寸	数量	重量
1	固楼板	XJ-WQ-CMJLB-	AC1.5	1	807
2	活楼板	XJ-WQ-CMJLB-	AC1.5	1	810
3	固顶板	XJ-WQ-CMJDB-	P1	1	355
4	前架	XJ-WQ-CMJLJ-	2438x3000x178	1	148
5	后架	XJ-WQ-CMJLJ-	2438x3000x178	1	148
6	右架	XJ-WQ-CMJLJ-	11888x2986x200	1	606
7	铰链销轴	XJ-WQ-CMJLJ-	含销轴, M8销轴螺母	12套	/
8	密封胶	外购件	灰色, 中性硅酮防霉密封胶	3L	/
9	螺栓M12	外购件	六角头螺栓M12x30	8	/

技术要求

1.未注尺寸公差 $\pm 1$ 。

2.焊缝不允许出现变色、裂纹、气孔、夹渣、未融合等焊接缺陷

图号: XJ-WQ-CMJZT-200312		用途: <input type="checkbox"/> 方案 <input checked="" type="checkbox"/> 制作 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 非标	
替代旧号: XJ-WQ-CMJZT-200310		企业密级: <input type="checkbox"/> 公开 <input checked="" type="checkbox"/> 内部 <input type="checkbox"/> 机密 <input type="checkbox"/> 绝密	
制图	工艺	闻庆负压隔离病房	
审核	品管		
批准	日期		

### C模架总图