


# Kalibrierschein



Akkreditiertes Kalibrierlabor DKD-K-18301

## Messbalken, Natur-Hartgestein

Artikel-Nr.:	225-404	Größe:	1250 x 60 x 190 mm
Komm.-Nr.:	211215-3	Güte	00

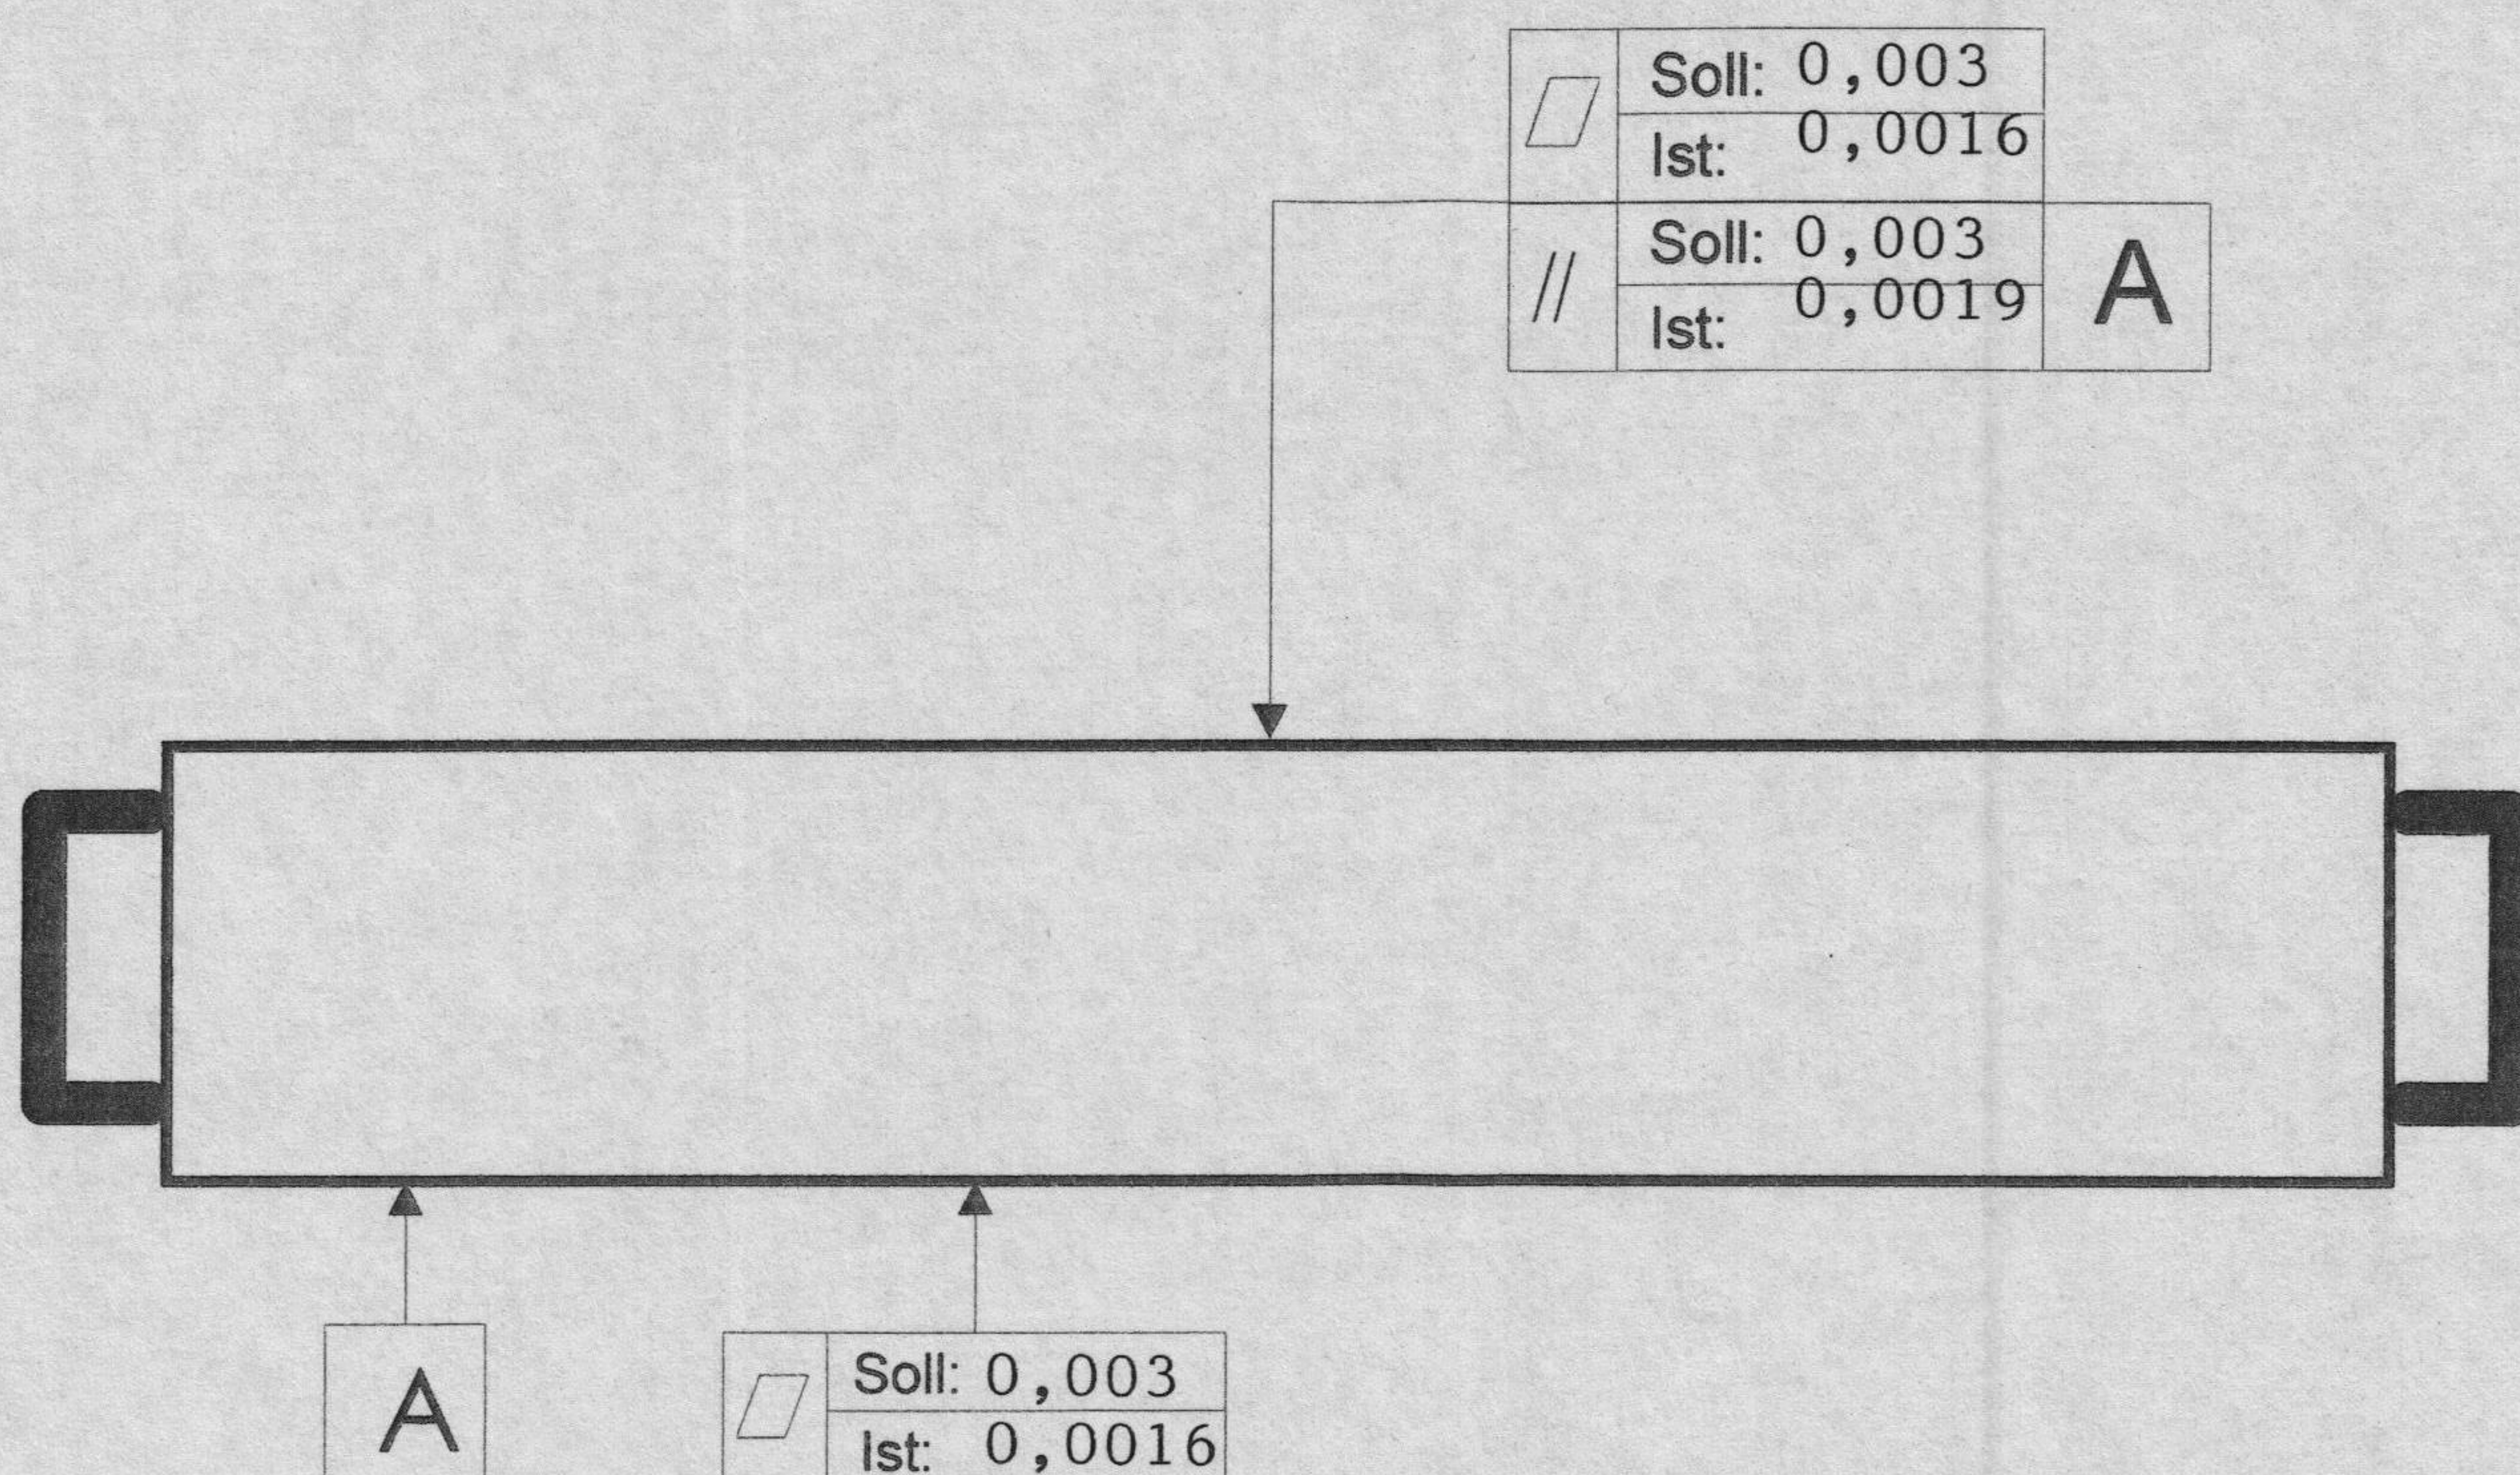

Kunde: Heckert GmbH

Bestell.-Nr.: 02-130609

Bezugstemperatur + 20°C  
Rel. Feuchte (50 +- 5%)

Datum:

30.04.13

Prüfer: