

# Kalibrierschein



Akkreditiertes Kalibrierlabor DKD-K-18301


## Messbalken, Natur-Hartgestein

Artikel-Nr.:

Größe: 1000 x 56 x 160 mm

Komm.-Nr.: 48064

Güte

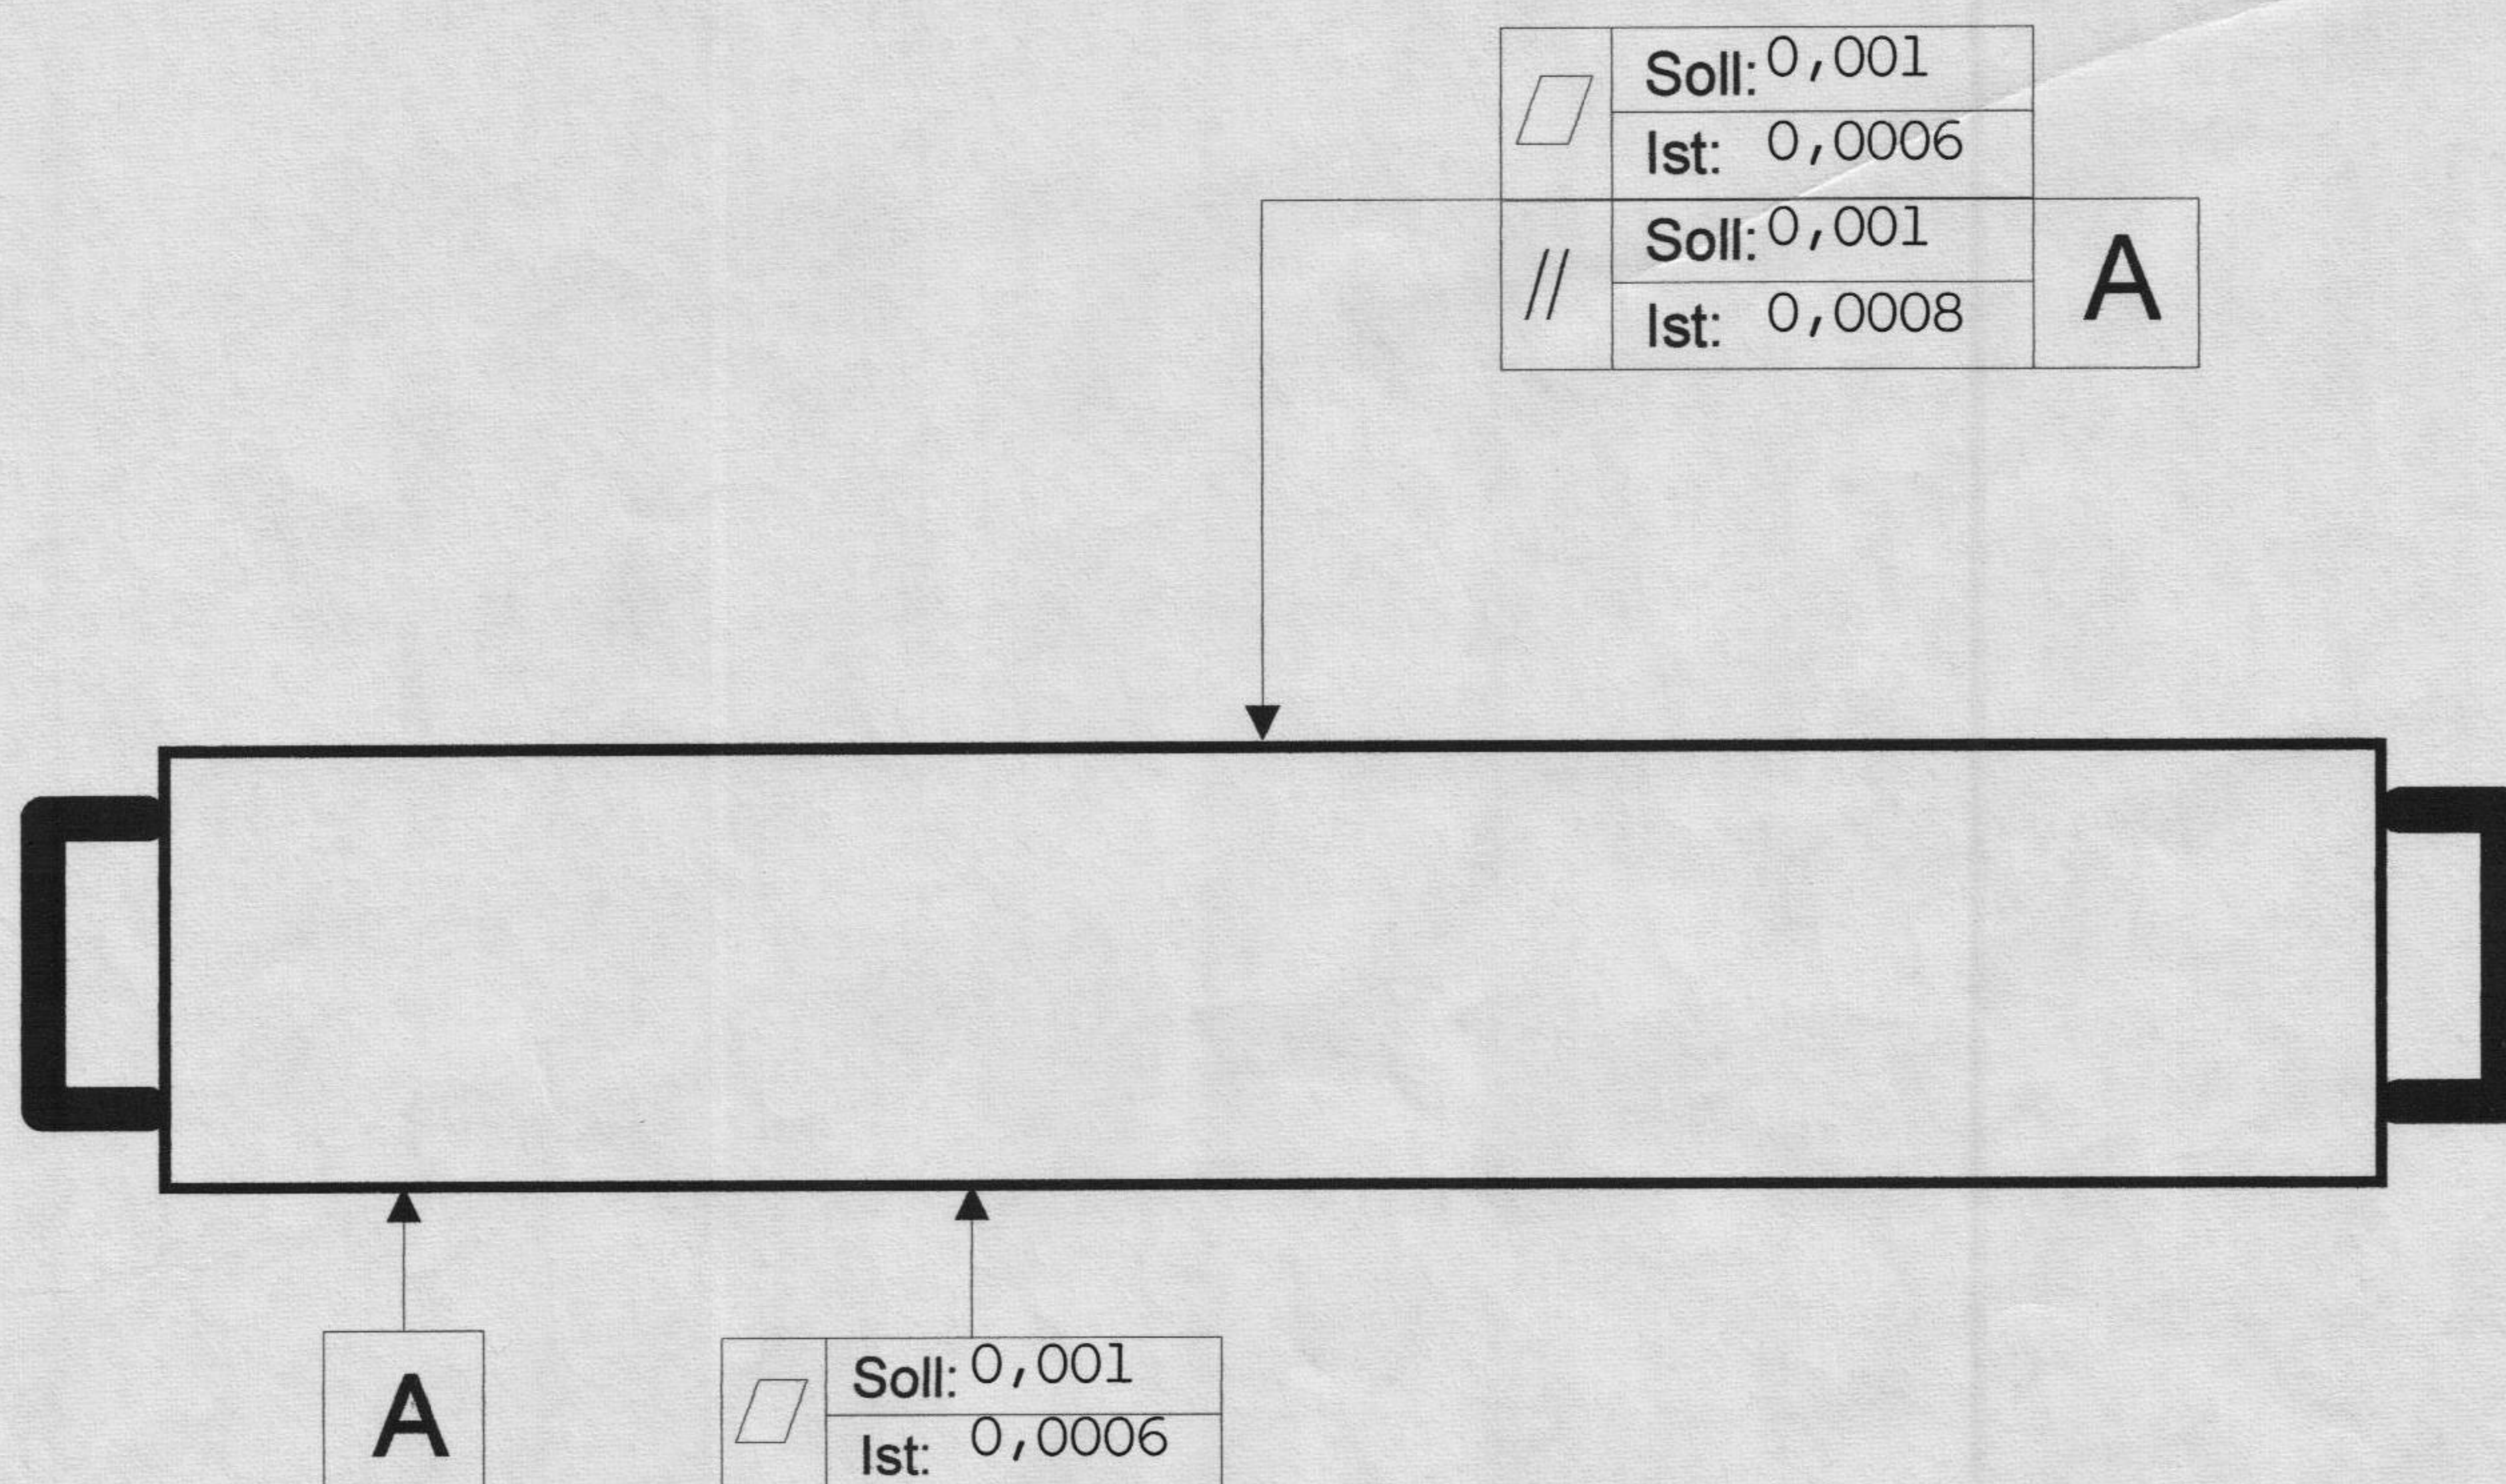

Kunde:

Firma Werkzeug Eylert GmbH & Co. KG

Bestell.-Nr.:

80051955 vom 30.05.2007

Bezugstemperatur + 20°C

Rel. Feuchte (50 +/- 5%)

Datum: 22.06.2007

Prüfer: *Tragesen*

PLANOLITH GmbH \* 63741 Aschaffenburg \* Tel. 06021/3407-0 \* Fax: 3407-30 \* info@planolith.de