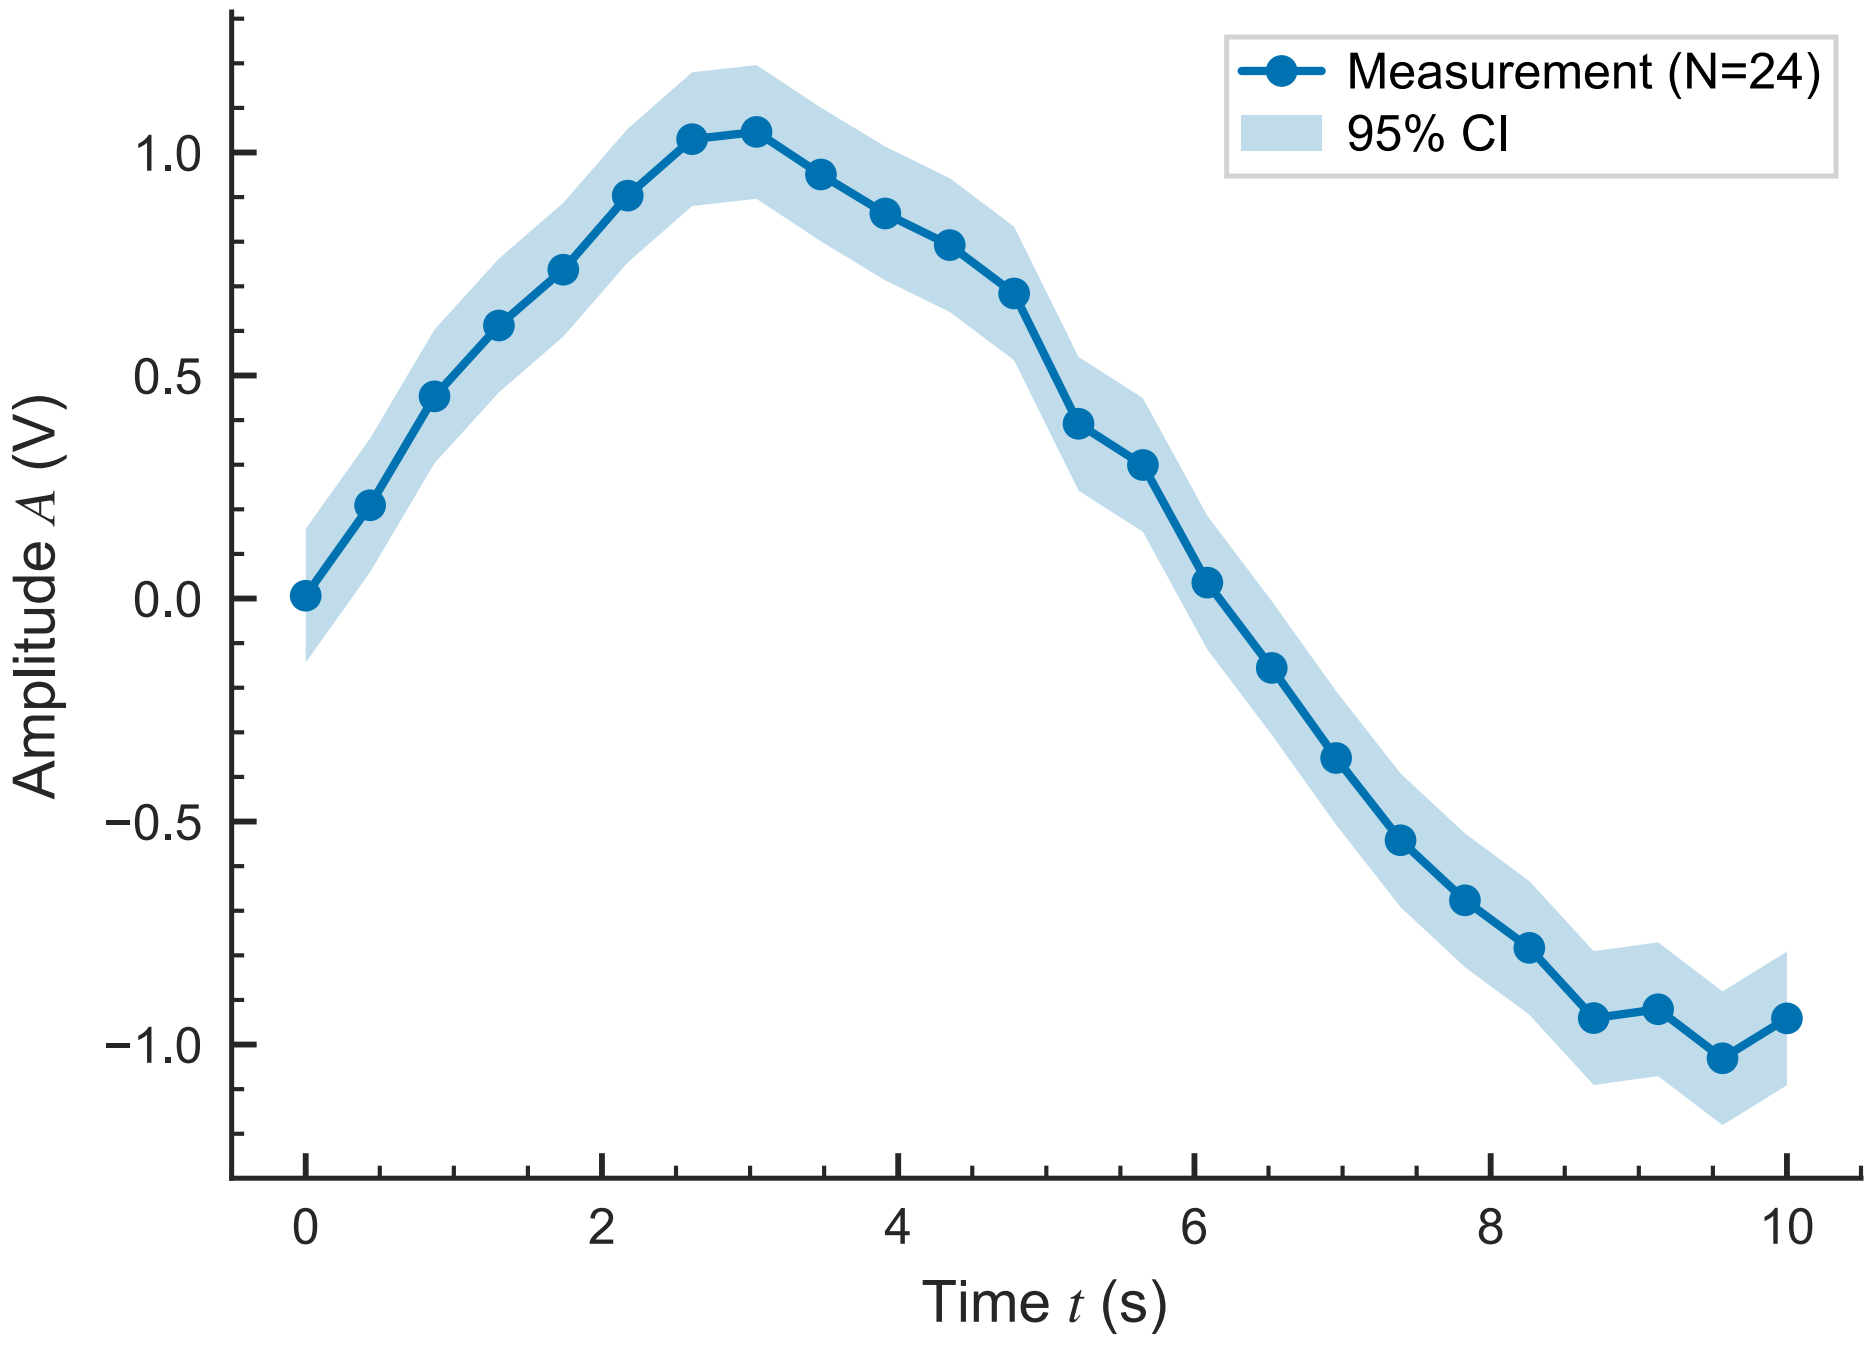
Measurement (N=24)
95% CI
Amplitude A (V)
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
2
4
6
8
10
Time t (s)