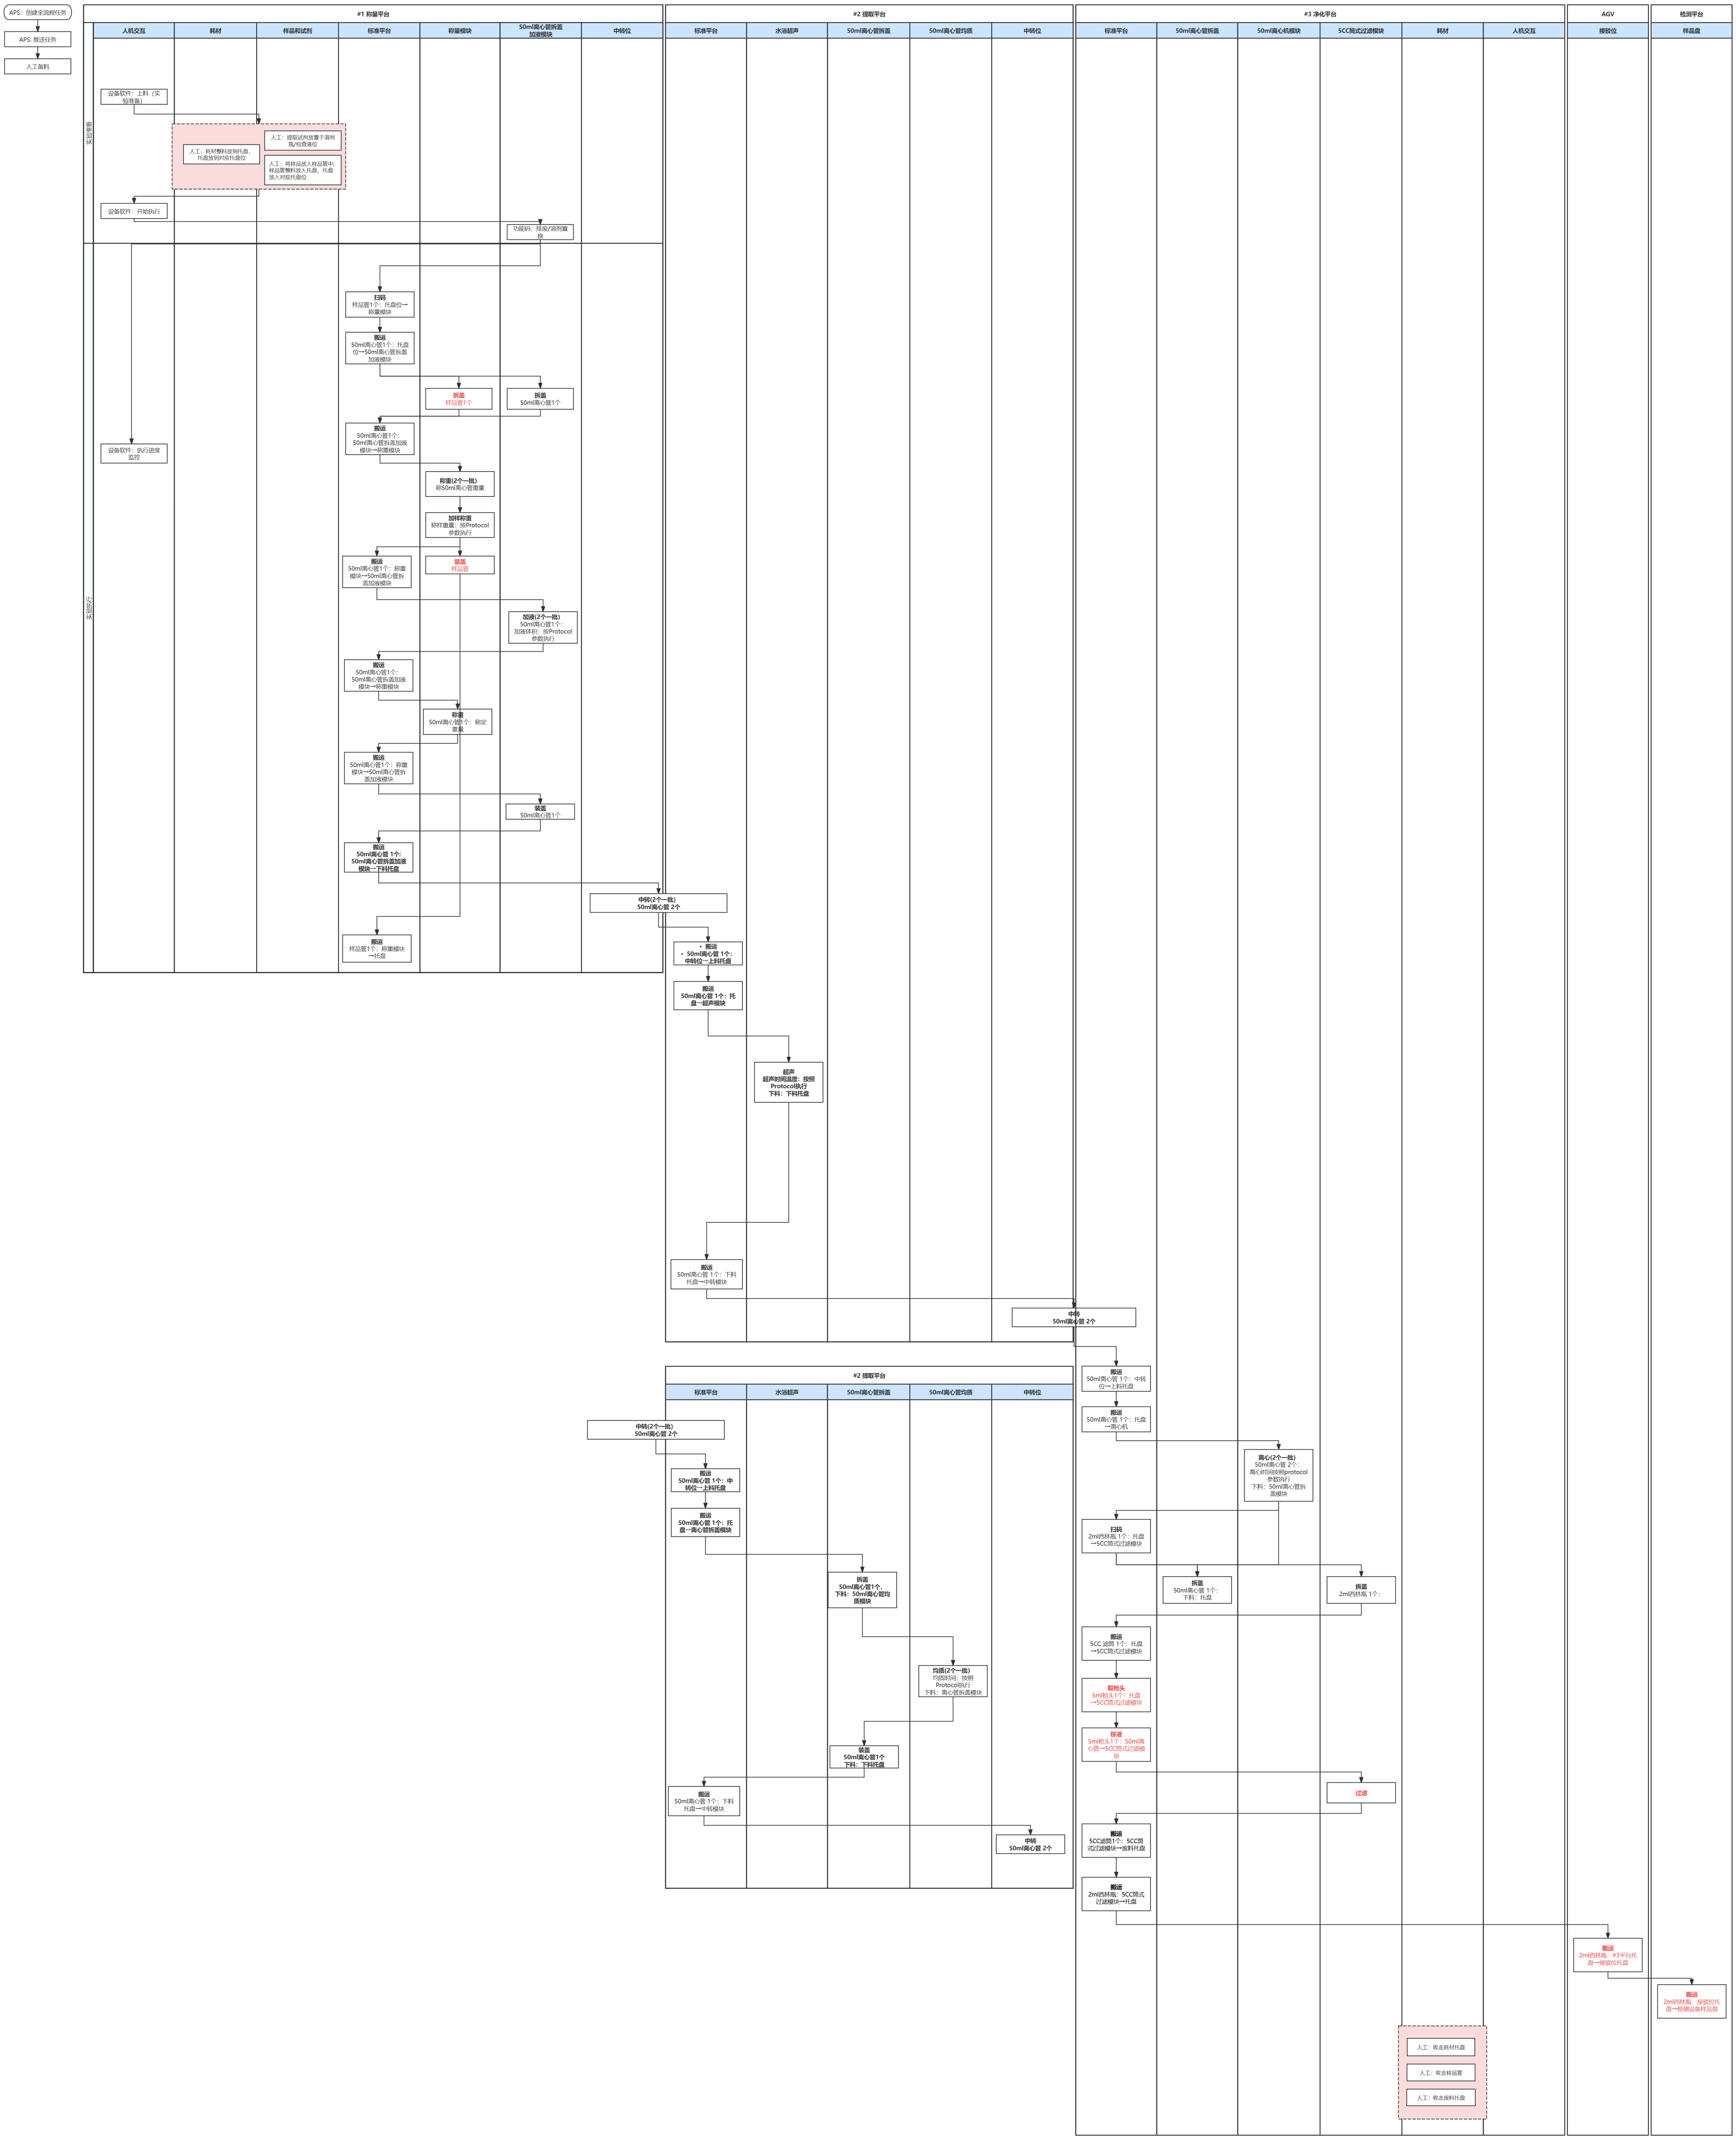
APS：创建全流程任务
APS: 推送任务
人工备料
#1 称量平台
人机交互
耗材
样品和试剂
标准平台
称量模块
50ml离心管拆盖加液模块
中转位
实验准备
设备软件：上料（实验准备）
人工：耗材整料放到托盘，托盘放到对应托盘位
人工：提取试剂放置于溶剂瓶/检查液位
人工：将样品放入样品管中；样品管整料放入托盘，托盘放入对应托盘位
设备软件：开始执行
功能码：排废/溶剂置换
实验执行
扫码
样品管1个：托盘位→称量模块
搬运
50ml离心管1个：托盘位→50ml离心管拆盖加液模块
拆盖
样品管1个
拆盖
50ml离心管1个
搬运
50ml离心管1个：50ml离心管拆盖加液模块→称重模块
设备软件：执行进度监控
称重(2个一批)
称50ml离心管重量
加样称重
称样重量：按Protocol参数执行
搬运
50ml离心管1个：称重模块→50ml离心管拆盖加液模块
装盖
样品管
加液(2个一批)
50ml离心管1个：加液体积：按Protocol参数执行
搬运
50ml离心管1个：50ml离心管拆盖加液模块→称重模块
称重
50ml离心管1个：称定重量
搬运
50ml离心管1个：称重模块→50ml离心管拆盖加液模块
装盖
50ml离心管1个
搬运
50ml离心管 1个：50ml离心管拆盖加液模块→下料托盘
中转(2个一批)
50ml离心管 2个
搬运
样品管1个：称重模块→托盘
#2 提取平台
标准平台
水浴超声
50ml离心管拆盖
50ml离心管均质
中转位
• 搬运
• 50ml离心管 1个：中转位→上料托盘
搬运
50ml离心管 1个：托盘→超声模块
超声
超声时间温度：按照Protocol执行
下料：下料托盘
搬运
50ml离心管 1个：下料托盘→中转模块
中转
50ml离心管 2个
#2 提取平台
标准平台
水浴超声
50ml离心管拆盖
50ml离心管均质
中转位
中转(2个一批)
50ml离心管 2个
搬运
50ml离心管 1个：中转位→上料托盘
搬运
50ml离心管 1个：托盘→离心管拆盖模块
拆盖
50ml离心管1个，
下料：50ml离心管均质模块
均质(2个一批)
均质时间：按照Protocol执行
下料：离心管拆盖模块
装盖
50ml离心管1个
下料：下料托盘
搬运
50ml离心管 1个：下料托盘→中转模块
中转
50ml离心管 2个
#3 净化平台
标准平台
50ml离心管拆盖
50ml离心机模块
5CC筒式过滤模块
耗材
人机交互
搬运
50ml离心管 1个：中转位→上料托盘
搬运
50ml离心管 1个：托盘→离心机
离心(2个一批)
50ml离心管 2个：
离心时间按照protocol参数执行
下料：50ml离心管拆盖模块
扫码
2ml西林瓶 1个：托盘→5CC筒式过滤模块
拆盖
50ml离心管 1个：
下料：托盘
拆盖
2ml西林瓶 1个：
搬运
5CC 滤筒 1个：托盘→5CC筒式过滤模块
取枪头
5ml枪头1个：托盘→5CC筒式过滤模块
移液
5ml枪头1个：50ml离心管→5CC筒式过滤模块
过滤
搬运
5CC滤筒1个：5CC筒式过滤模块→废料托盘
搬运
2ml西林瓶：5CC筒式过滤模块→托盘
人工：收走耗材托盘
人工：收走样品管
人工：收走废料托盘
AGV
接驳位
搬运
2ml西林瓶：#3平台托盘→接驳位托盘
检测平台
样品盘
搬运
2ml西林瓶：接驳位托盘→检测设备样品盘