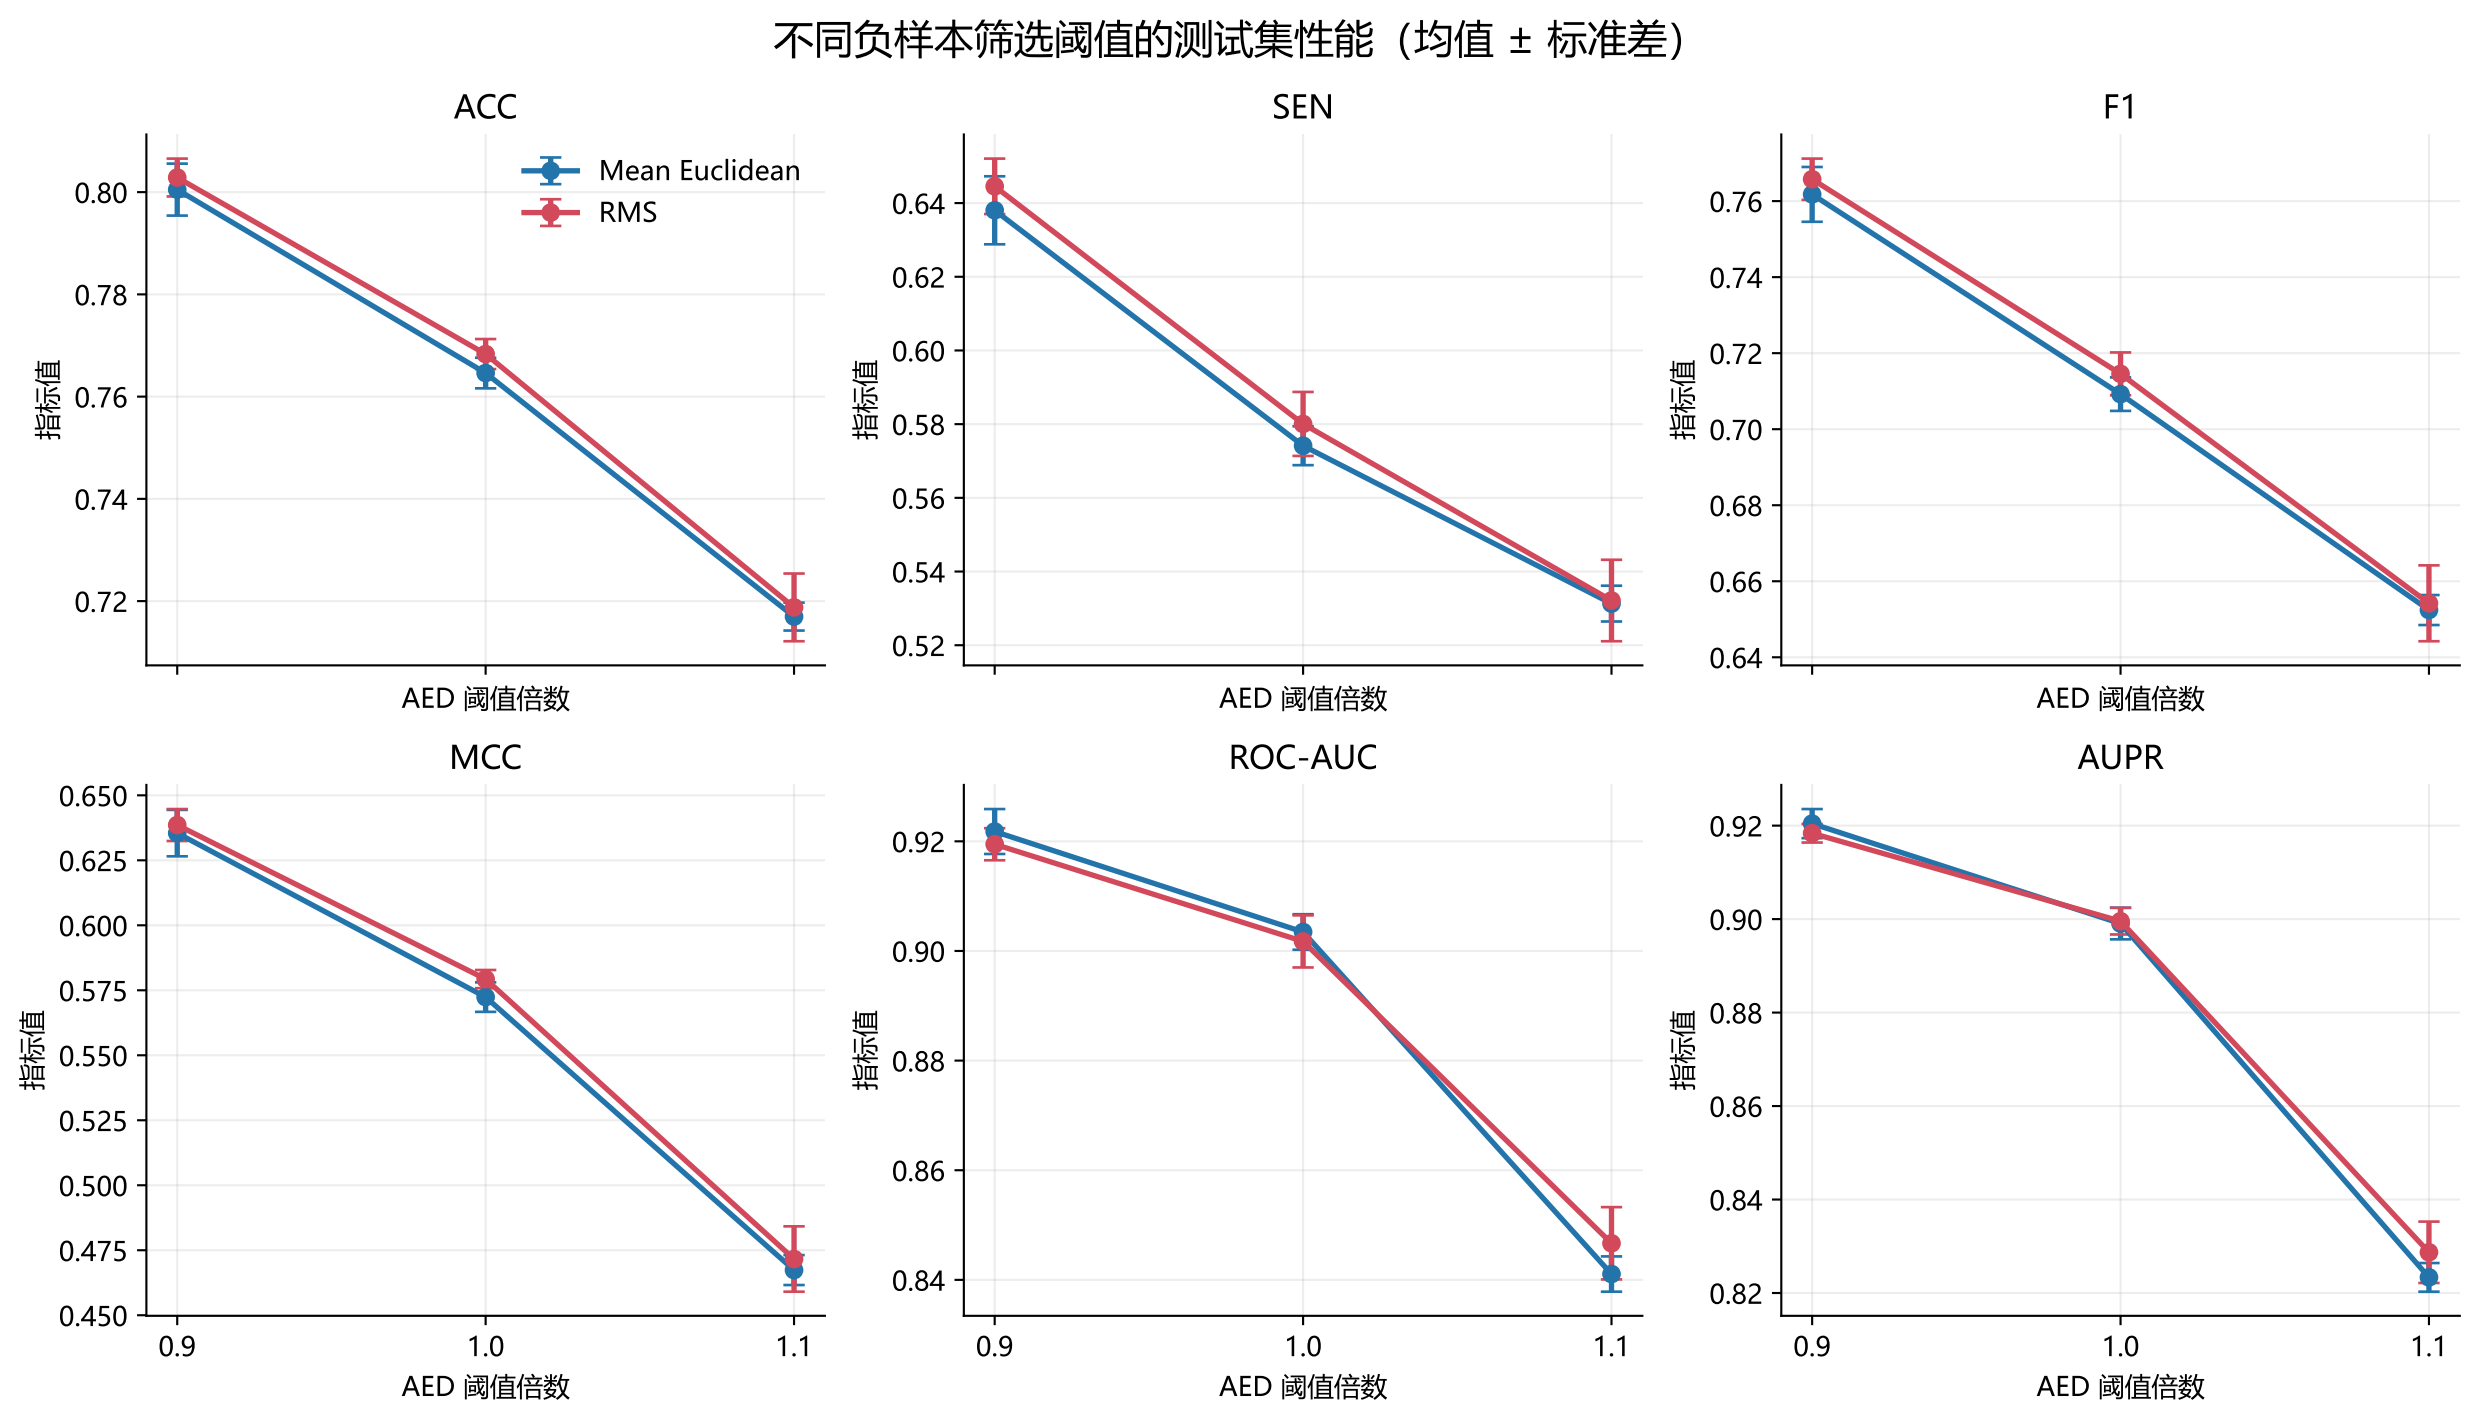
不同负样本筛选阈值的测试集性能（均值 ± 标准差）
ACC
SEN
F1
MCC
ROC-AUC
AUPR
Mean Euclidean
RMS
指标值
AED 阈值倍数
0.9
1.0
1.1