

PACIENTE: 11510330 - CECILIA MARIA ALBERGARIA SILVA

SEXO: Feminino

DATA DE NASCIMENTO: 30/06/2020 IDADE: 3 Anos

ATENDIMENTO: 1768731

DATA: 31/10/2023

MÉDICO: CRISTIANA CAMPOS ALVES

CRM: 46514

RELATÓRIO MÉDICO

(ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER USADO COMO EVOLUÇÃO)

TOPOGRAFIA DE CORNEA:

Imagens obtidas pelo ORBSCAN:

Data: 31/10/23

OLHO DIREITO:

Ceratometria:

44,7/ 46,7dx 90

Thinnest: 554 micra

Astigmatismo discretamente irregular, mantendo boa simetria. Valores ceratometricos acima da normalidade.

OLHO ESQUERDO:

46,0/ 47,5dx 85

Thinnest: 568 micra

Astigmatismo discretamente irregular, mantendo boa simetria. Valores ceratometricos acima da normalidade.

Sugiro controle topografico em 6 meses.

A disposição,

Dra. Cristiana Campos Alves
MÉDICA
CRM MG 46514
CONTROLE 1888132

CRISTIANA CAMPOS ALVES



- CRM 46514

Centro Oftalmológico de Minas Gerais - 17.357.641/0001-09

Rua Santa Catarina, Nº 941 - Lourdes - BH - Minas Gerais Tel (31)32324100

Axial Power

Keratometric

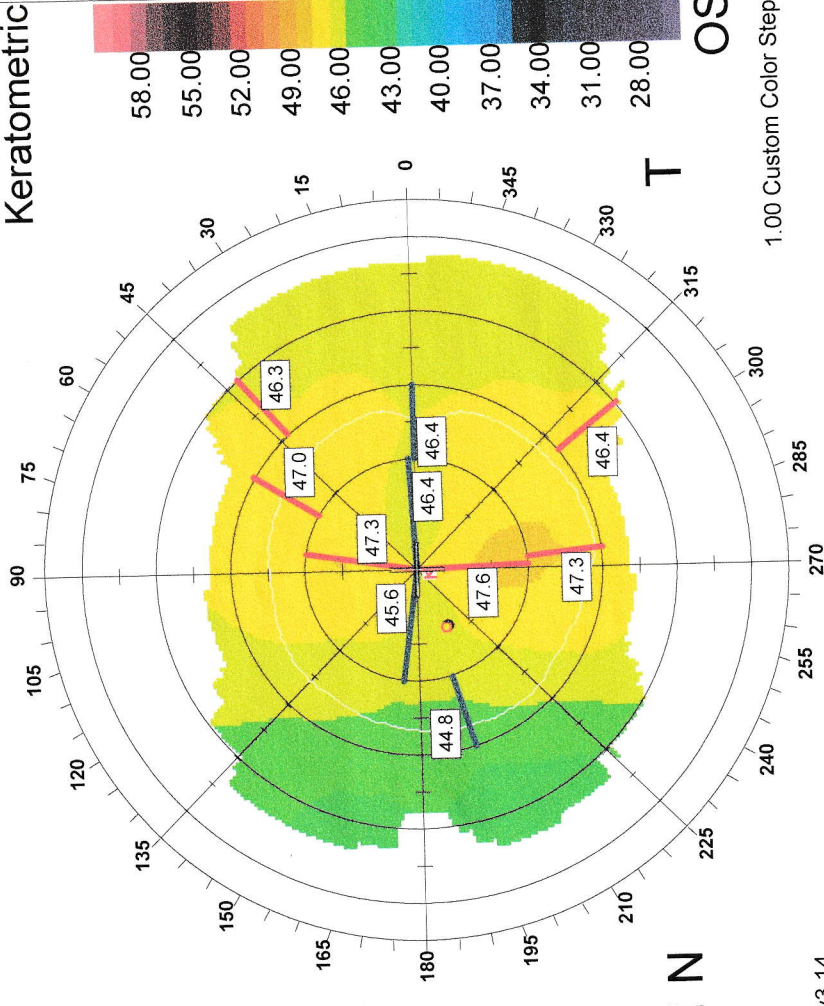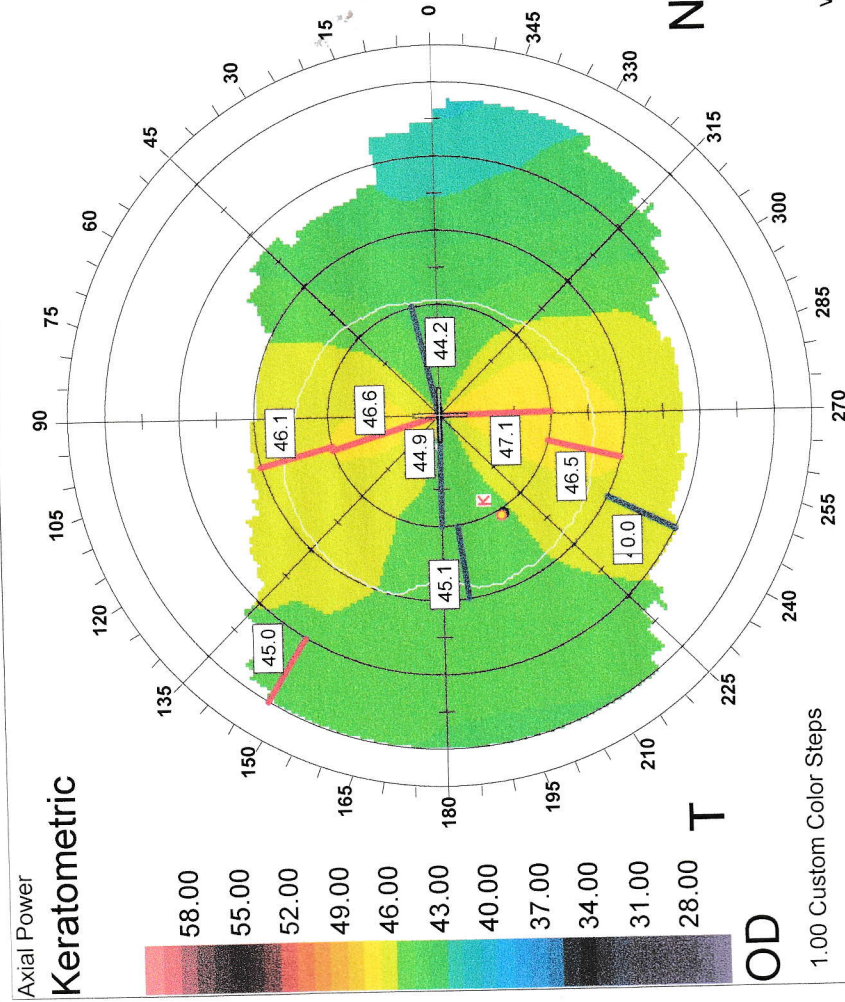

OD

1.00 Custom Color Steps

v3.14

Sim K's: Astig: -2.0 D @ 180 deg
Max: 46.7 D @ 90 deg
Min: 44.7 D @ 180 deg

3.0 MM Zone: Irreg: ± 2.2 D
Mean Pwr: 45.7 ± 1.6 D
Astig Pwr: 1.0 ± 1.5 D
Steep Axis: 94 ± 42 deg
Flat Axis: 12 ± 42 deg

5.0 MM Zone: Irreg: ± 2.3 D
Mean Pwr: 44.8 ± 1.6 D
Astig Pwr: 1.1 ± 1.7 D
Steep Axis: 88 ± 42 deg
Flat Axis: 3 ± 41 deg

Power: 44.91 D
Meridian: 0°
Radius: 0.0 mm

White-to-White [mm]: 10.9
Pupil Diameter [mm]: 4.1
Thinnest: 554 um @ (-1.4, -0.8)
ACD (Endo): 2.19 mm
Kappa: 8.29° @ 193.03°
Kappa Intercept: -1.19, -0.53

SILVA, CECILIA MARIA A
N2 Y155041 M11621
10/31/2023 12:41:22 PM

Power: 46.04 D
Meridian: 180°
Radius: 0.0 mm

White-to-White [mm]: 10.9
Pupil Diameter [mm]: 4.3
Thinnest: 568 um @ (-0.8, -0.4)
ACD (Endo): 2.22 mm
Kappa: 3.63° @ 328.09°
Kappa Intercept: -0.07, -0.14

SILVA, CECILIA MARIA A
N2 Y155041 M11621
10/31/2023 12:43:13 PM

Sim K's: Astig: -1.6 D @ 175 deg
Max: 47.5 D @ 85 deg
Min: 46.0 D @ 175 deg

3.0 MM Zone: Irreg: ± 2.2 D
Mean Pwr: 46.7 ± 1.6 D
Astig Pwr: 0.6 ± 1.5 D
Steep Axis: 80 ± 48 deg
Flat Axis: 21 ± 48 deg

5.0 MM Zone: Irreg: ± 3.3 D
Mean Pwr: 45.5 ± 2.1 D
Astig Pwr: 0.3 ± 2.5 D
Steep Axis: 172 ± 49 deg
Flat Axis: 147 ± 49 deg