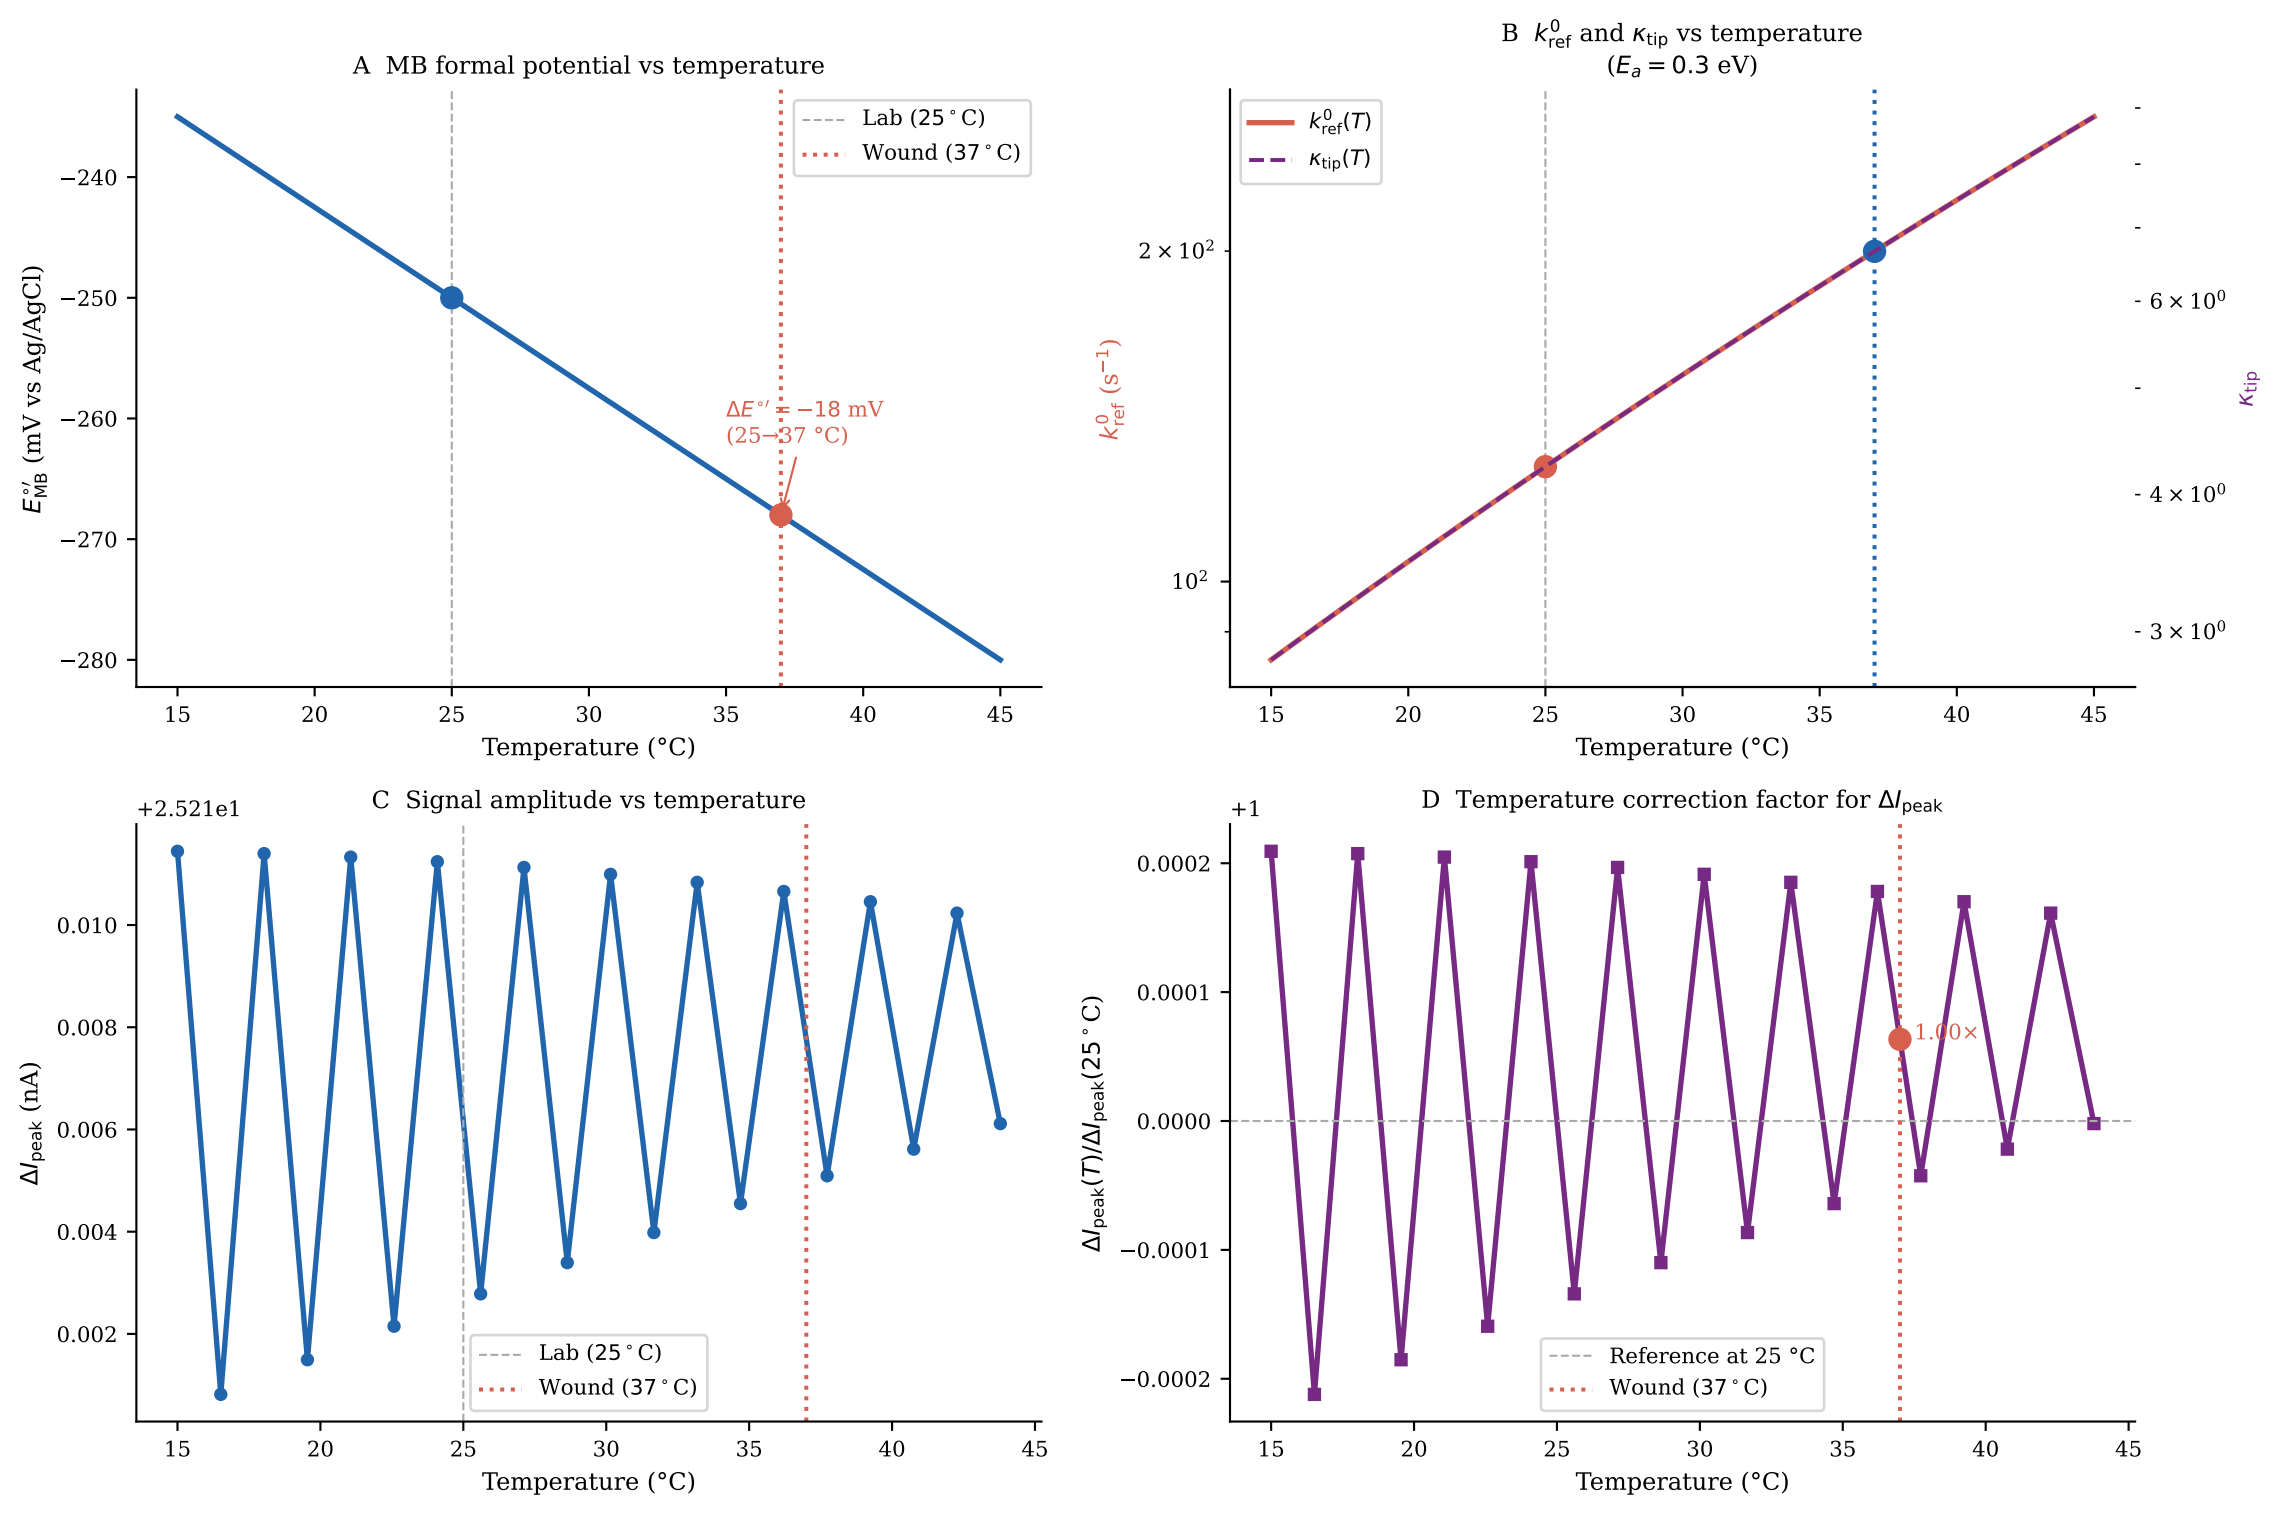
A MB formal potential vs temperature
Lab (25 °C)
Wound (37 °C)
ΔE°′ = −18 mV
(25–37 °C)
E°′MB (mV vs Ag/AgCl)
Temperature (°C)
B k⁰ref and κtip vs temperature
(Ea = 0.3 eV)
k⁰ref(T)
κtip(T)
k⁰ref (s⁻¹)
κtip
Temperature (°C)
C Signal amplitude vs temperature
+2.521e1
ΔIpeak (nA)
Lab (25 °C)
Wound (37 °C)
Temperature (°C)
D Temperature correction factor for ΔIpeak
+1
1.00×
ΔIpeak(T)/ΔIpeak(25 °C)
Reference at 25 °C
Wound (37 °C)
Temperature (°C)