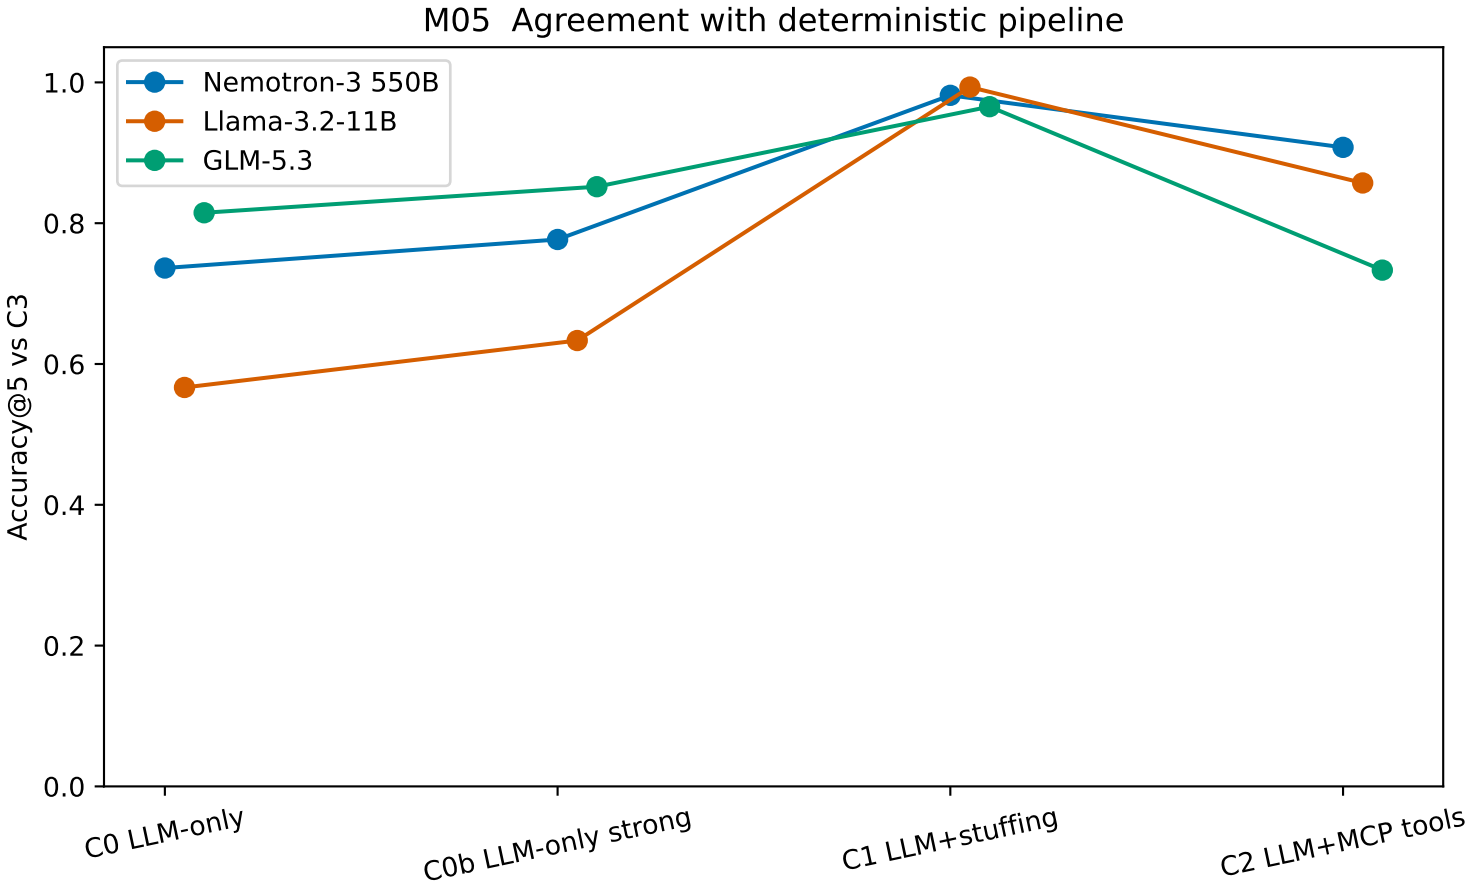
M05 Agreement with deterministic pipeline
Nemotron-3 550B
Llama-3.2-11B
GLM-5.3
Accuracy@5 vs C3
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C0 LLM-only
C0b LLM-only strong
C1 LLM+stuffing
C2 LLM+MCP tools