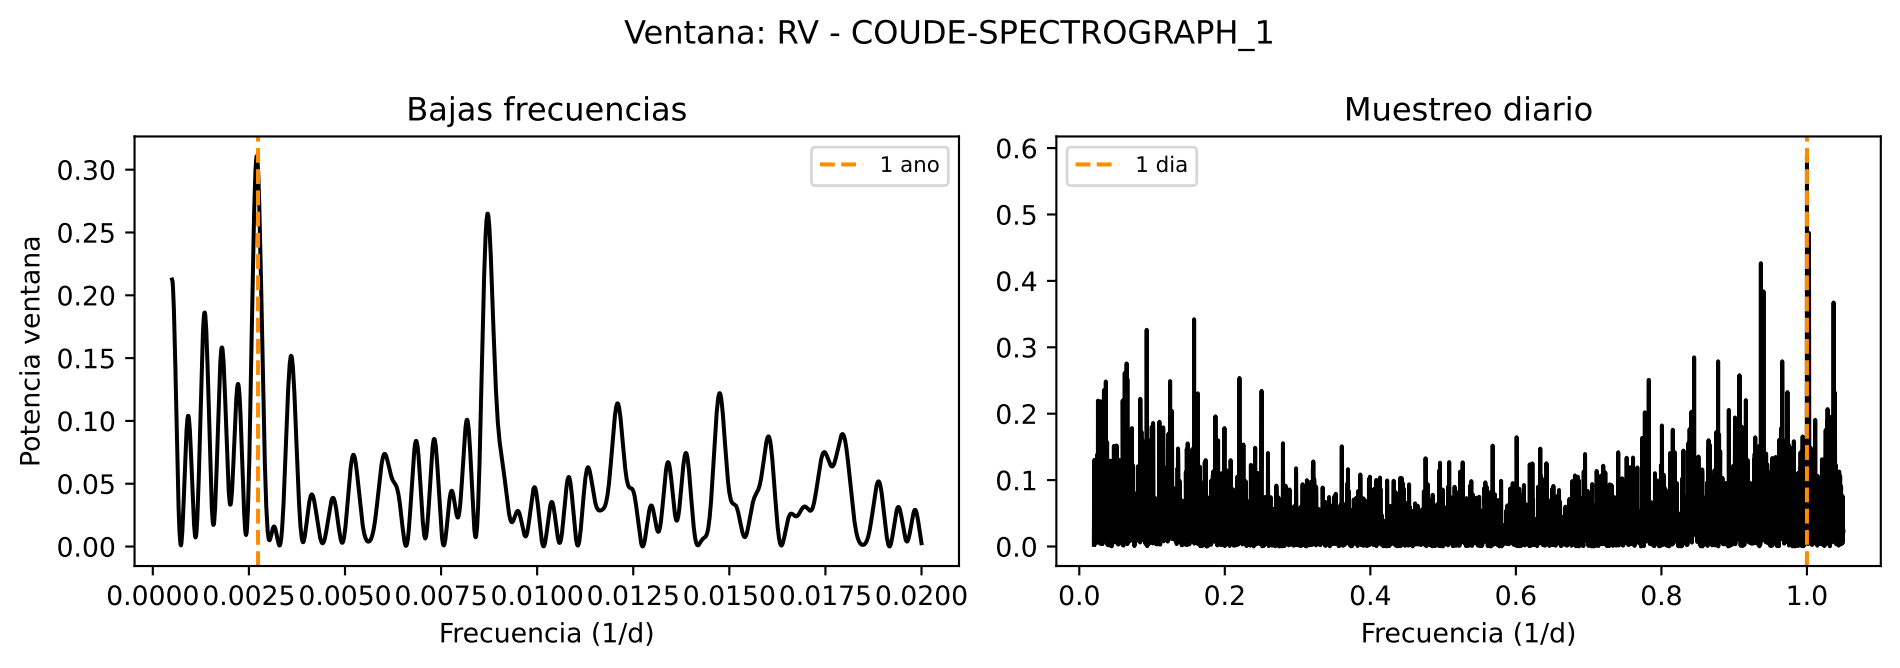
Ventana: RV - COUDE-SPECTROGRAPH_1
Bajas frecuencias
Muestreo diario
1 ano
1 dia
Potencia ventana
Frecuencia (1/d)
Frecuencia (1/d)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.0000
0.0025
0.0050
0.0075
0.0100
0.0125
0.0150
0.0175
0.0200
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0