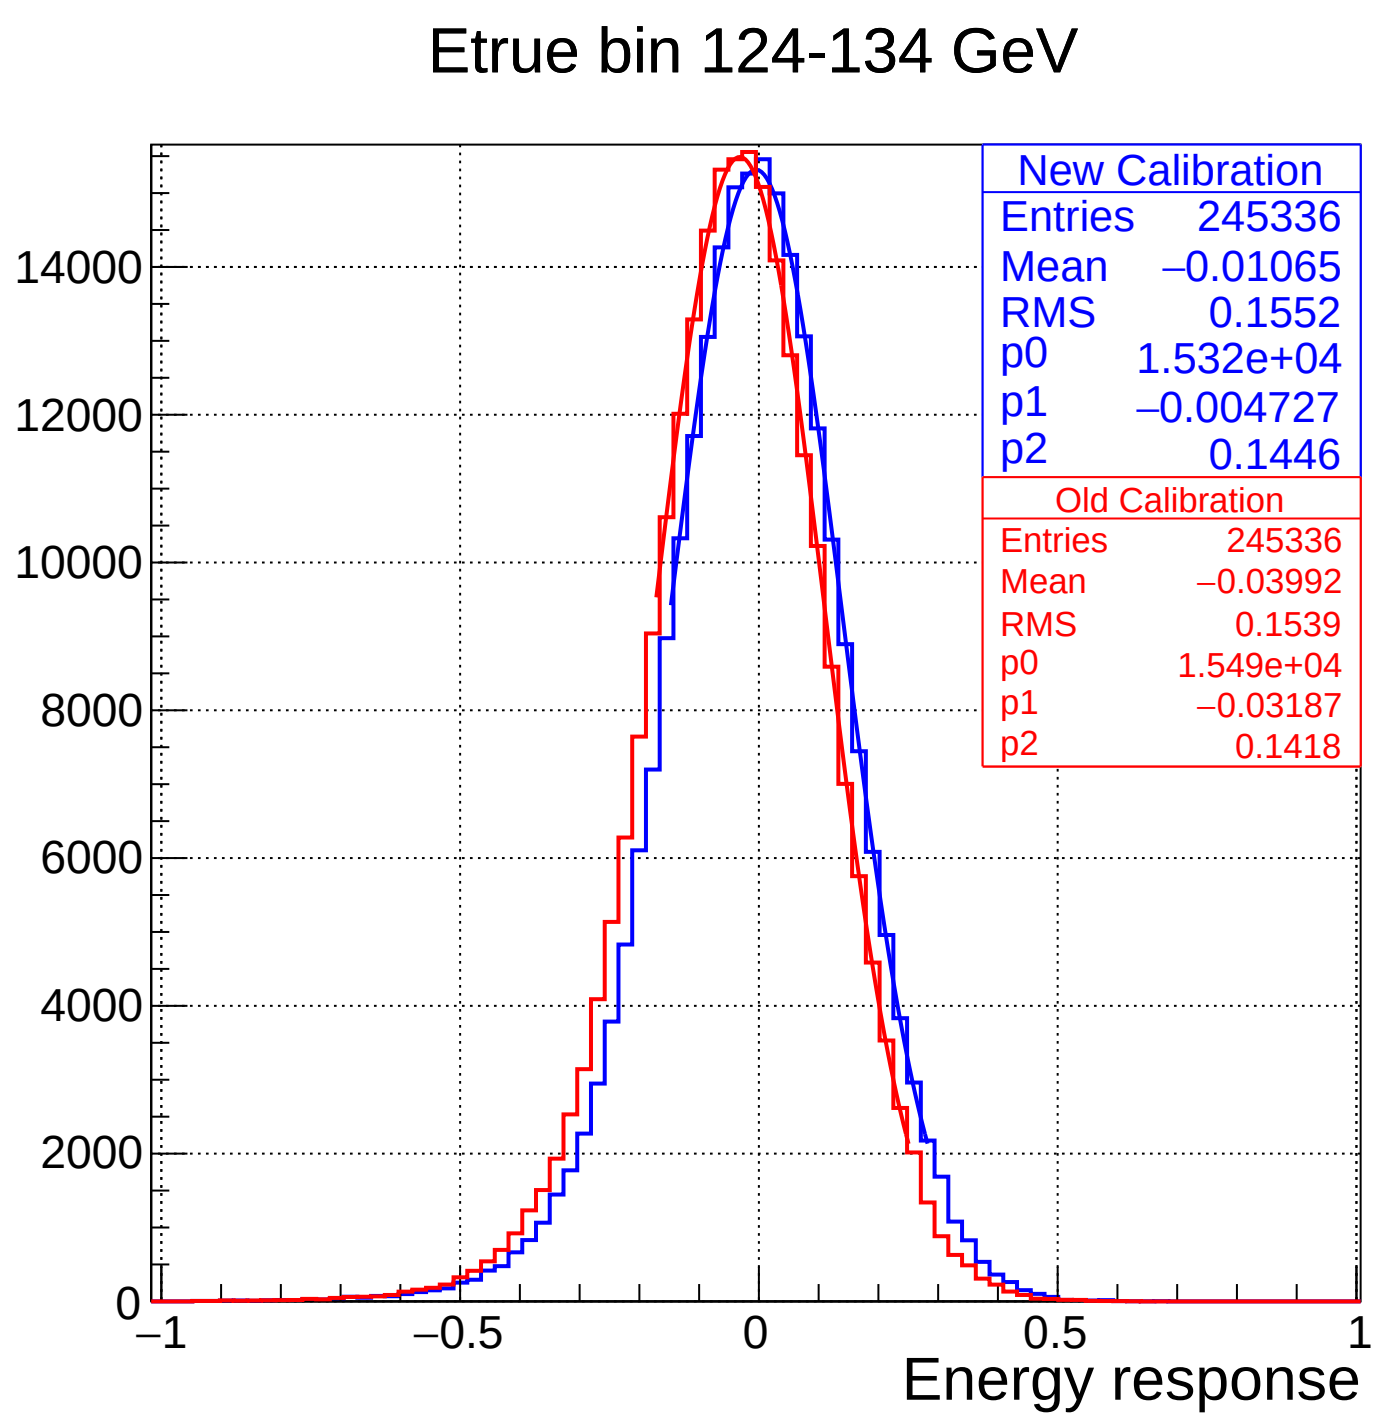
Etrue bin 124-134 GeV
New Calibration
Entries 245336
Mean –0.01065
RMS 0.1552
p0 1.532e+04
p1 –0.004727
p2 0.1446
Old Calibration
Entries 245336
Mean –0.03992
RMS 0.1539
p0 1.549e+04
p1 –0.03187
p2 0.1418
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
–1
–0.5
0
0.5
1
Energy response