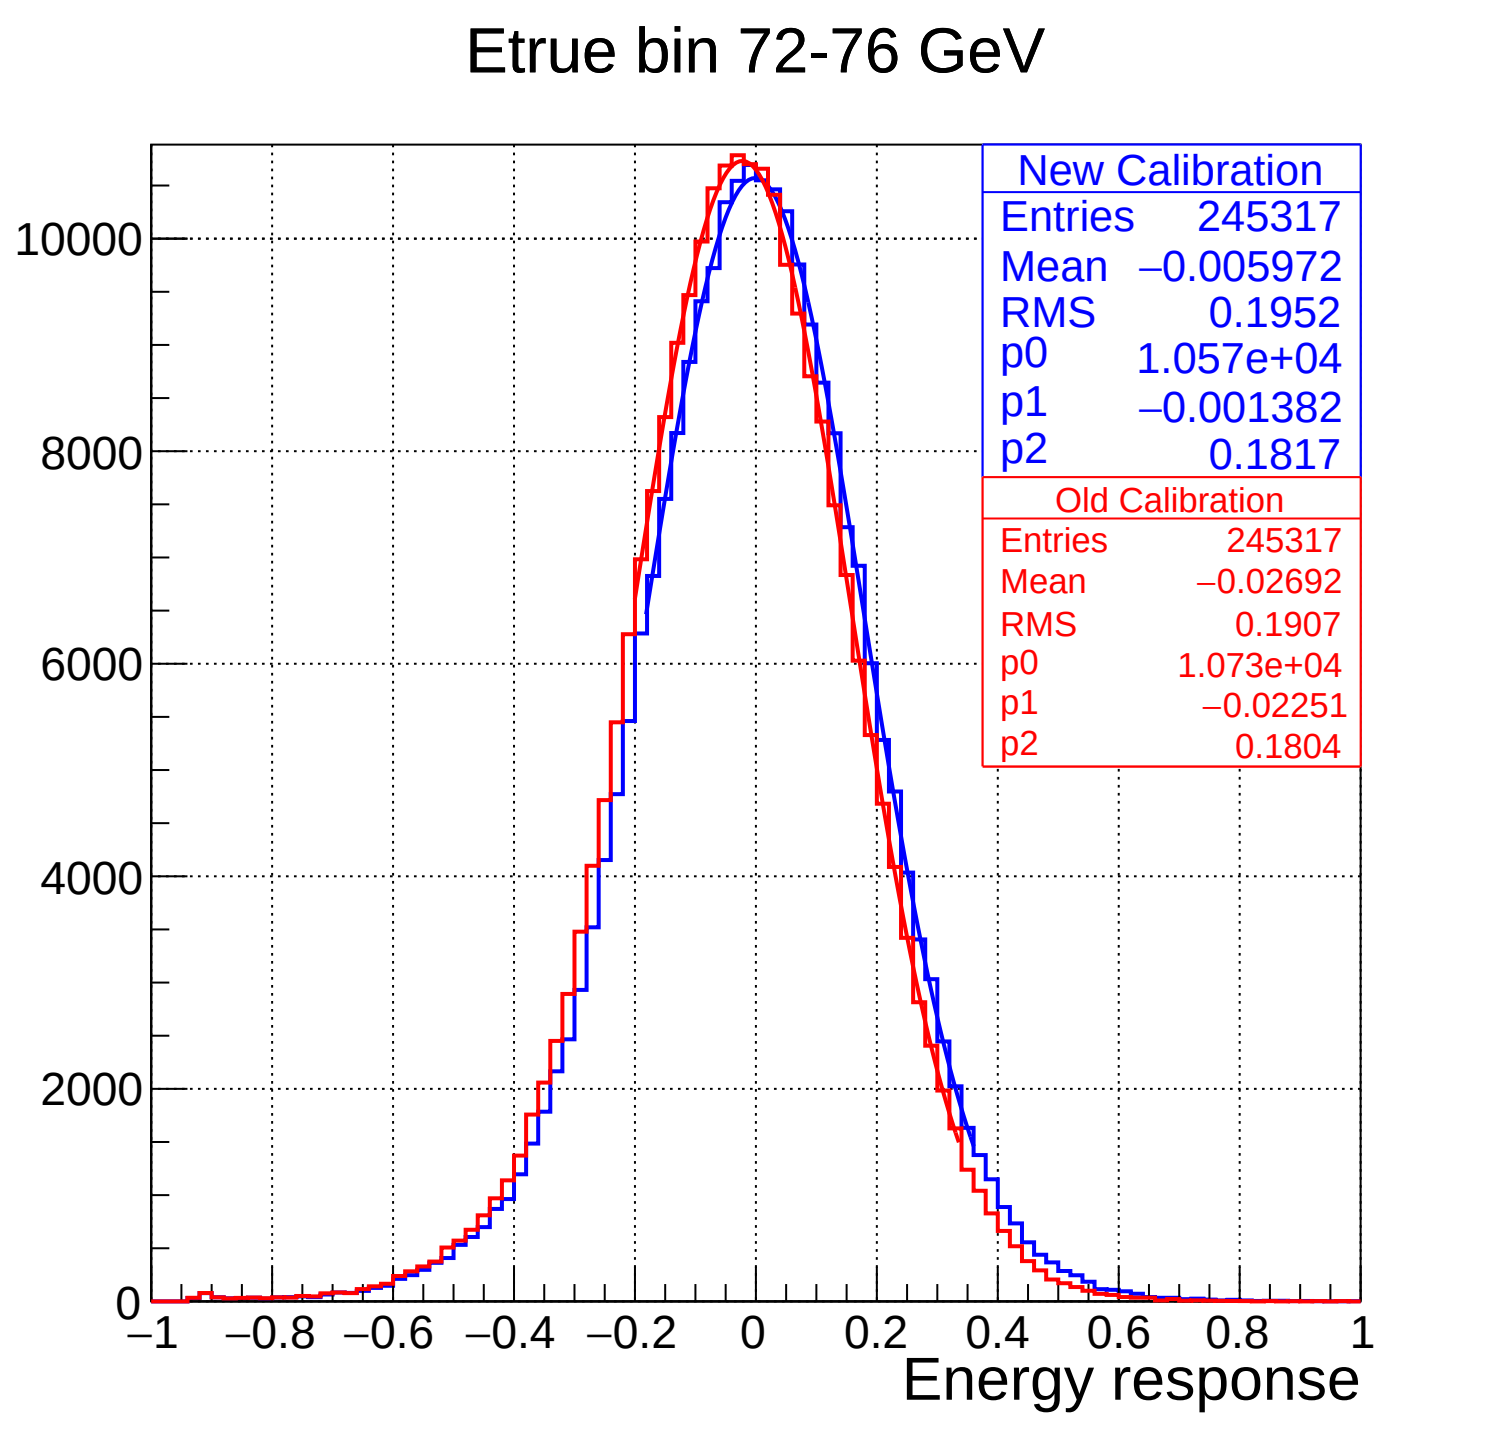
Etrue bin 72-76 GeV
New Calibration
Entries 245317
Mean −0.005972
RMS 0.1952
p0 1.057e+04
p1 −0.001382
p2 0.1817
Old Calibration
Entries 245317
Mean −0.02692
RMS 0.1907
p0 1.073e+04
p1 −0.02251
p2 0.1804
10000
8000
6000
4000
2000
0
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response