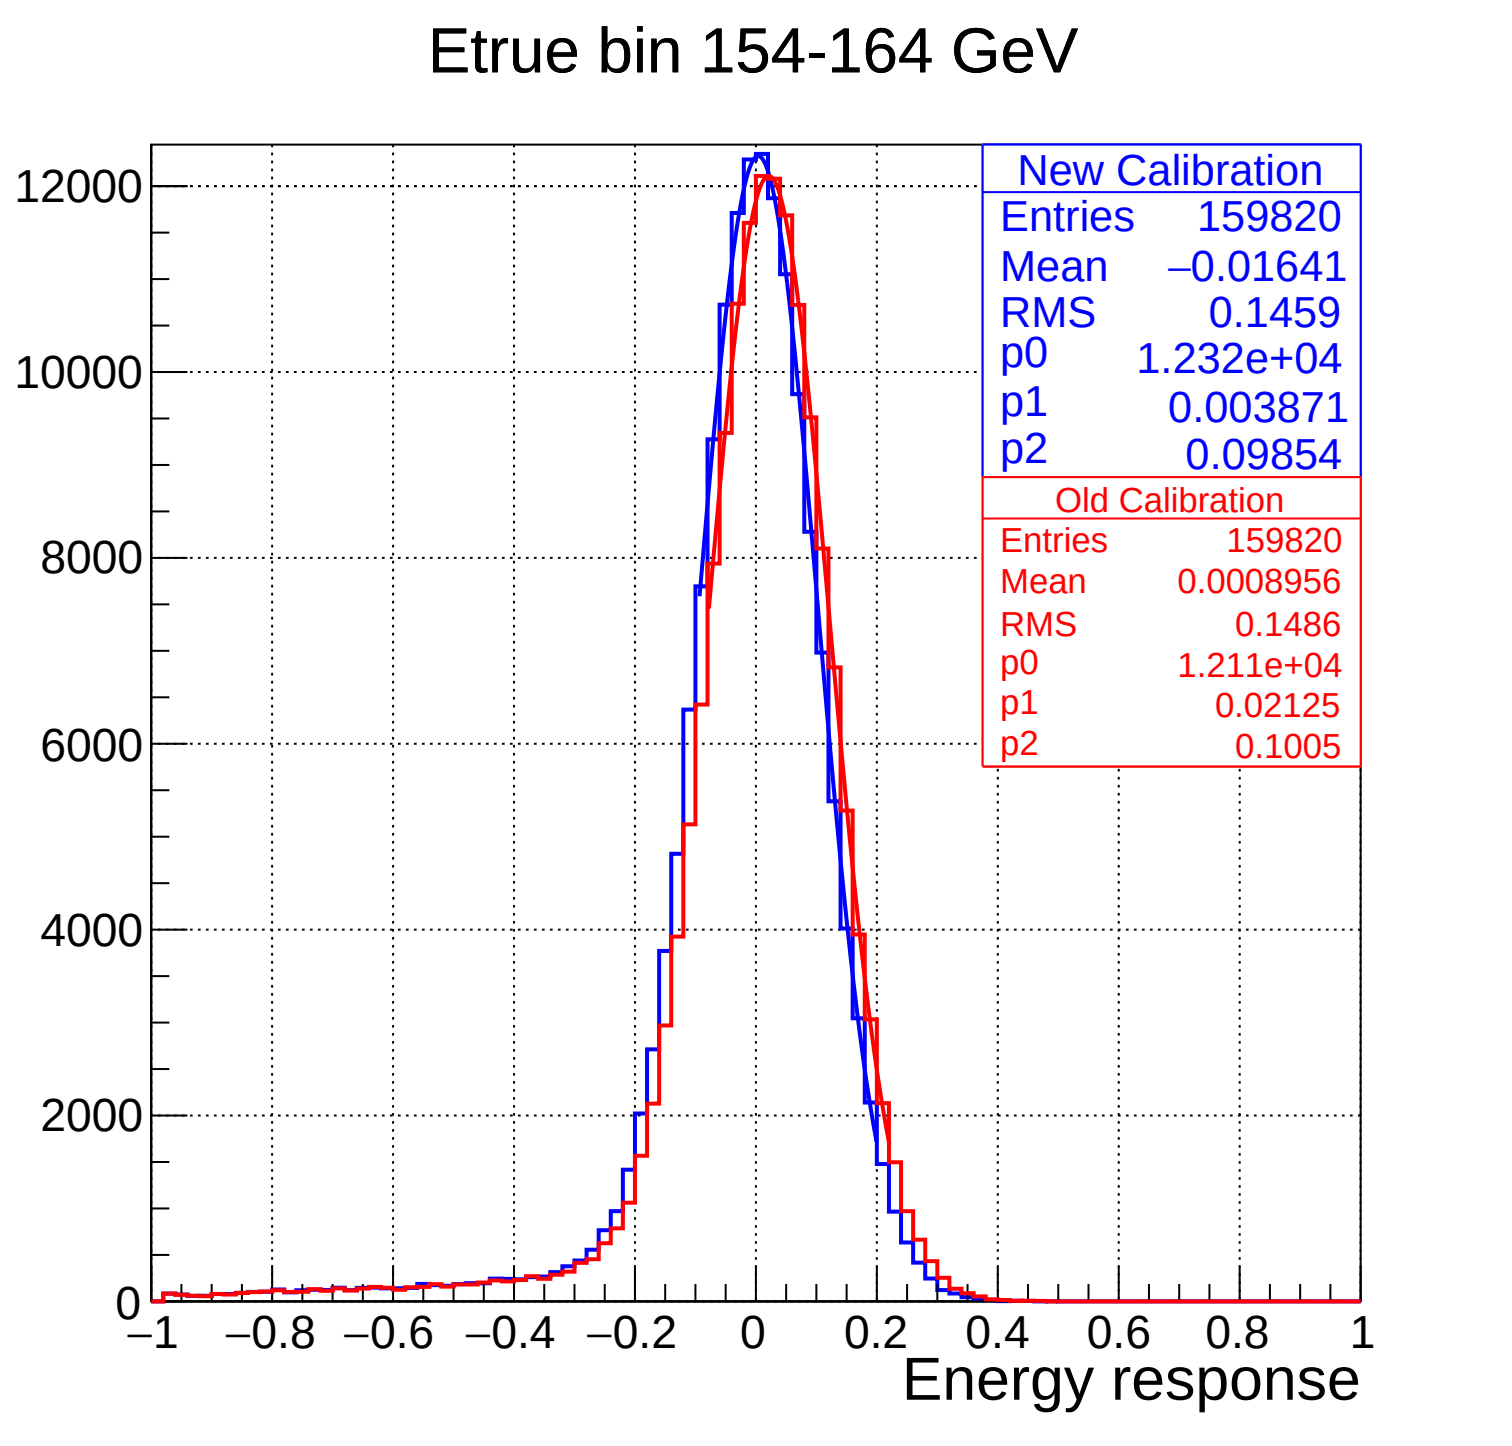
Etrue bin 154-164 GeV
New Calibration
Entries 159820
Mean –0.01641
RMS 0.1459
p0 1.232e+04
p1 0.003871
p2 0.09854
Old Calibration
Entries 159820
Mean 0.0008956
RMS 0.1486
p0 1.211e+04
p1 0.02125
p2 0.1005
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response