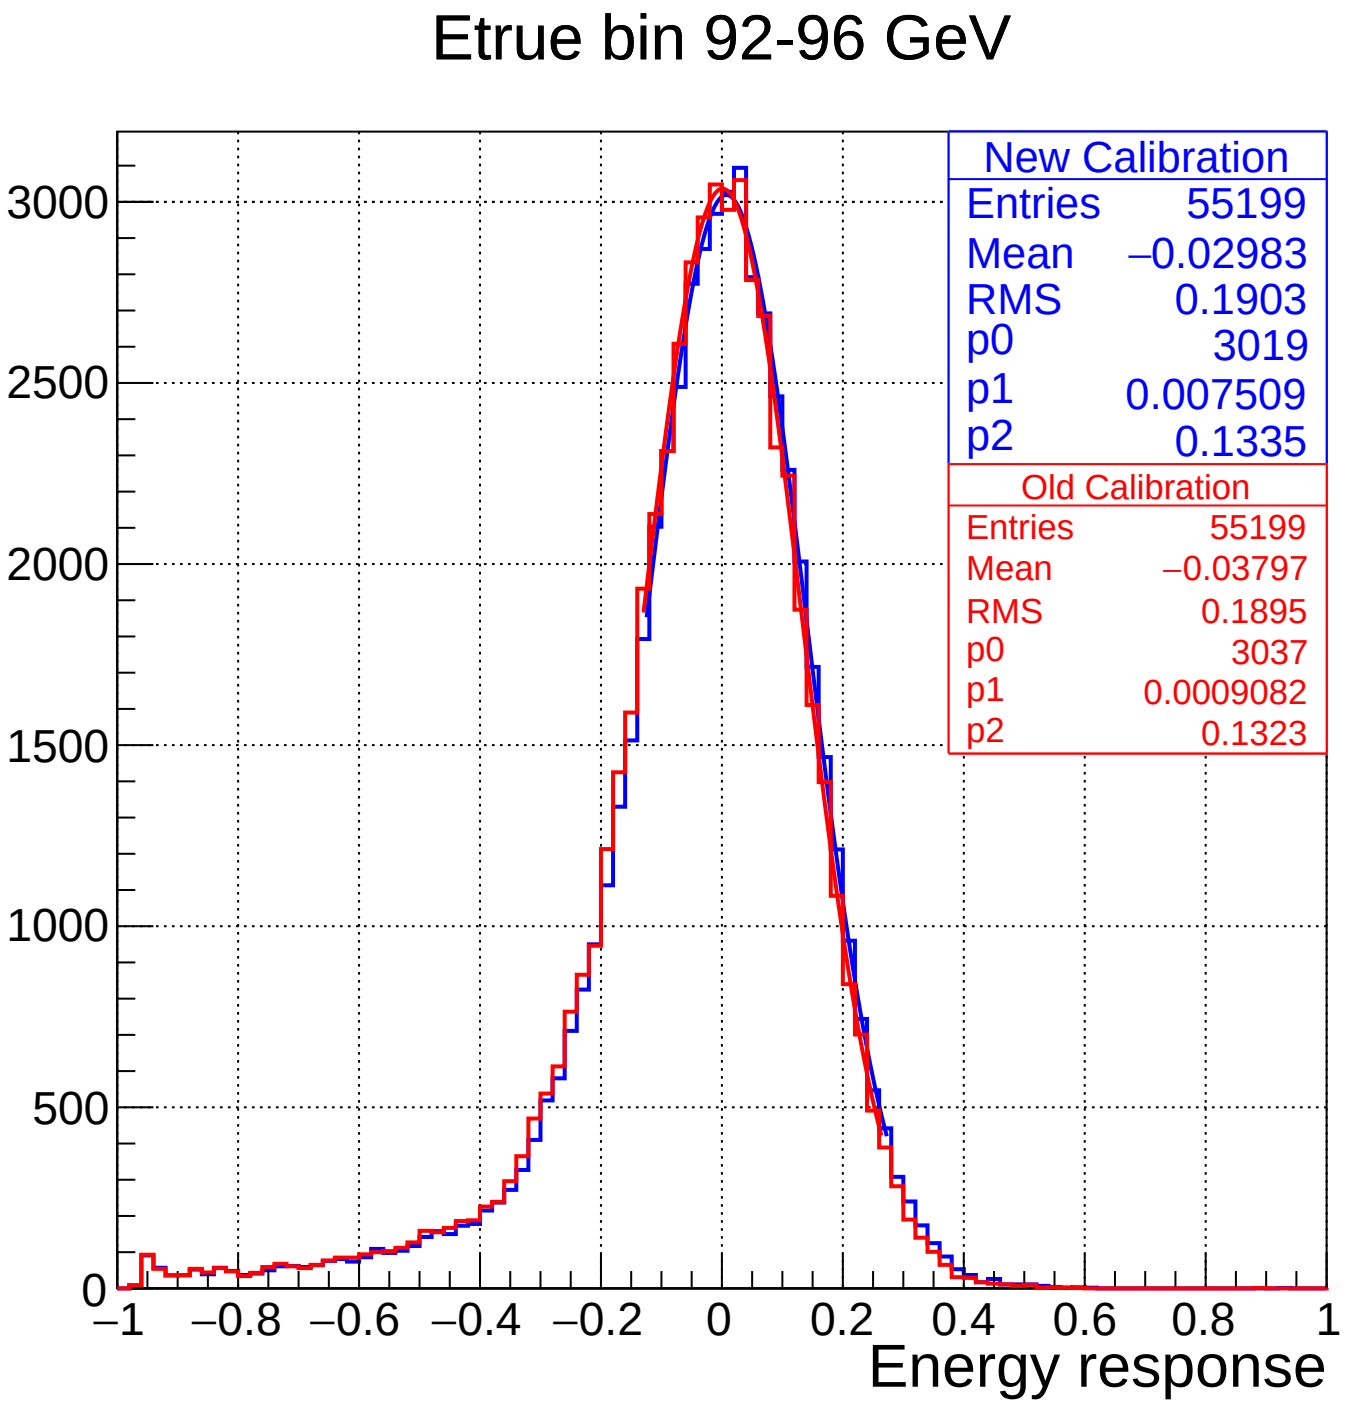
Etrue bin 92-96 GeV
New Calibration
Entries 55199
Mean –0.02983
RMS 0.1903
p0 3019
p1 0.007509
p2 0.1335
Old Calibration
Entries 55199
Mean –0.03797
RMS 0.1895
p0 3037
p1 0.0009082
p2 0.1323
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response