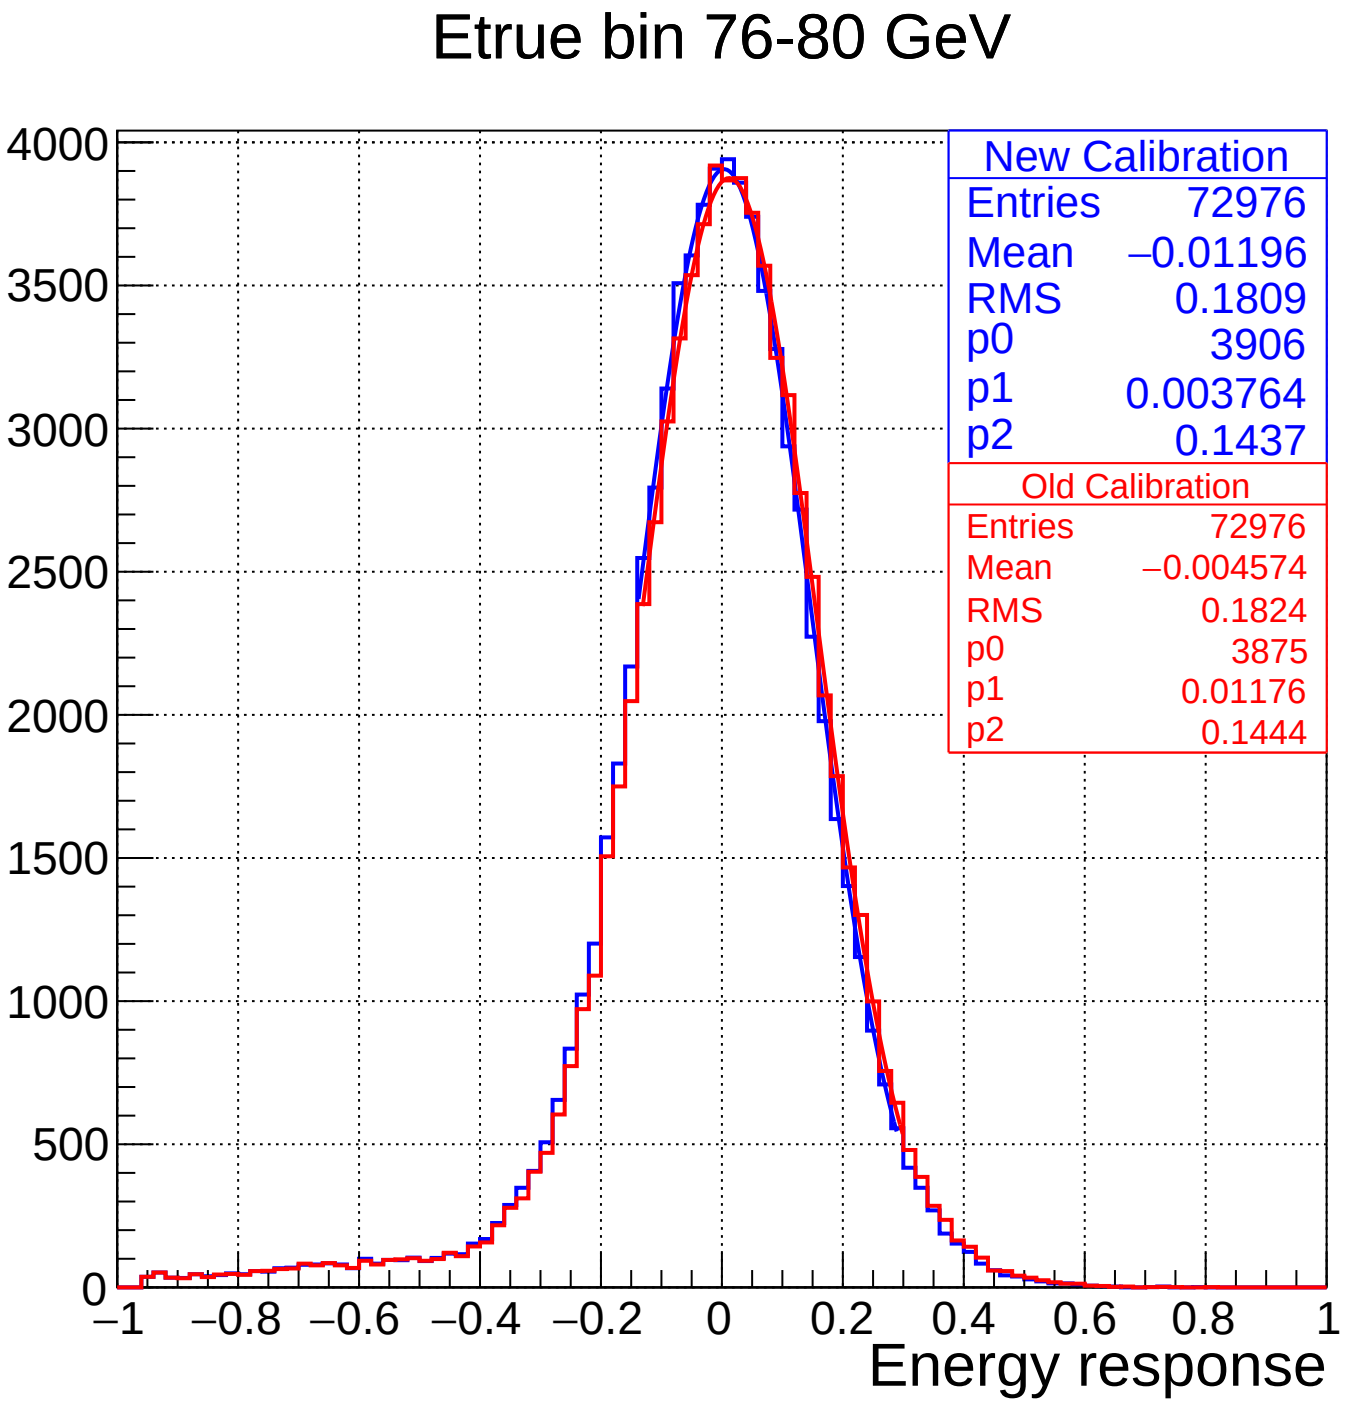
Etrue bin 76-80 GeV
New Calibration
Entries 72976
Mean –0.01196
RMS 0.1809
p0 3906
p1 0.003764
p2 0.1437
Old Calibration
Entries 72976
Mean –0.004574
RMS 0.1824
p0 3875
p1 0.01176
p2 0.1444
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response