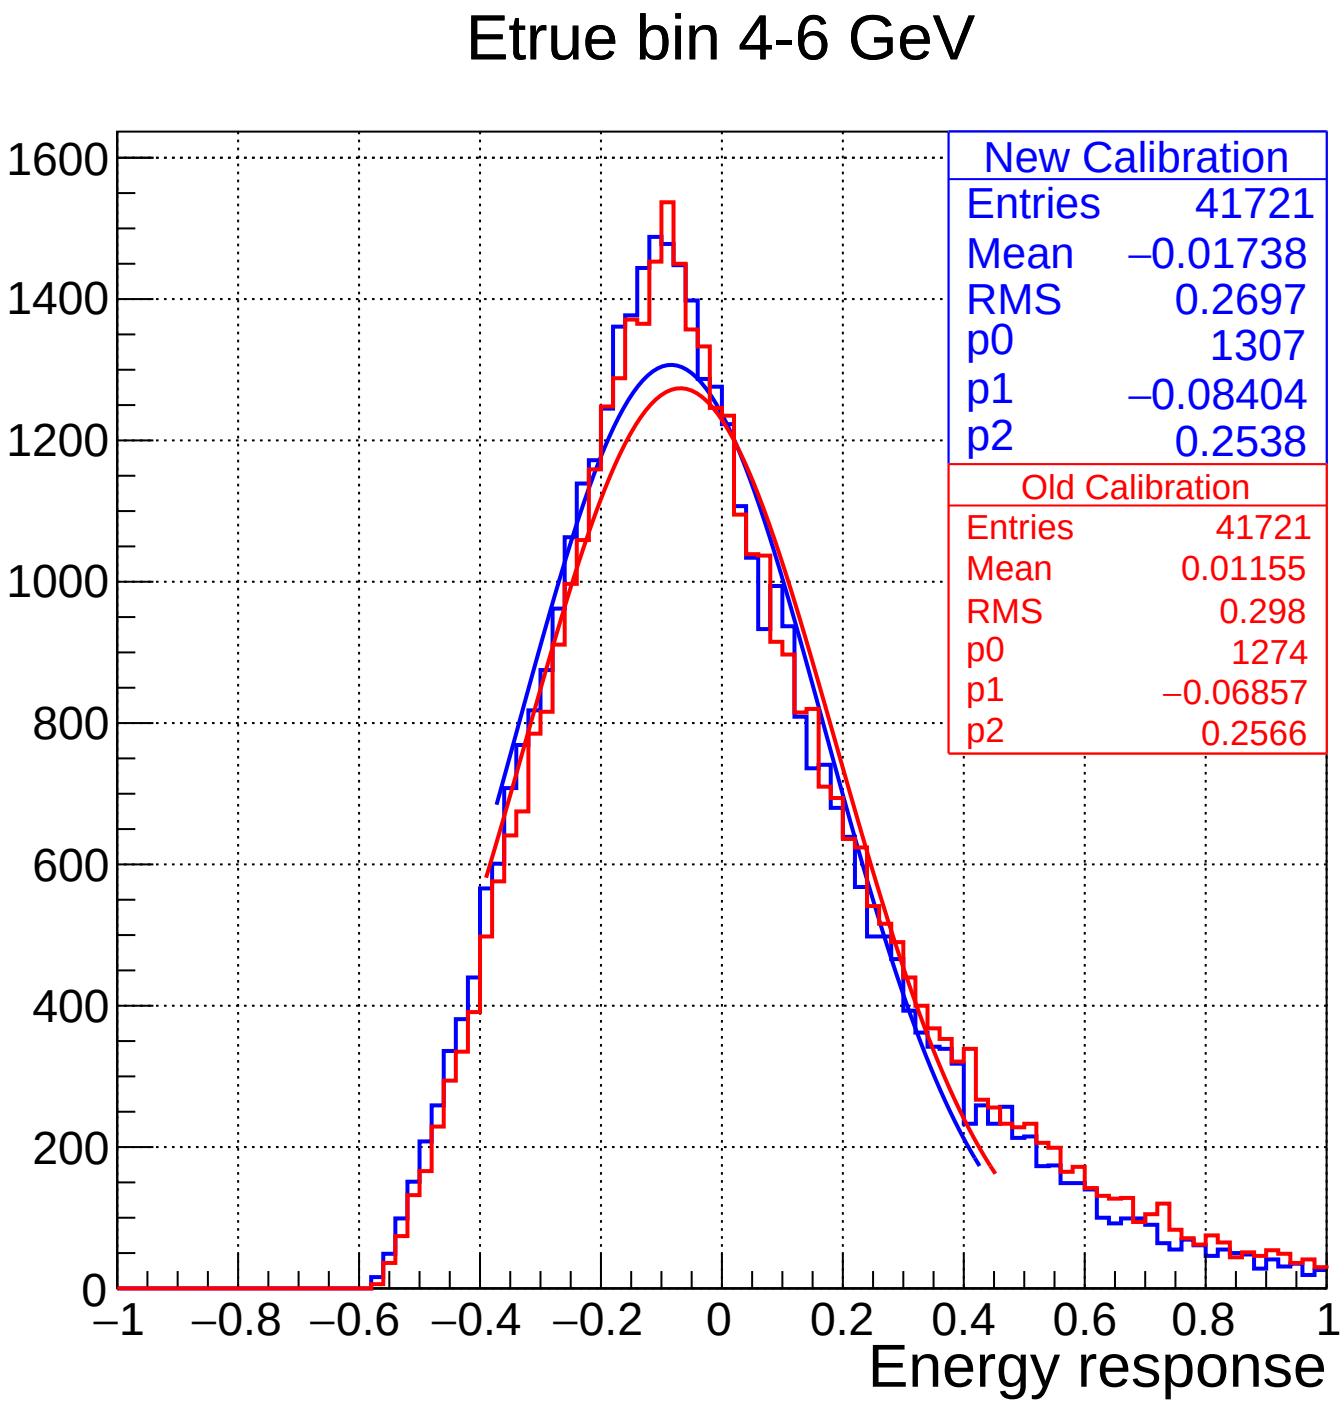
Etrue bin 4-6 GeV
New Calibration
Entries 41721
Mean –0.01738
RMS 0.2697
p0 1307
p1 –0.08404
p2 0.2538
Old Calibration
Entries 41721
Mean 0.01155
RMS 0.298
p0 1274
p1 –0.06857
p2 0.2566
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response