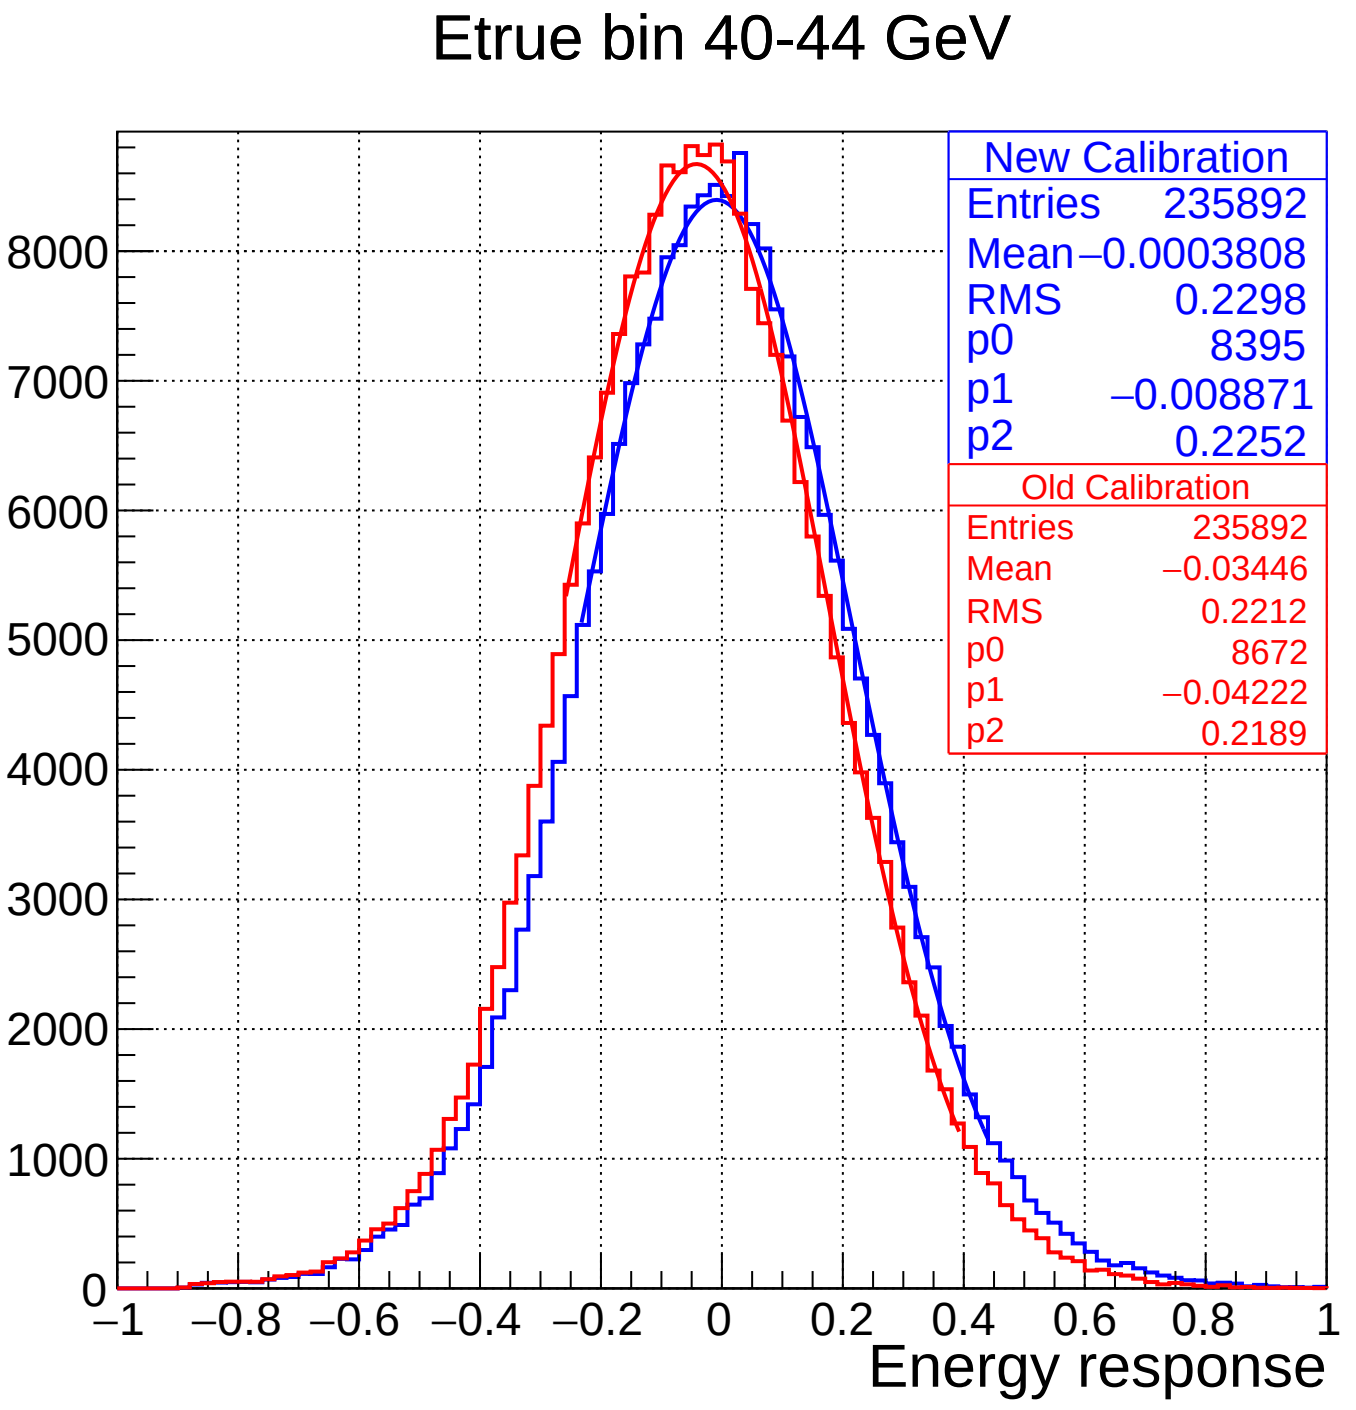
Etrue bin 40-44 GeV
New Calibration
Entries 235892
Mean −0.0003808
RMS 0.2298
p0 8395
p1 −0.008871
p2 0.2252
Old Calibration
Entries 235892
Mean −0.03446
RMS 0.2212
p0 8672
p1 −0.04222
p2 0.2189
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response