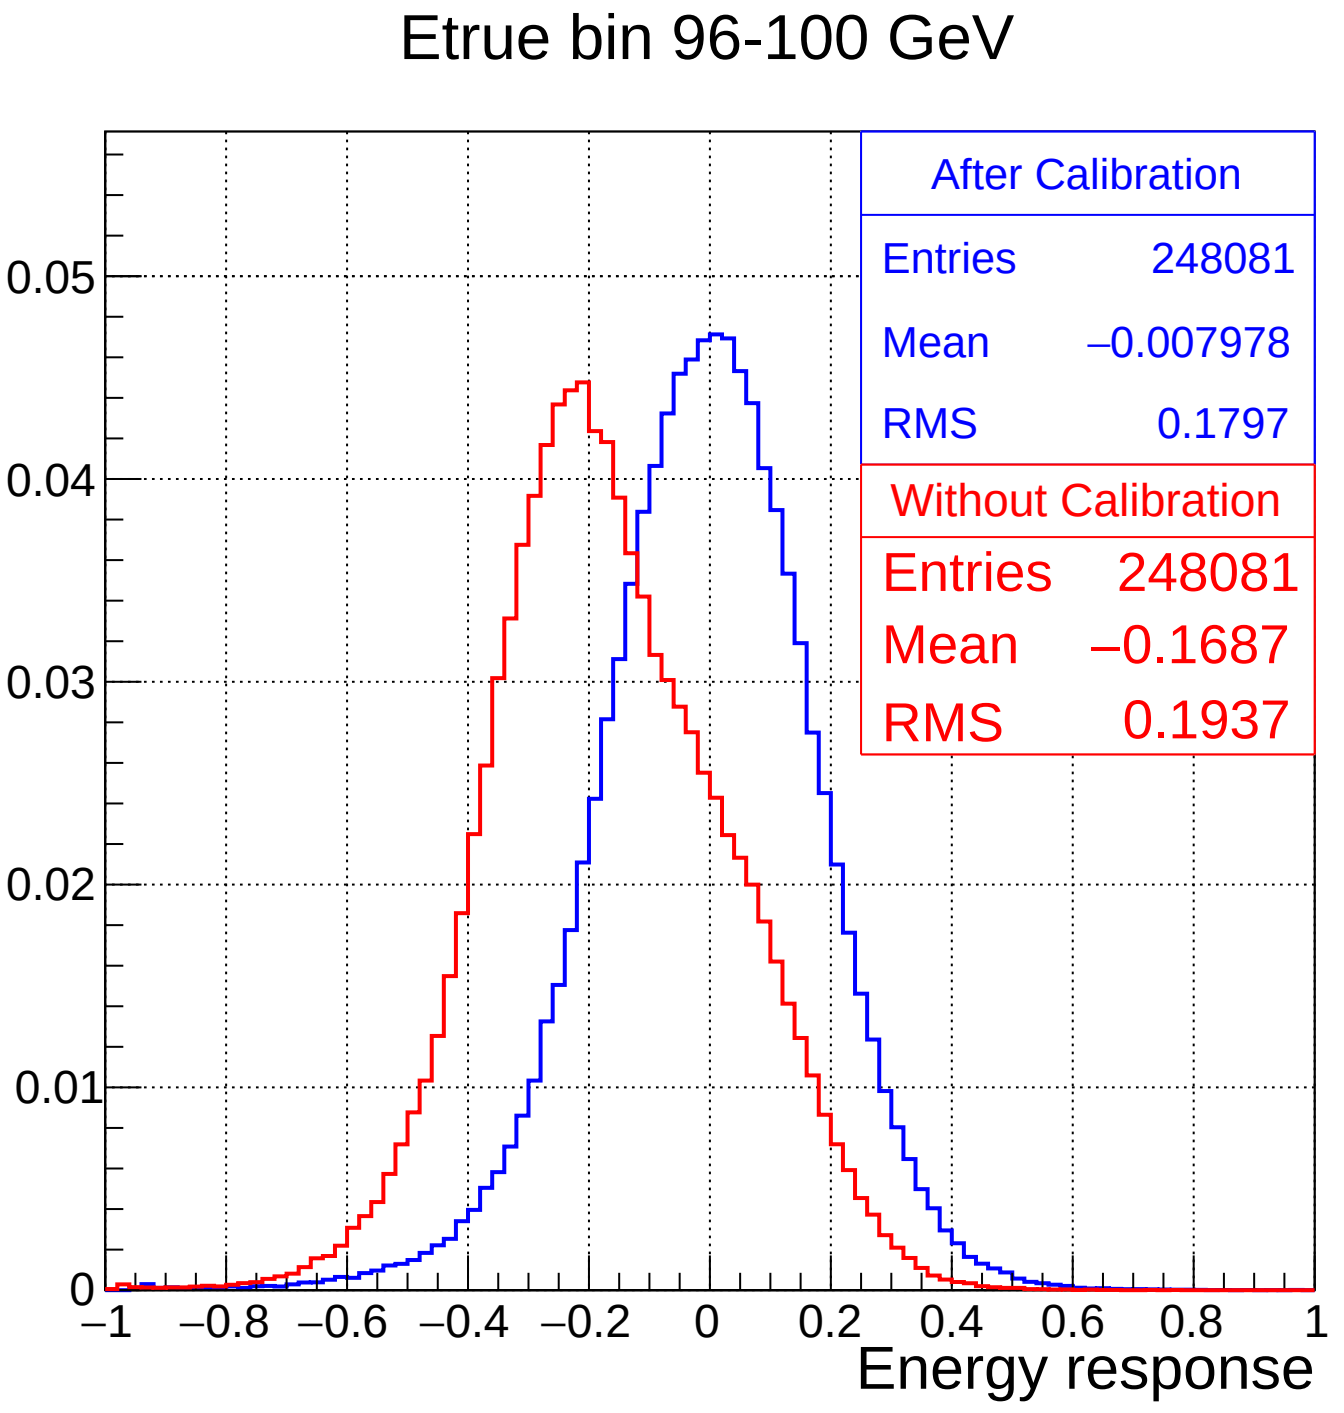
Etrue bin 96-100 GeV
After Calibration
Entries 248081
Mean –0.007978
RMS 0.1797
Without Calibration
Entries 248081
Mean –0.1687
RMS 0.1937
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response