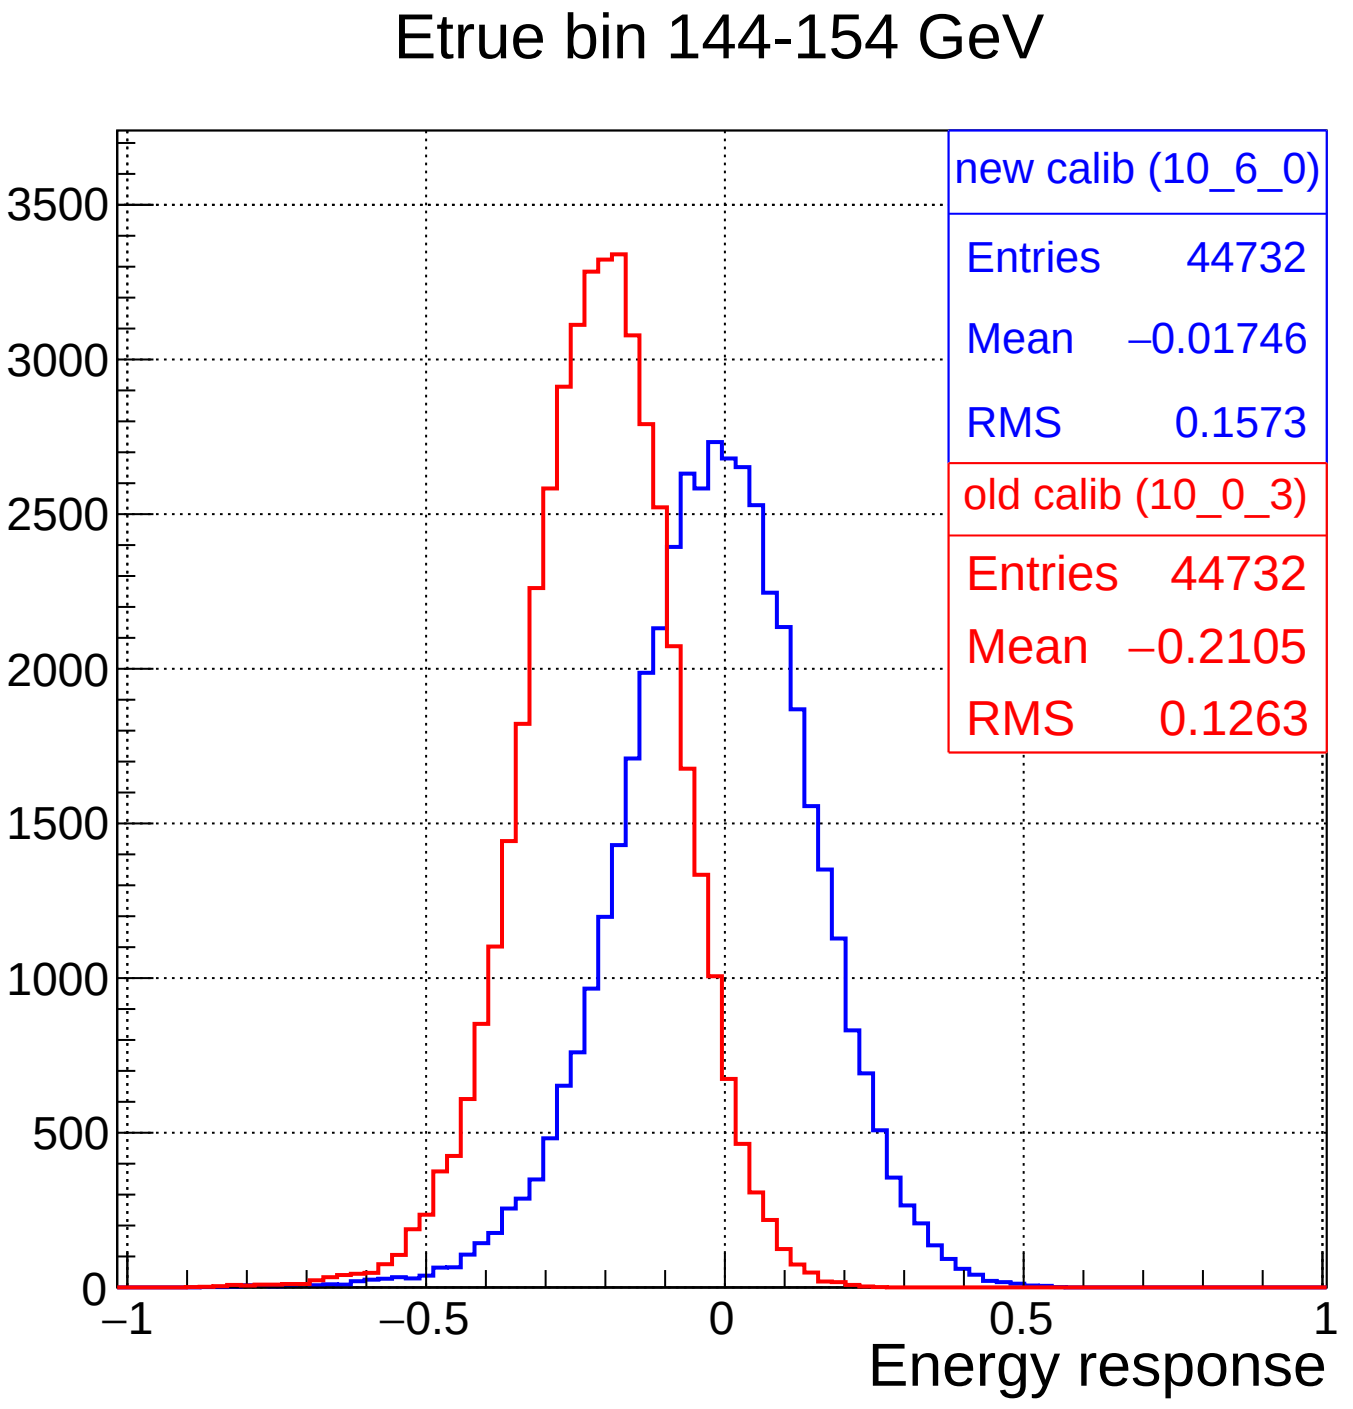
Etrue bin 144-154 GeV
new calib (10_6_0)
Entries 44732
Mean –0.01746
RMS 0.1573
old calib (10_0_3)
Entries 44732
Mean –0.2105
RMS 0.1263
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
–1
–0.5
0
0.5
1
Energy response