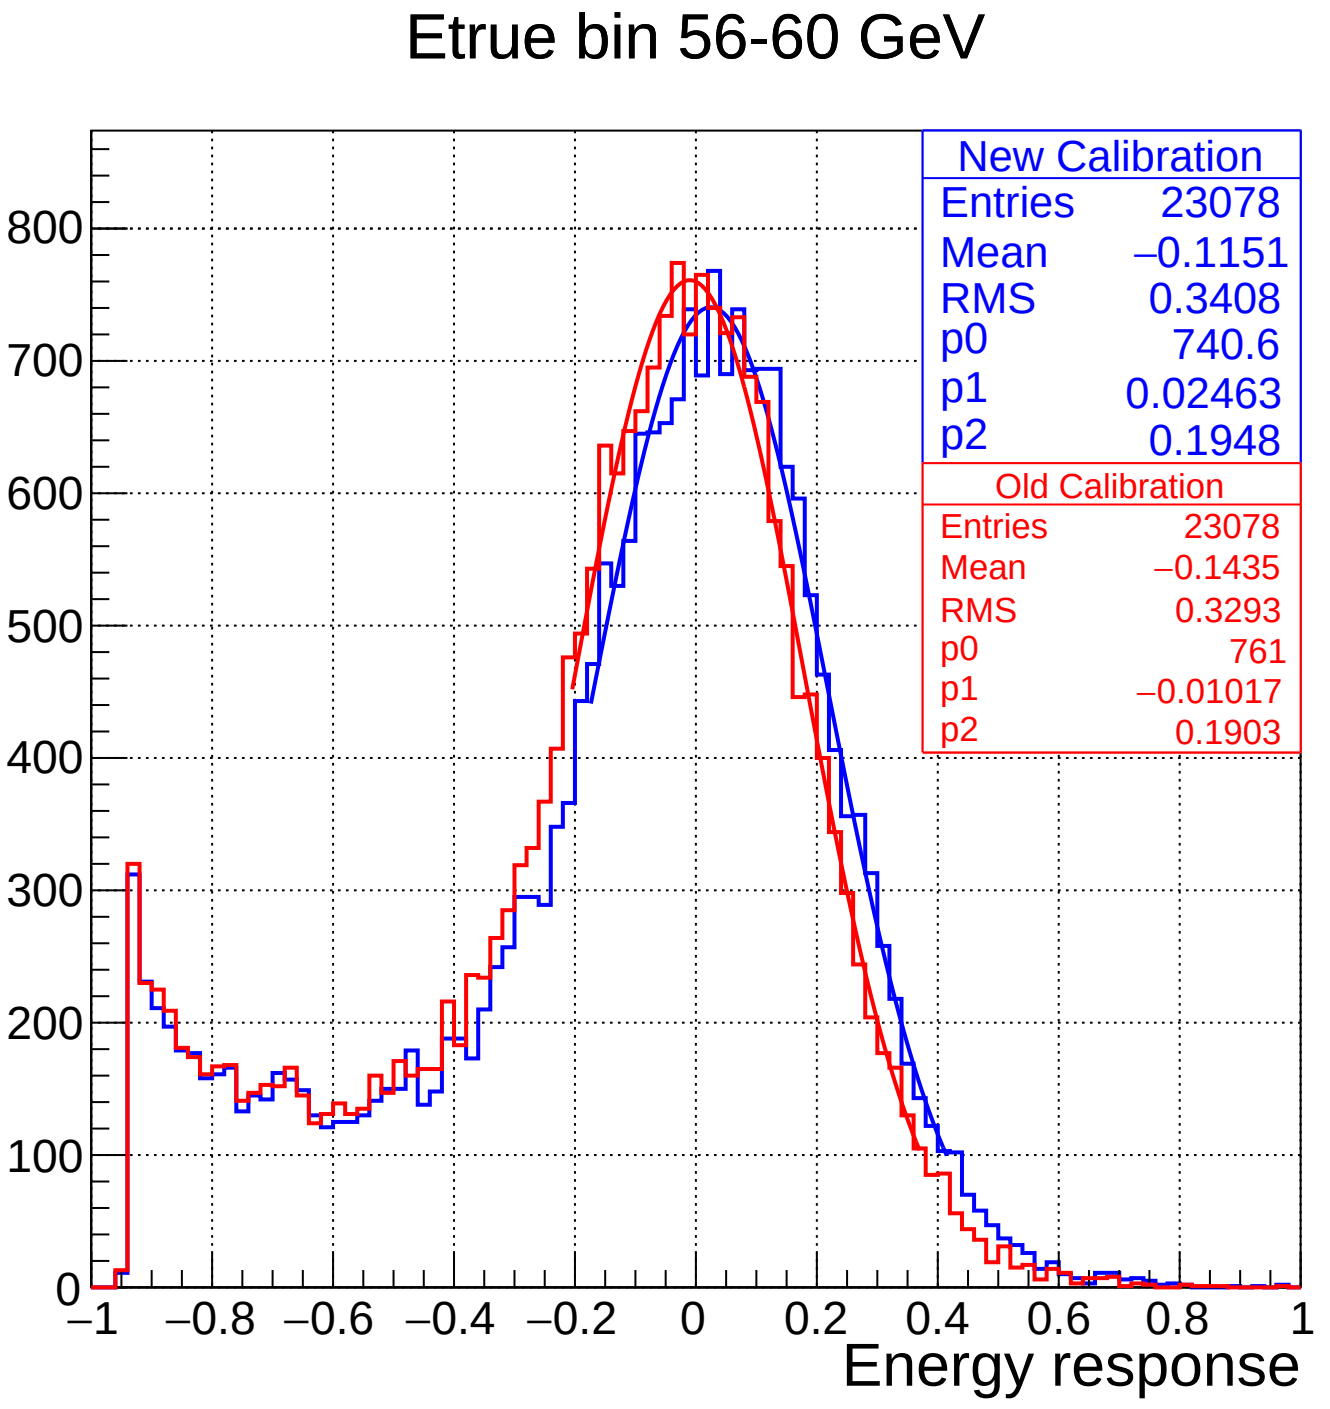
Etrue bin 56-60 GeV
New Calibration
Entries 23078
Mean –0.1151
RMS 0.3408
p0 740.6
p1 0.02463
p2 0.1948
Old Calibration
Entries 23078
Mean –0.1435
RMS 0.3293
p0 761
p1 –0.01017
p2 0.1903
800
700
600
500
400
300
200
100
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response