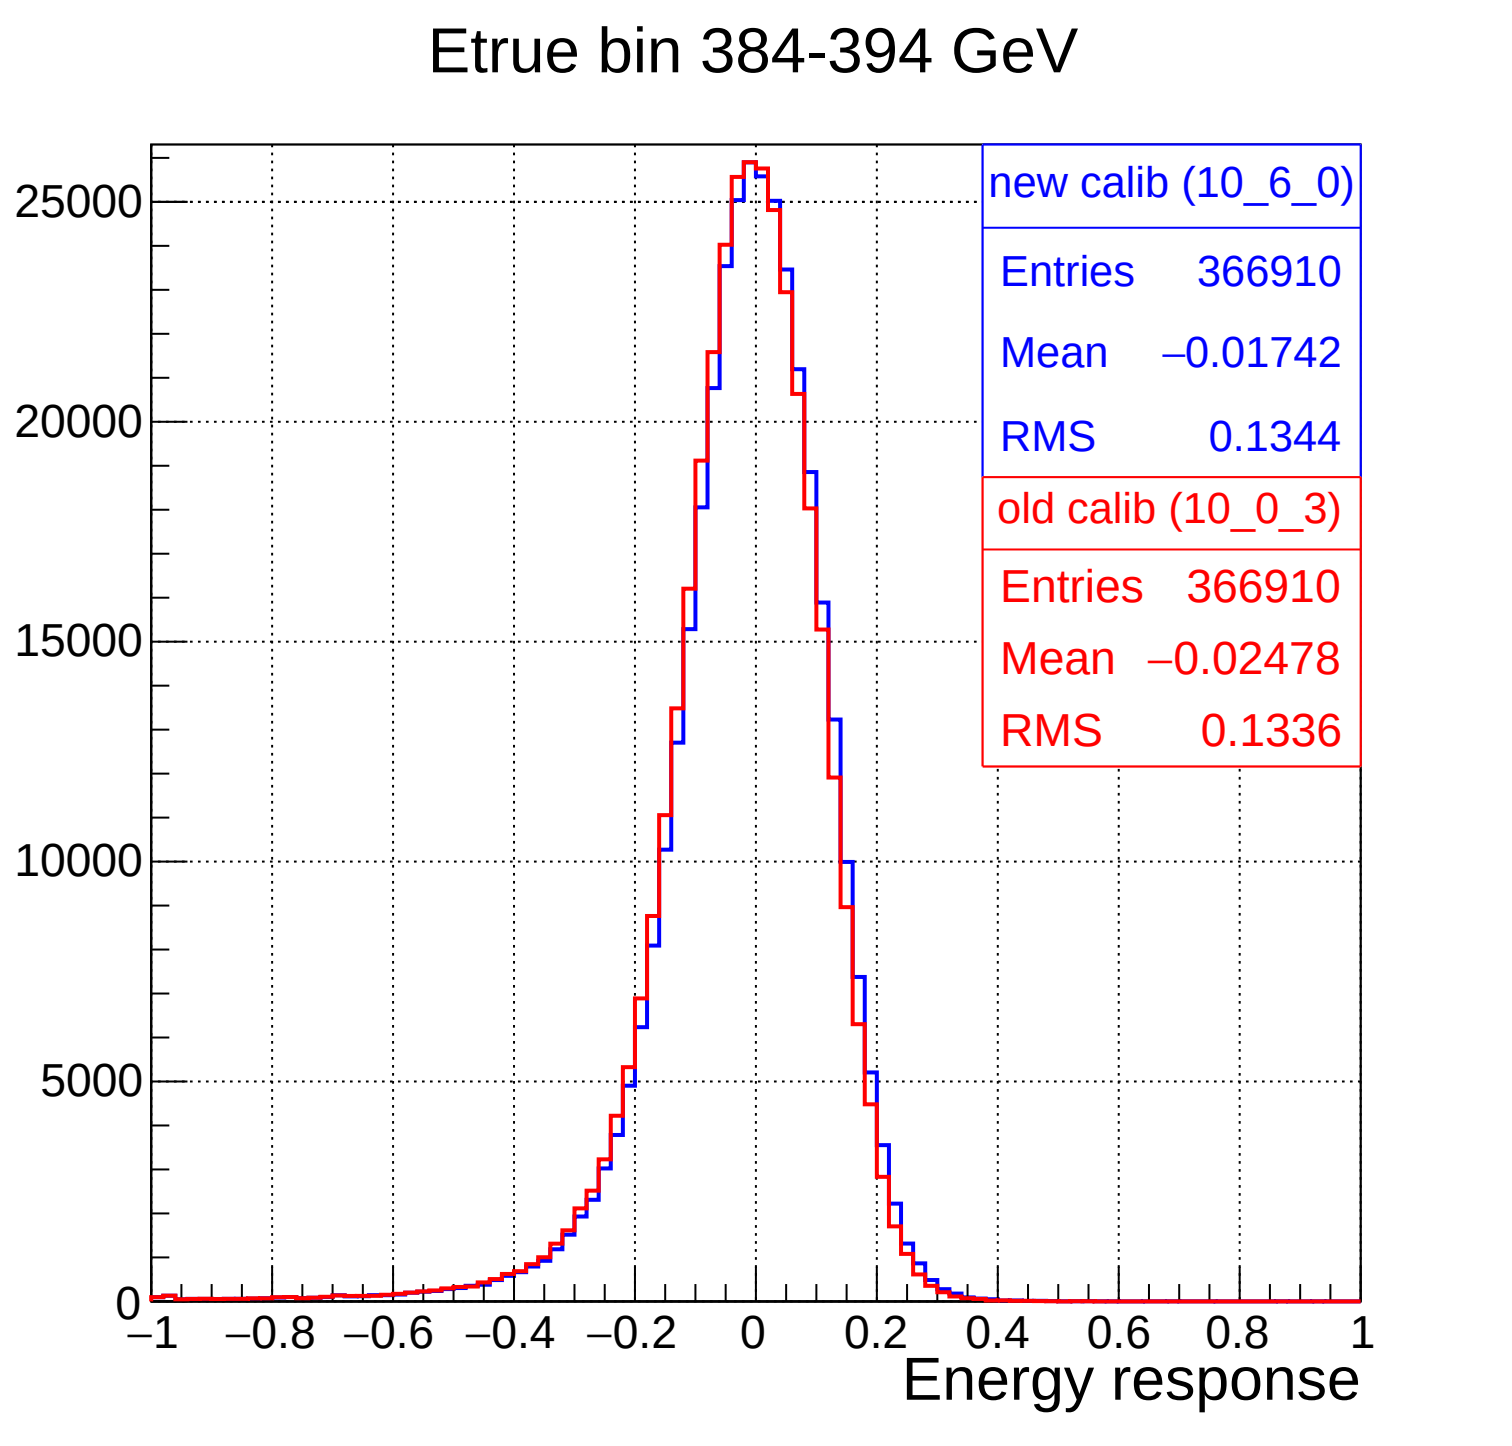
Etrue bin 384-394 GeV
new calib (10_6_0)
Entries 366910
Mean –0.01742
RMS 0.1344
old calib (10_0_3)
Entries 366910
Mean –0.02478
RMS 0.1336
25000
20000
15000
10000
5000
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response