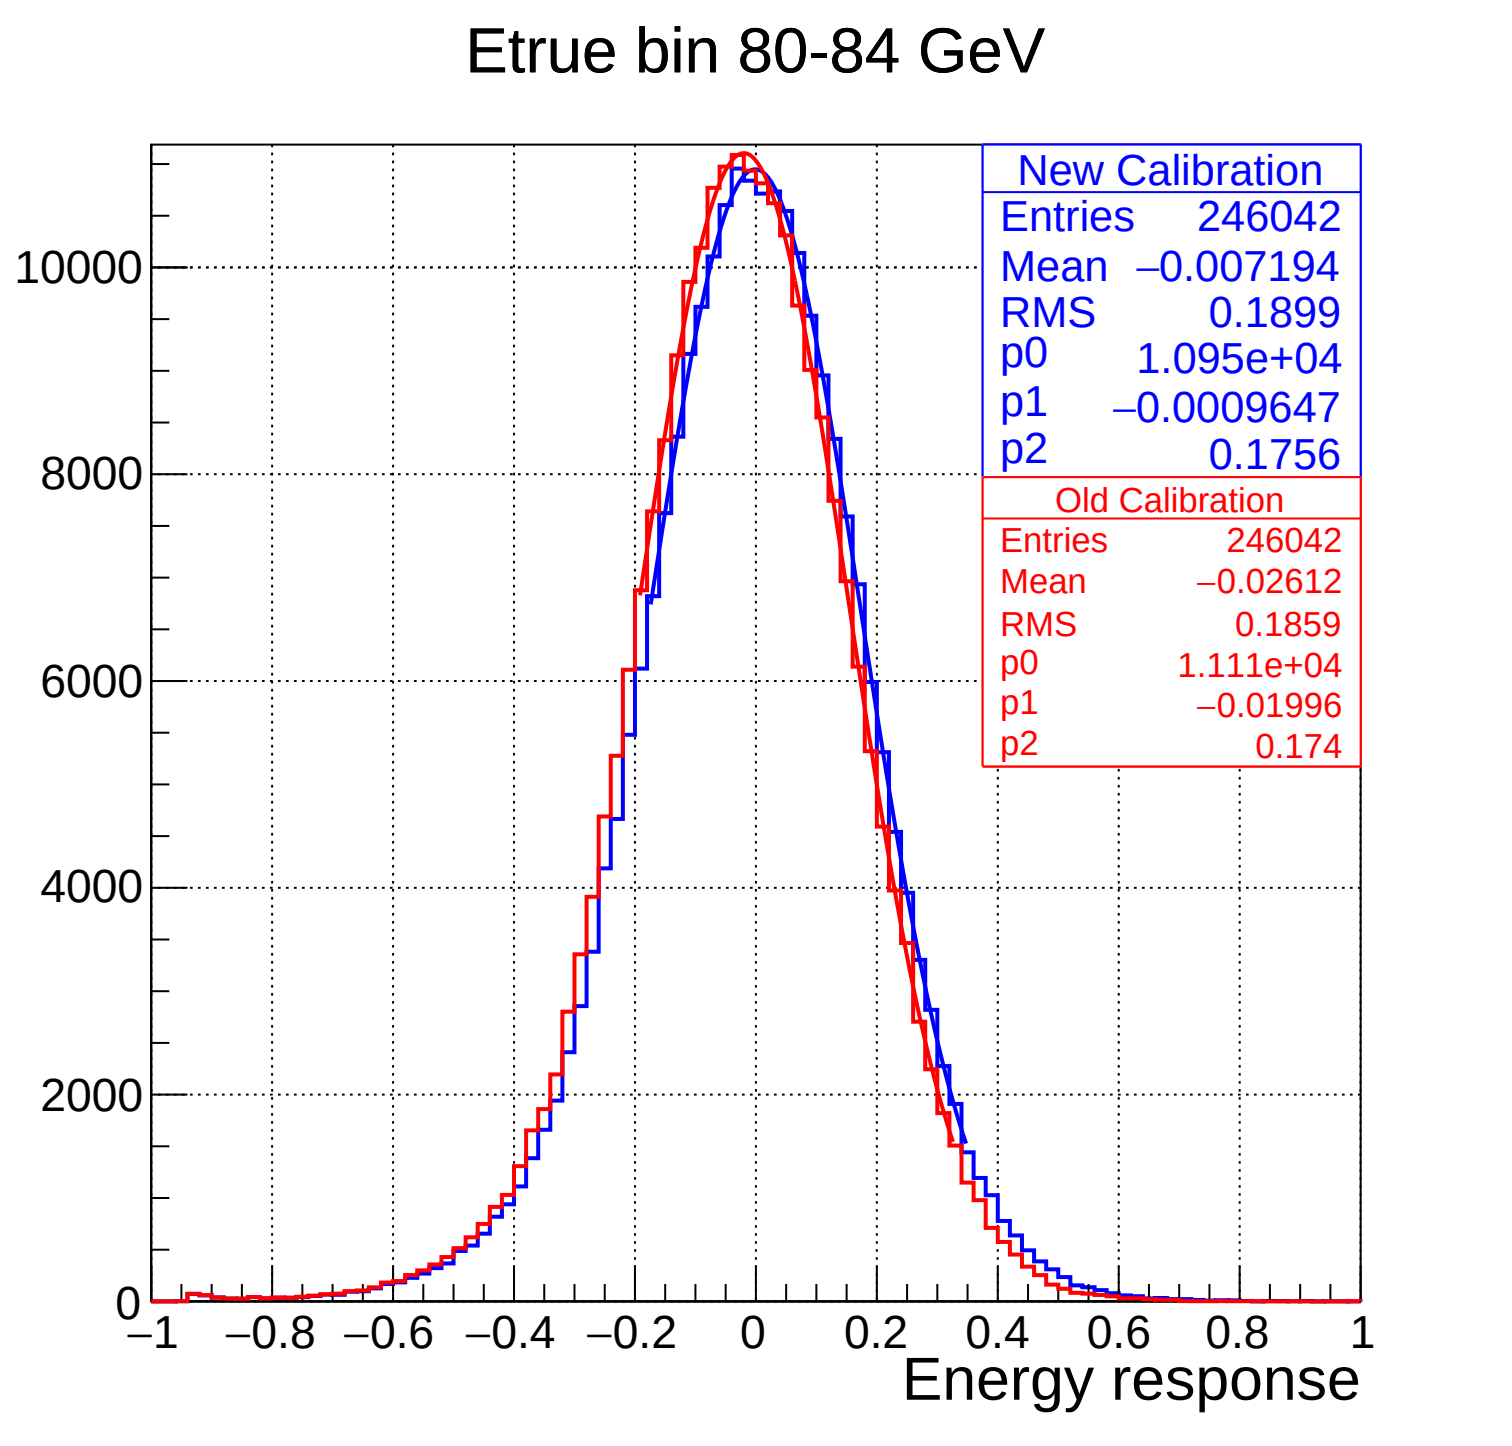
Etrue bin 80-84 GeV
New Calibration
Entries 246042
Mean –0.007194
RMS 0.1899
p0 1.095e+04
p1 –0.0009647
p2 0.1756
Old Calibration
Entries 246042
Mean –0.02612
RMS 0.1859
p0 1.111e+04
p1 –0.01996
p2 0.174
10000
8000
6000
4000
2000
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response