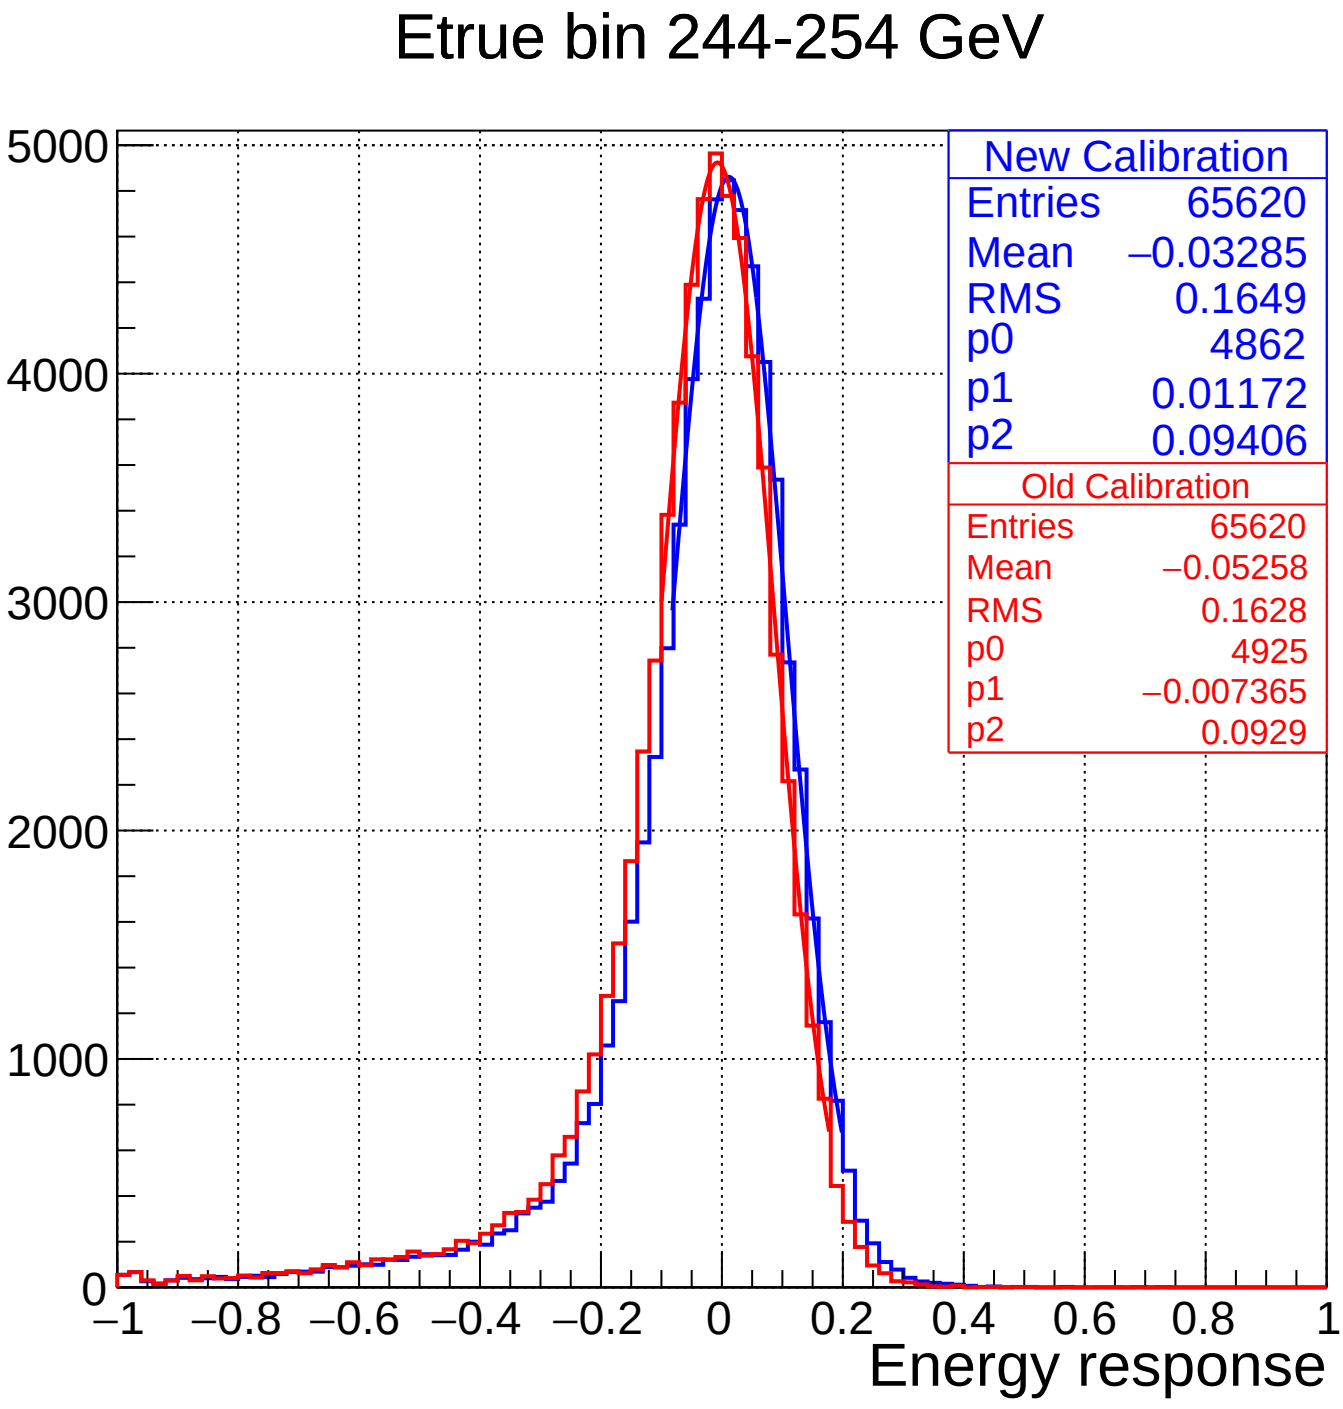
Etrue bin 244-254 GeV
New Calibration
Entries 65620
Mean –0.03285
RMS 0.1649
p0 4862
p1 0.01172
p2 0.09406
Old Calibration
Entries 65620
Mean –0.05258
RMS 0.1628
p0 4925
p1 –0.007365
p2 0.0929
5000
4000
3000
2000
1000
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response