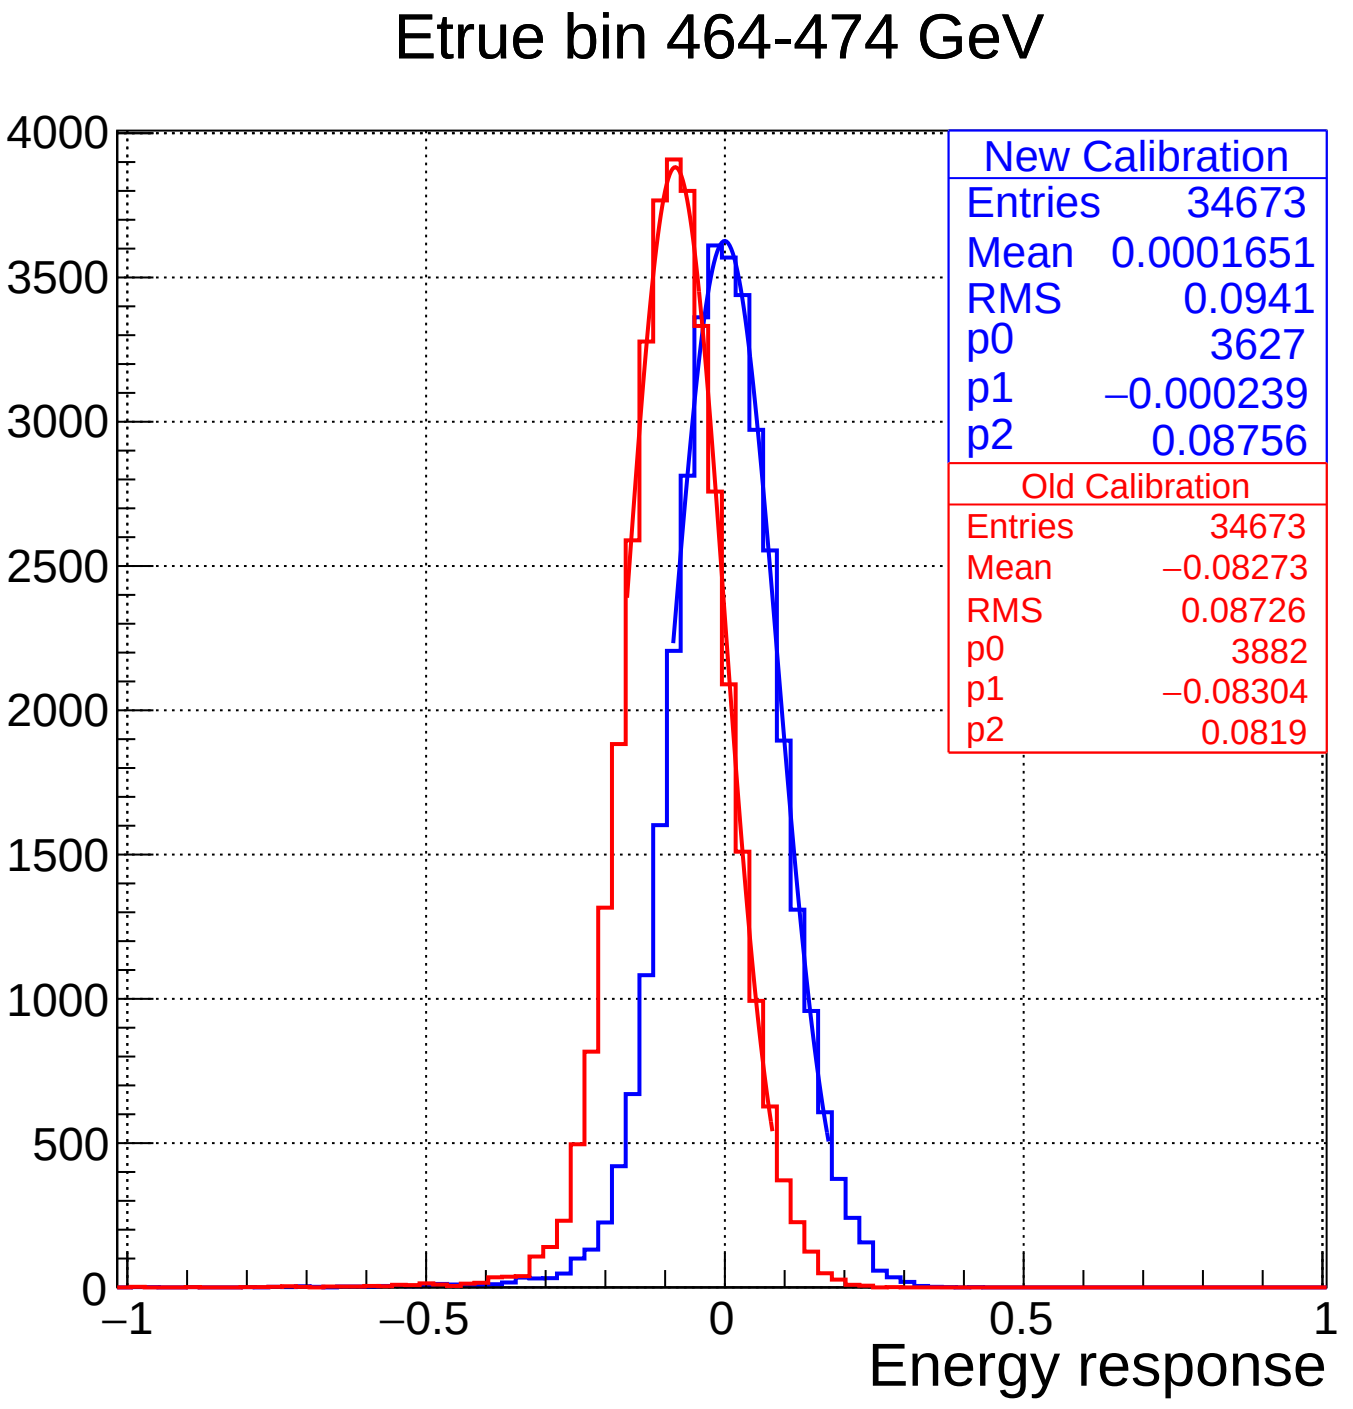
Etrue bin 464-474 GeV
New Calibration
Entries 34673
Mean 0.0001651
RMS 0.0941
p0 3627
p1 −0.000239
p2 0.08756
Old Calibration
Entries 34673
Mean −0.08273
RMS 0.08726
p0 3882
p1 −0.08304
p2 0.0819
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
−1
−0.5
0
0.5
1
Energy response