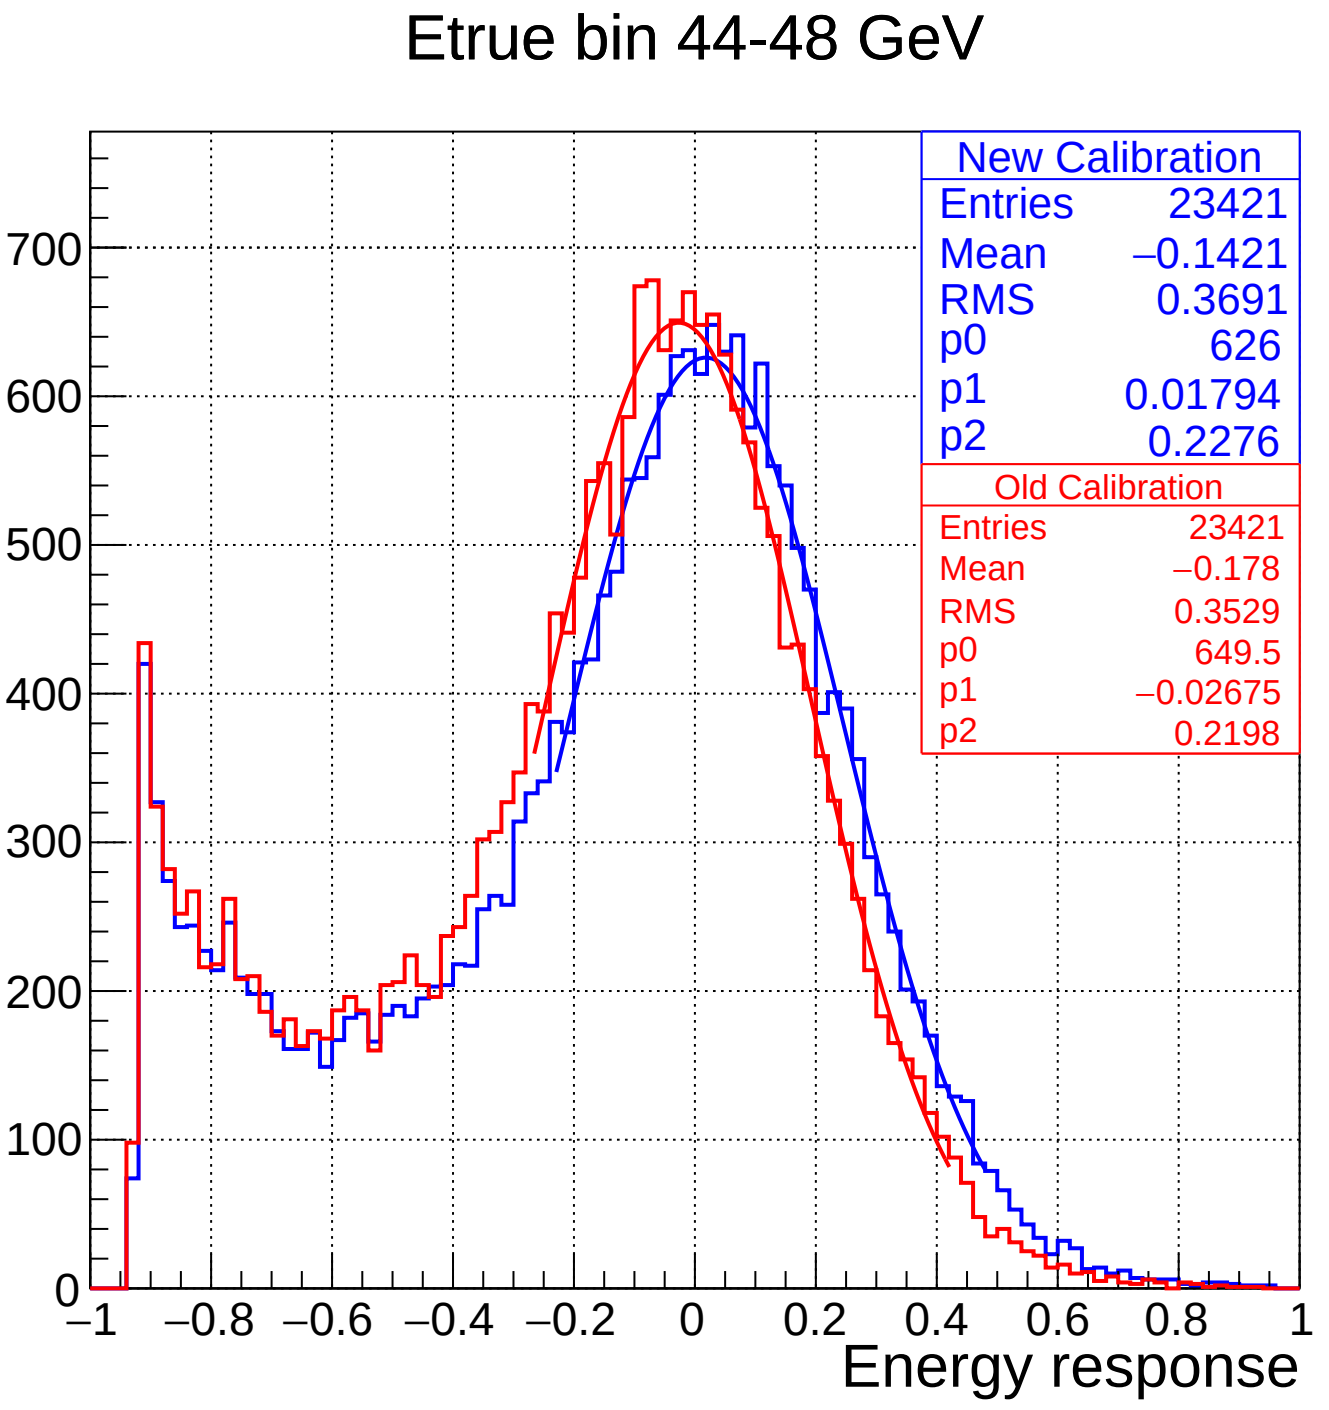
Etrue bin 44-48 GeV
New Calibration
Entries 23421
Mean −0.1421
RMS 0.3691
p0 626
p1 0.01794
p2 0.2276
Old Calibration
Entries 23421
Mean −0.178
RMS 0.3529
p0 649.5
p1 −0.02675
p2 0.2198
700
600
500
400
300
200
100
0
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response