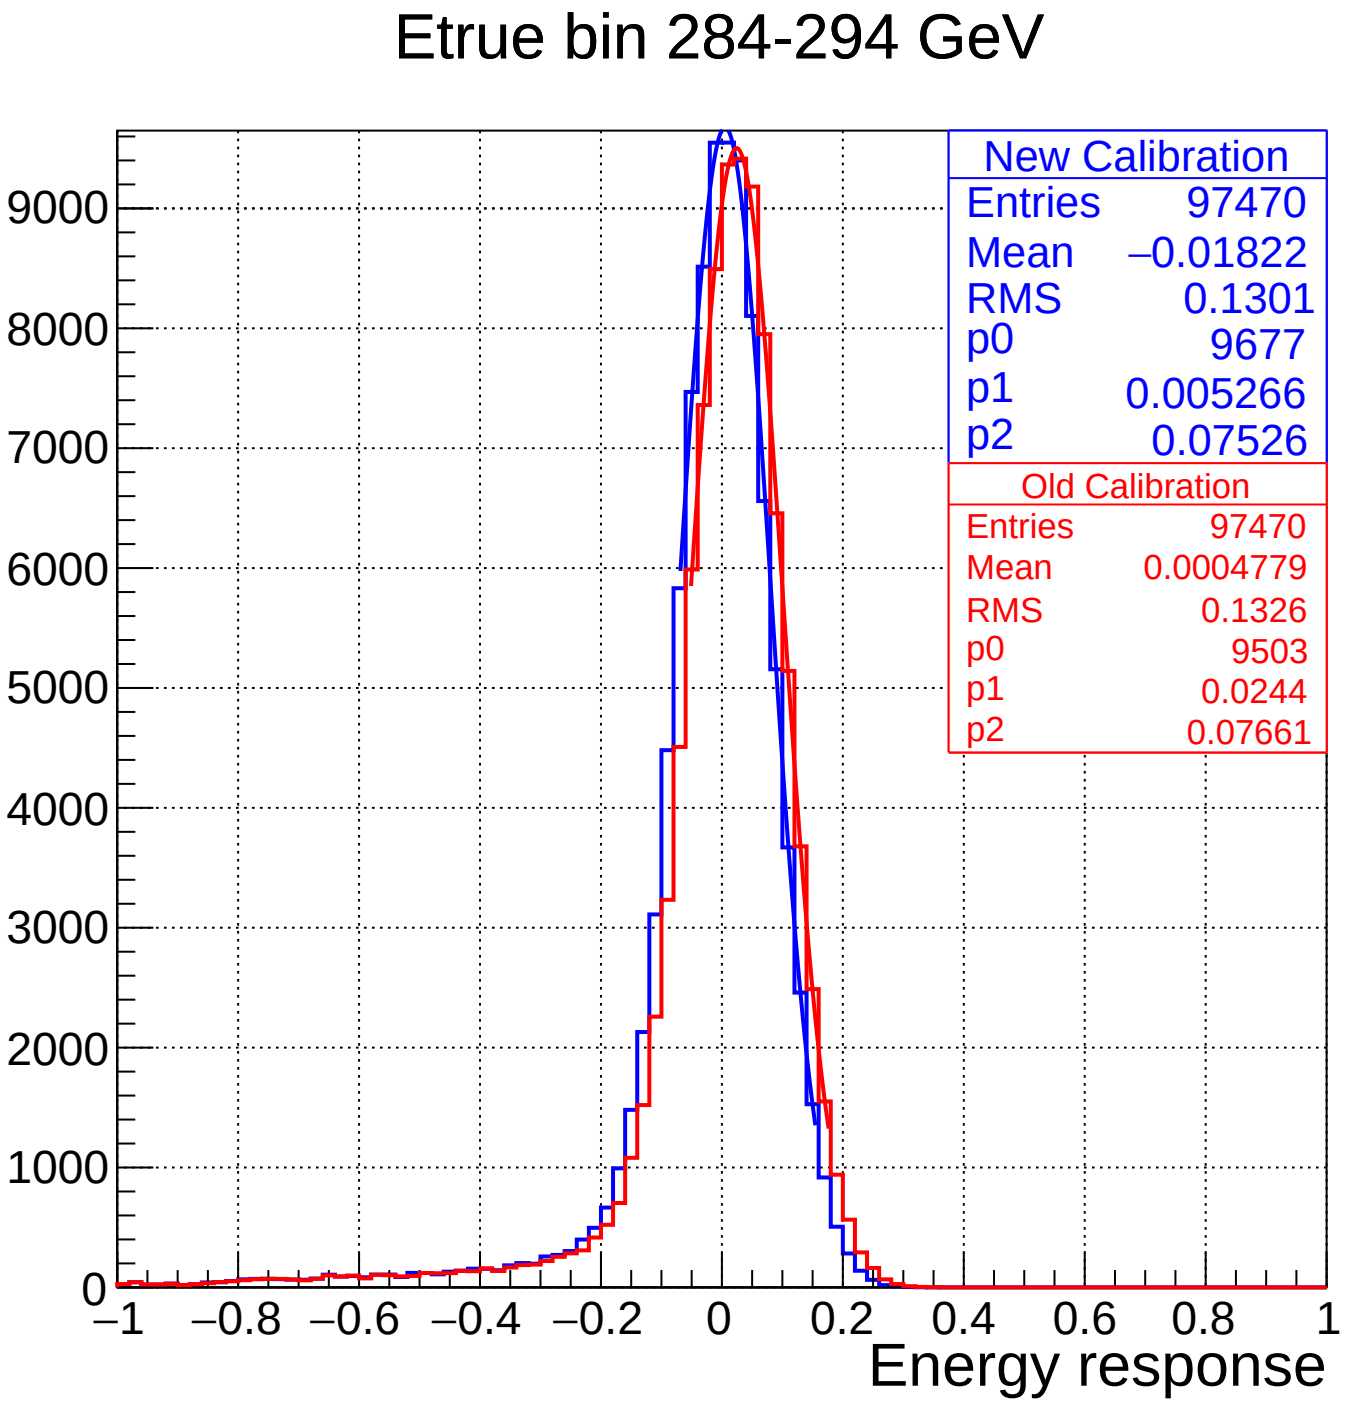
Etrue bin 284-294 GeV
New Calibration
Entries 97470
Mean –0.01822
RMS 0.1301
p0 9677
p1 0.005266
p2 0.07526
Old Calibration
Entries 97470
Mean 0.0004779
RMS 0.1326
p0 9503
p1 0.0244
p2 0.07661
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response