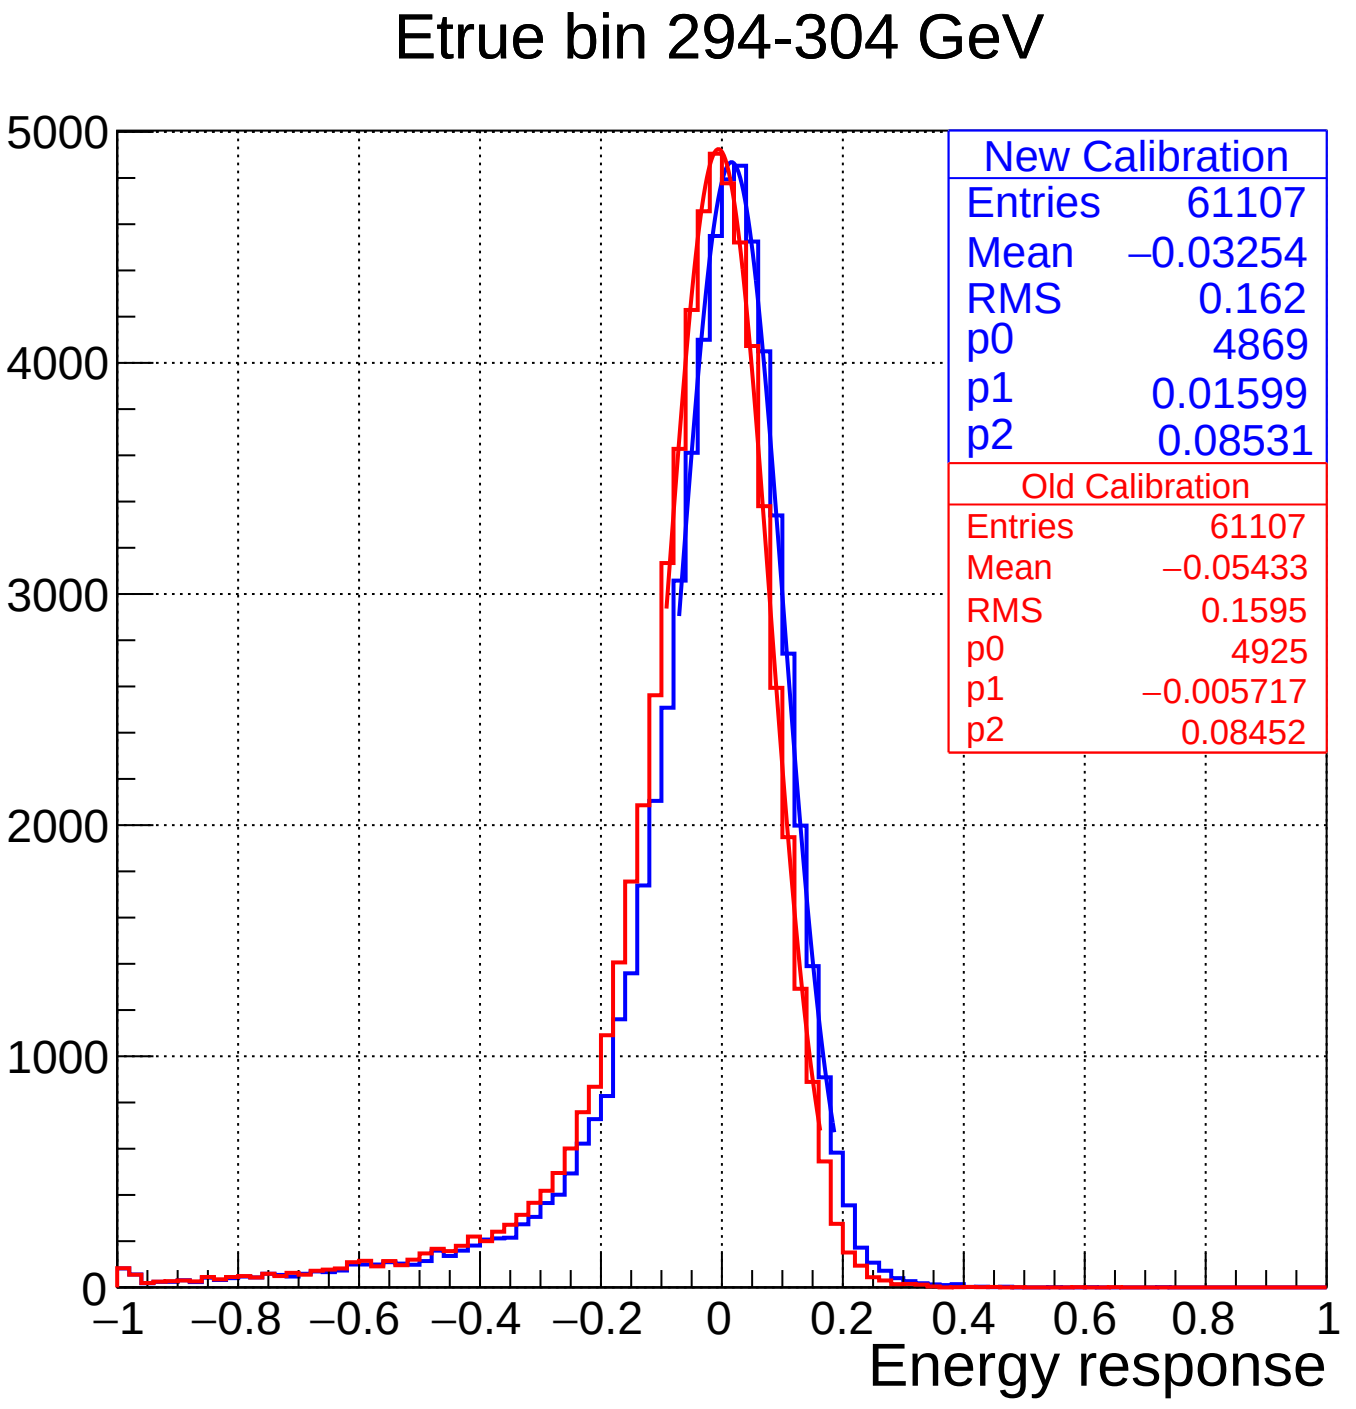
Etrue bin 294-304 GeV
New Calibration
Entries 61107
Mean –0.03254
RMS 0.162
p0 4869
p1 0.01599
p2 0.08531
Old Calibration
Entries 61107
Mean –0.05433
RMS 0.1595
p0 4925
p1 –0.005717
p2 0.08452
5000
4000
3000
2000
1000
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response