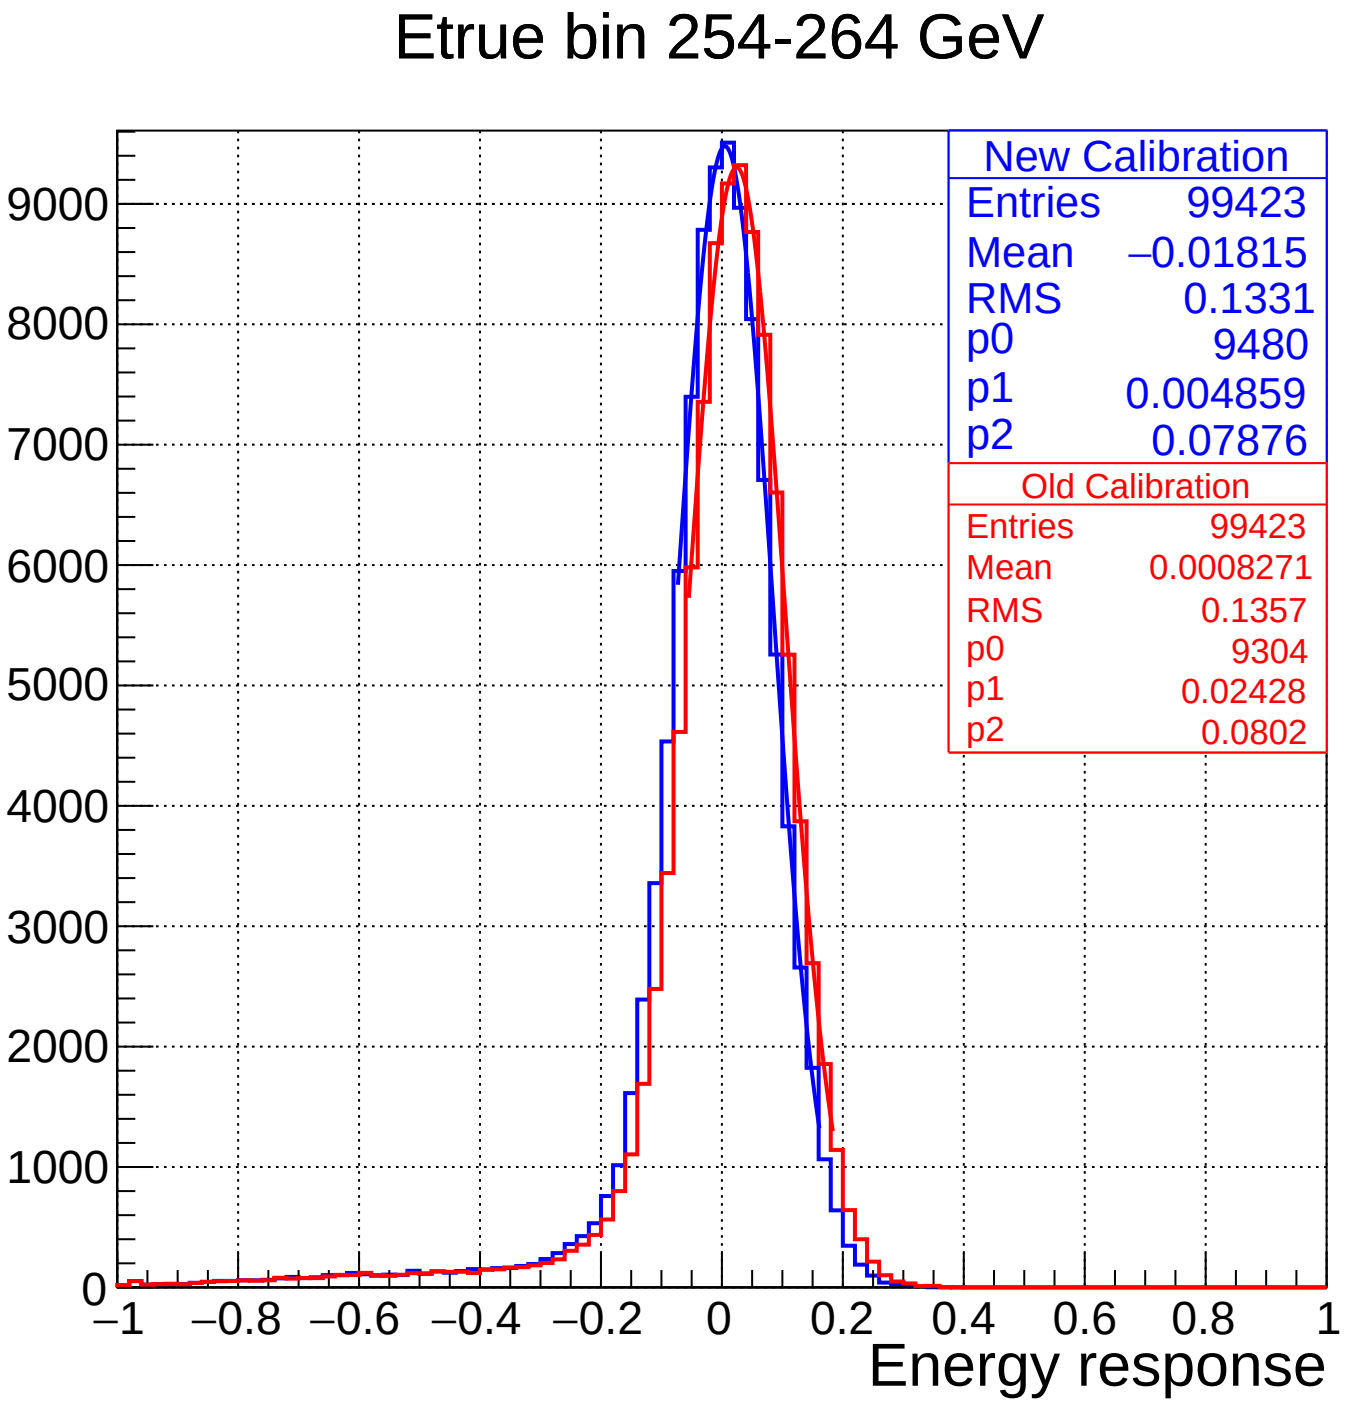
Etrue bin 254-264 GeV
New Calibration
Entries 99423
Mean –0.01815
RMS 0.1331
p0 9480
p1 0.004859
p2 0.07876
Old Calibration
Entries 99423
Mean 0.0008271
RMS 0.1357
p0 9304
p1 0.02428
p2 0.0802
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response