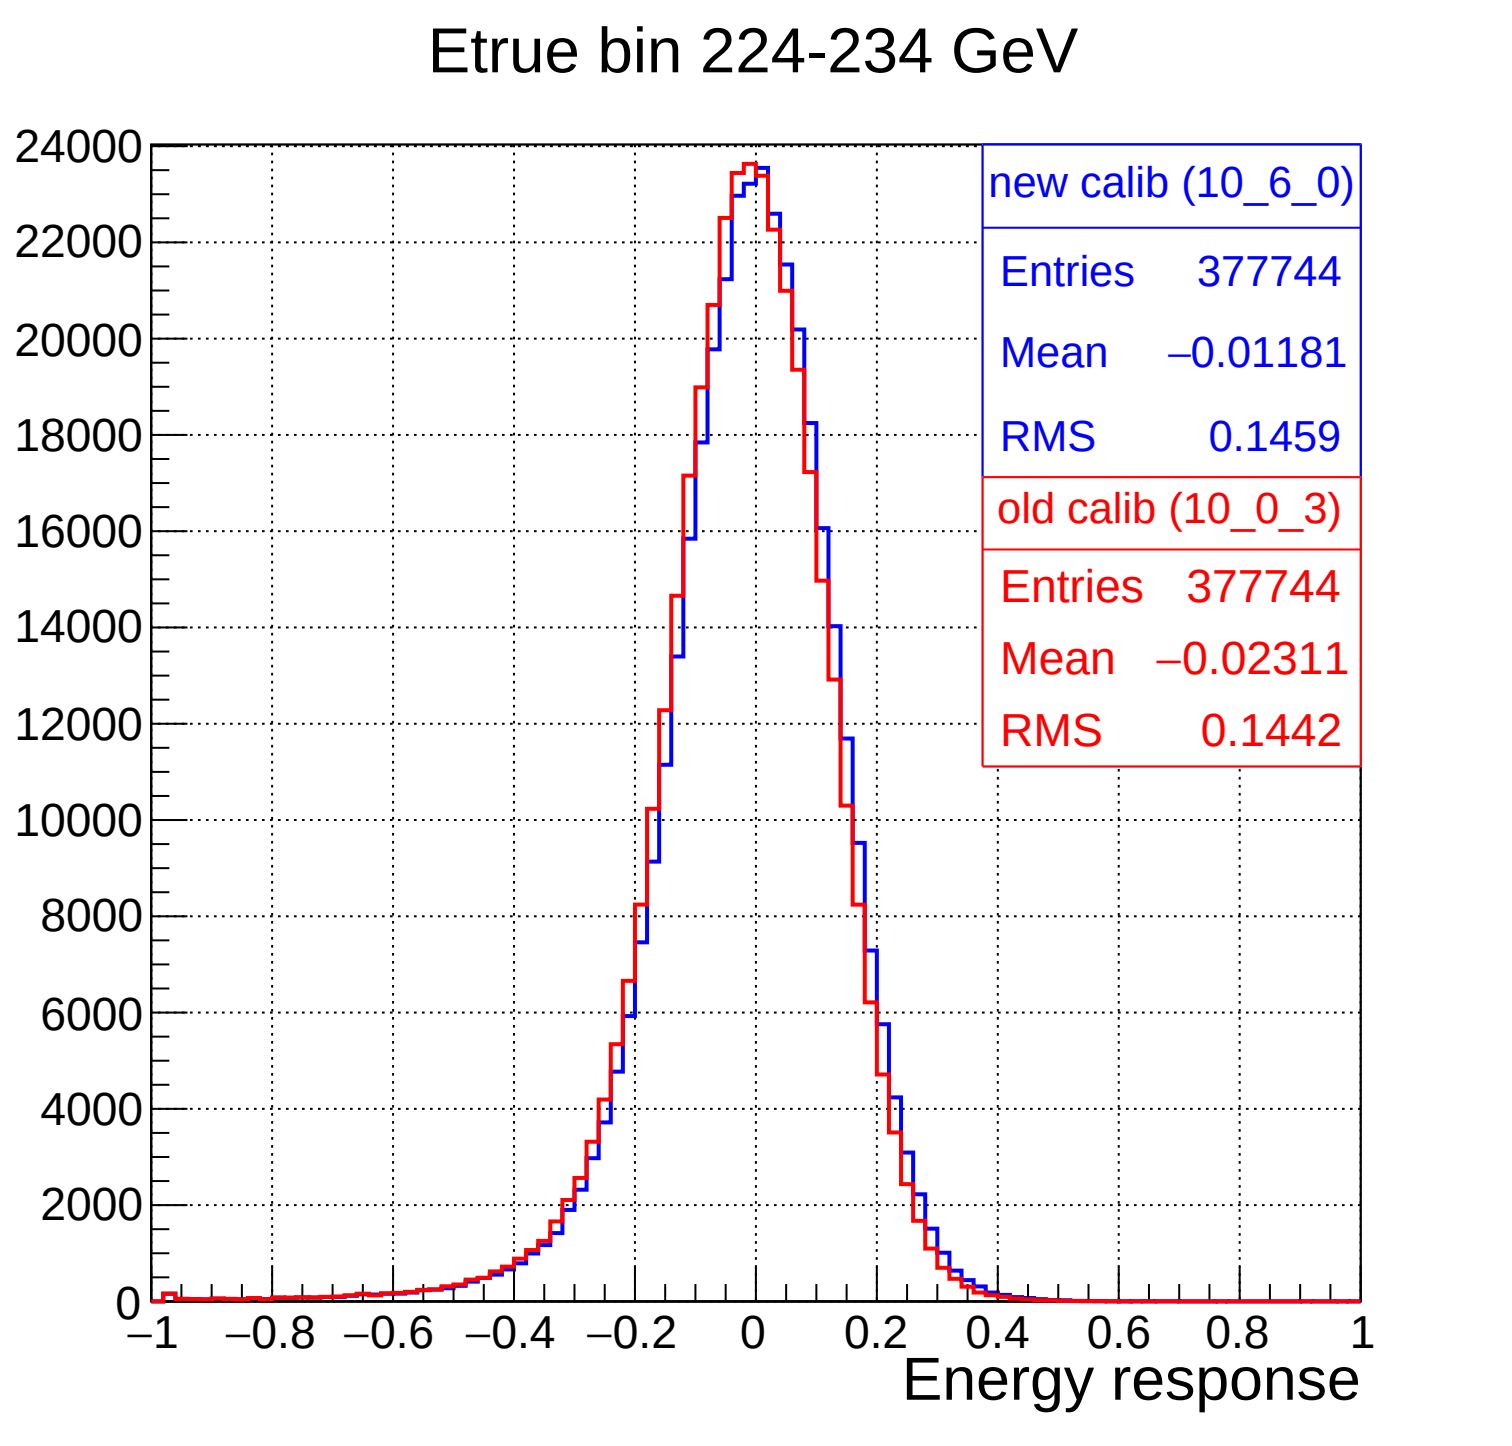
Etrue bin 224-234 GeV
new calib (10_6_0)
Entries 377744
Mean –0.01181
RMS 0.1459
old calib (10_0_3)
Entries 377744
Mean –0.02311
RMS 0.1442
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response