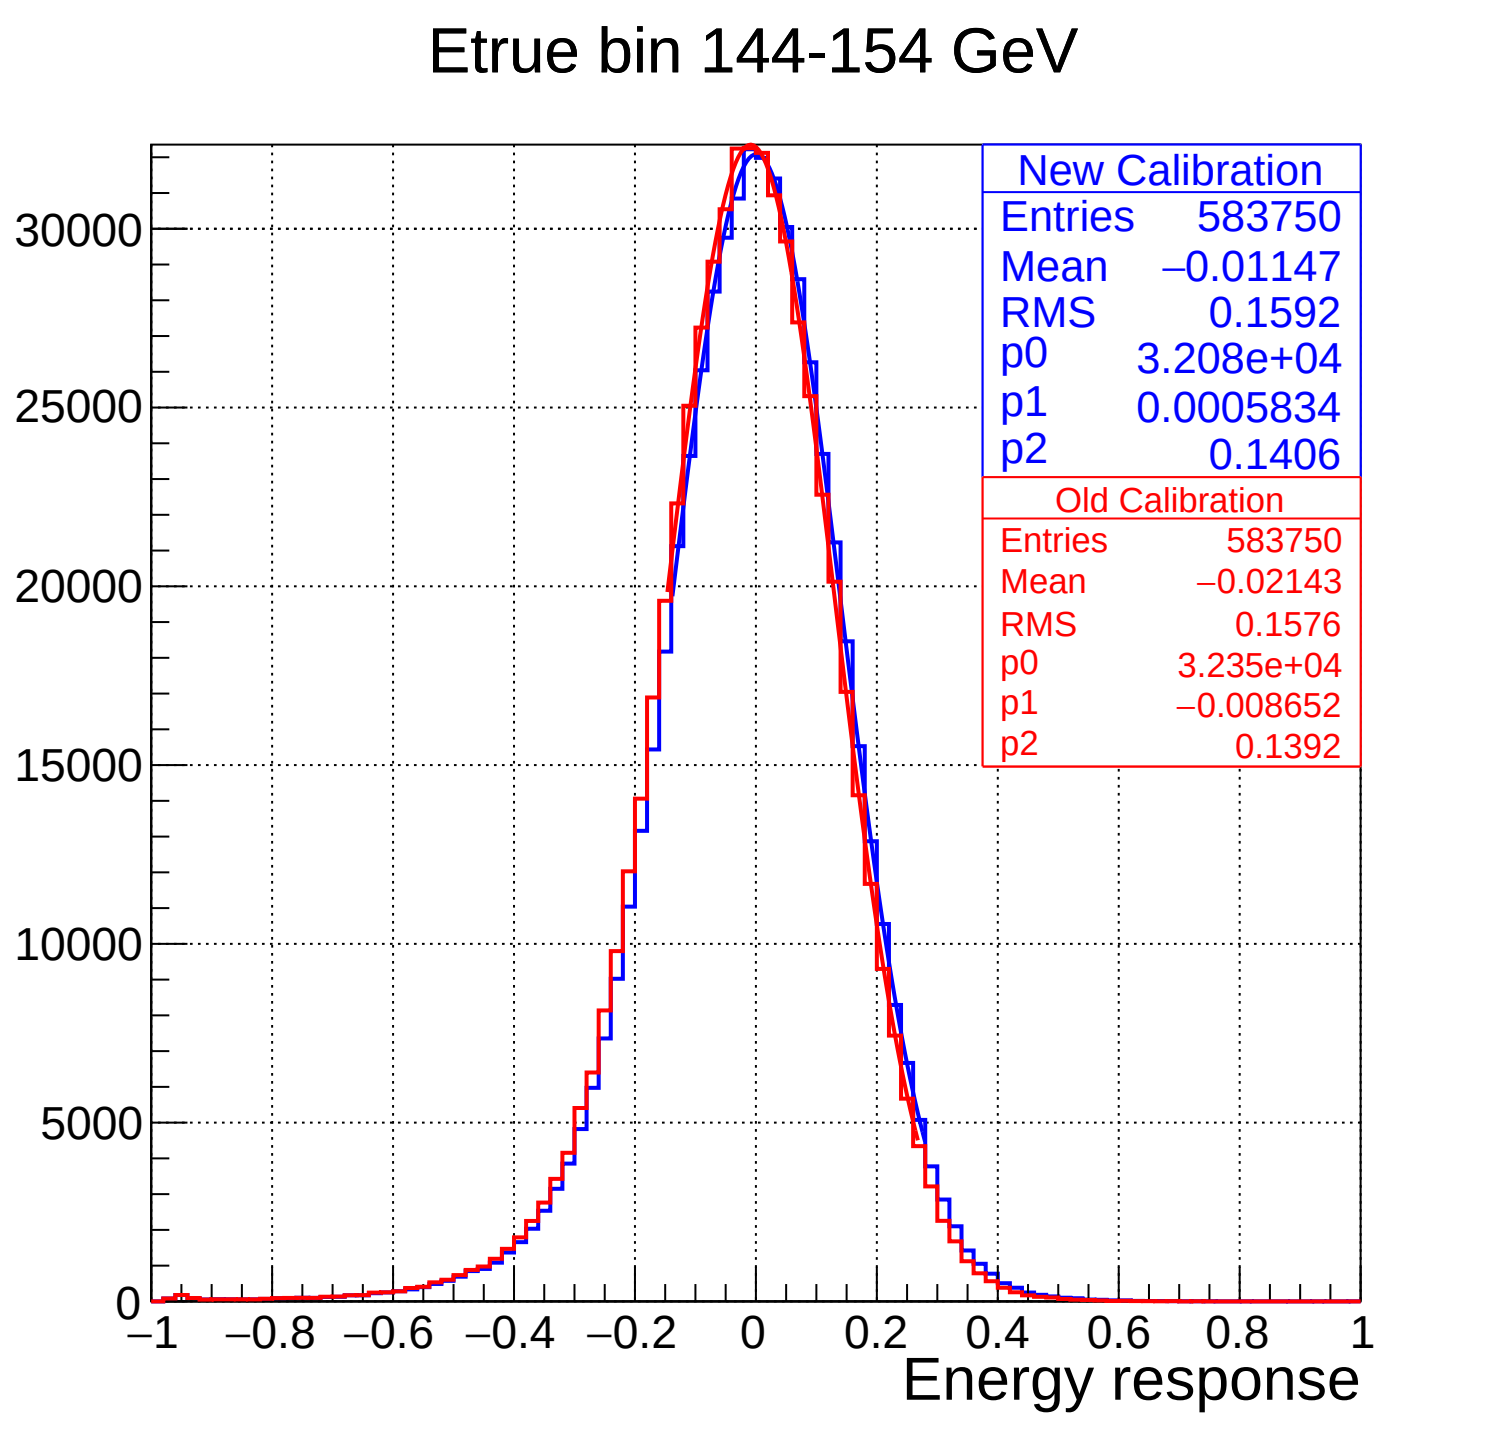
Etrue bin 144-154 GeV
New Calibration
Entries 583750
Mean –0.01147
RMS 0.1592
p0 3.208e+04
p1 0.0005834
p2 0.1406
Old Calibration
Entries 583750
Mean –0.02143
RMS 0.1576
p0 3.235e+04
p1 –0.008652
p2 0.1392
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response