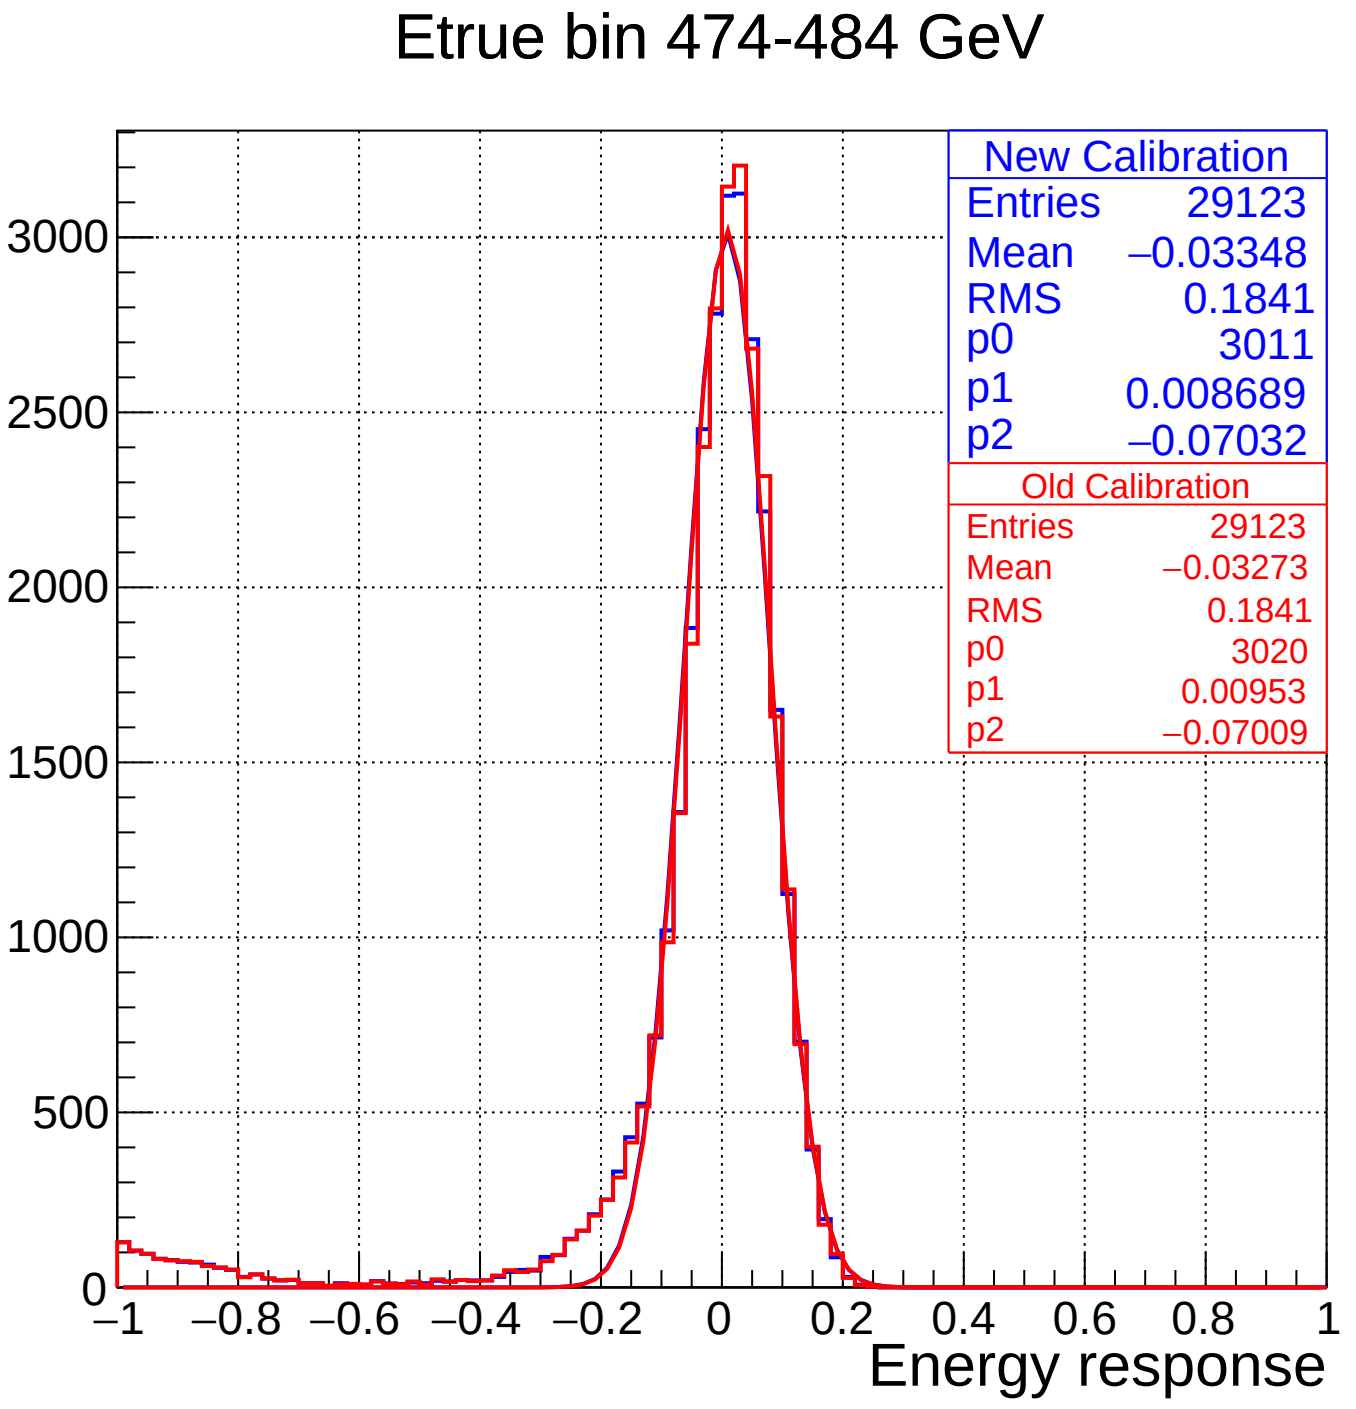
Etrue bin 474-484 GeV
New Calibration
Entries 29123
Mean –0.03348
RMS 0.1841
p0 3011
p1 0.008689
p2 –0.07032
Old Calibration
Entries 29123
Mean –0.03273
RMS 0.1841
p0 3020
p1 0.00953
p2 –0.07009
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response