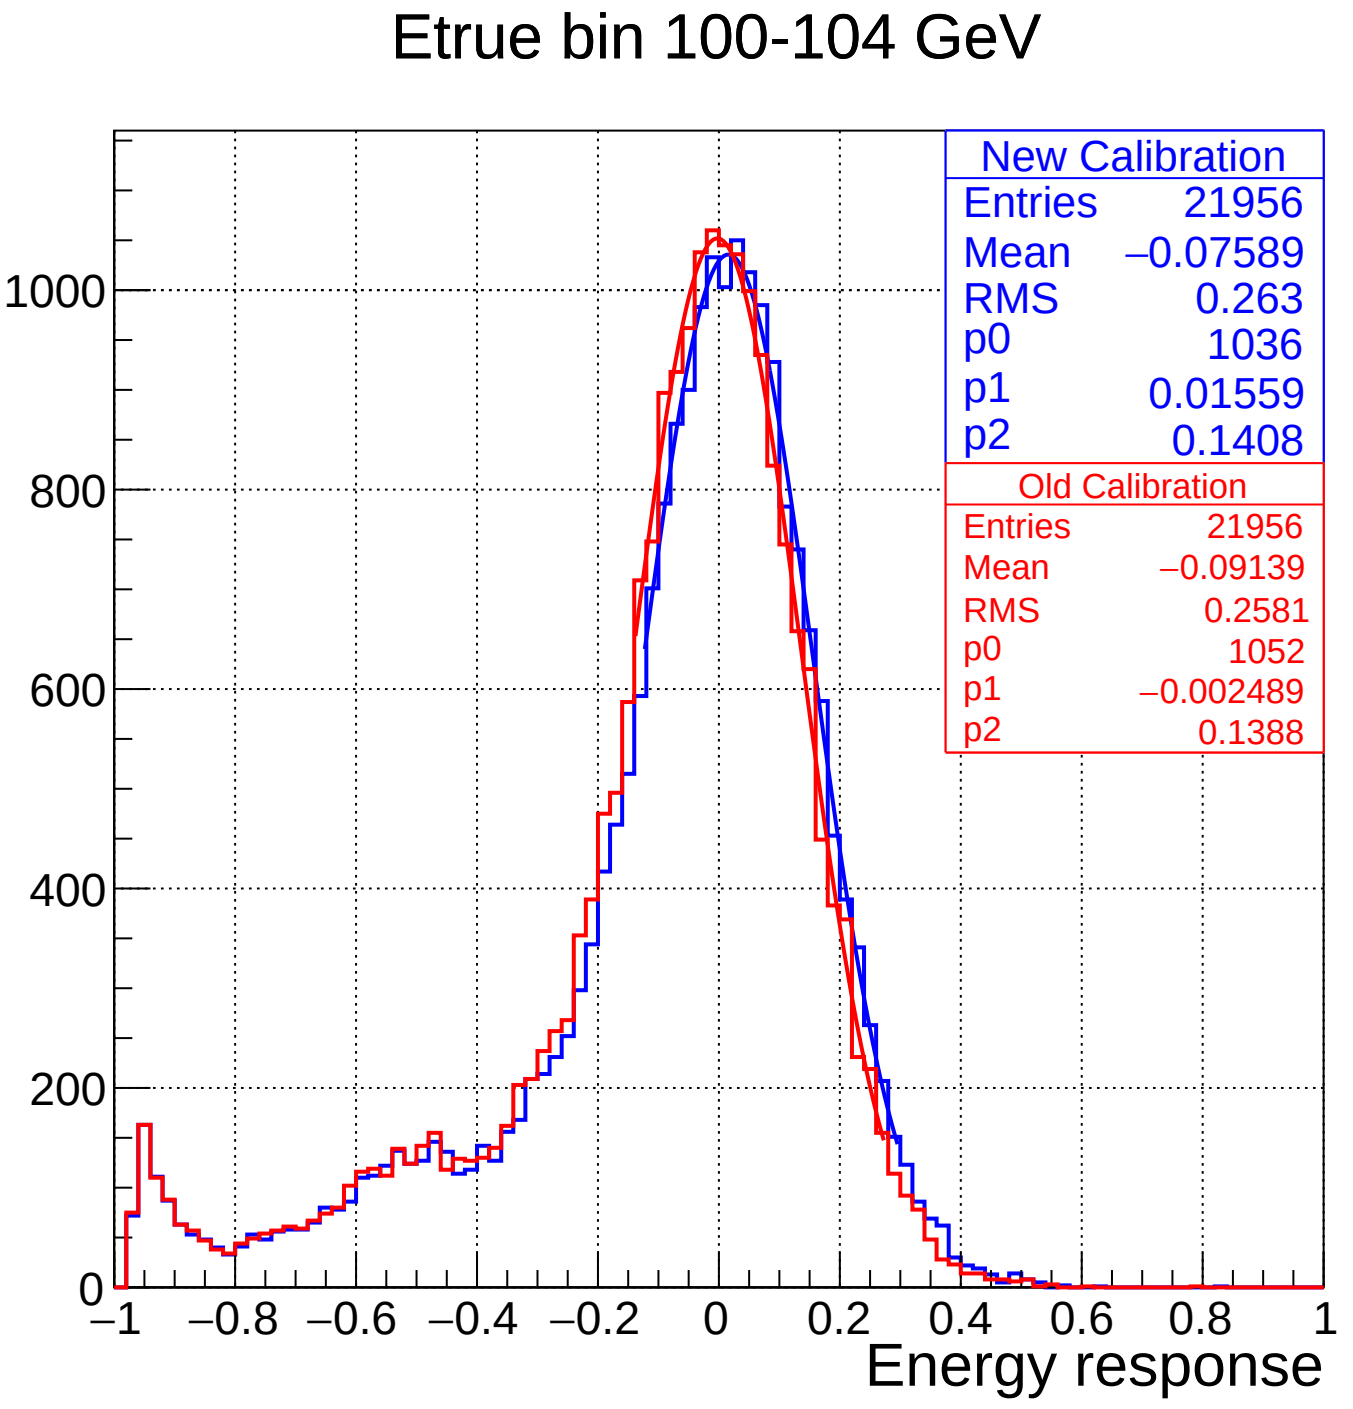
Etrue bin 100-104 GeV
New Calibration
Entries 21956
Mean –0.07589
RMS 0.263
p0 1036
p1 0.01559
p2 0.1408
Old Calibration
Entries 21956
Mean –0.09139
RMS 0.2581
p0 1052
p1 –0.002489
p2 0.1388
1000
800
600
400
200
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response