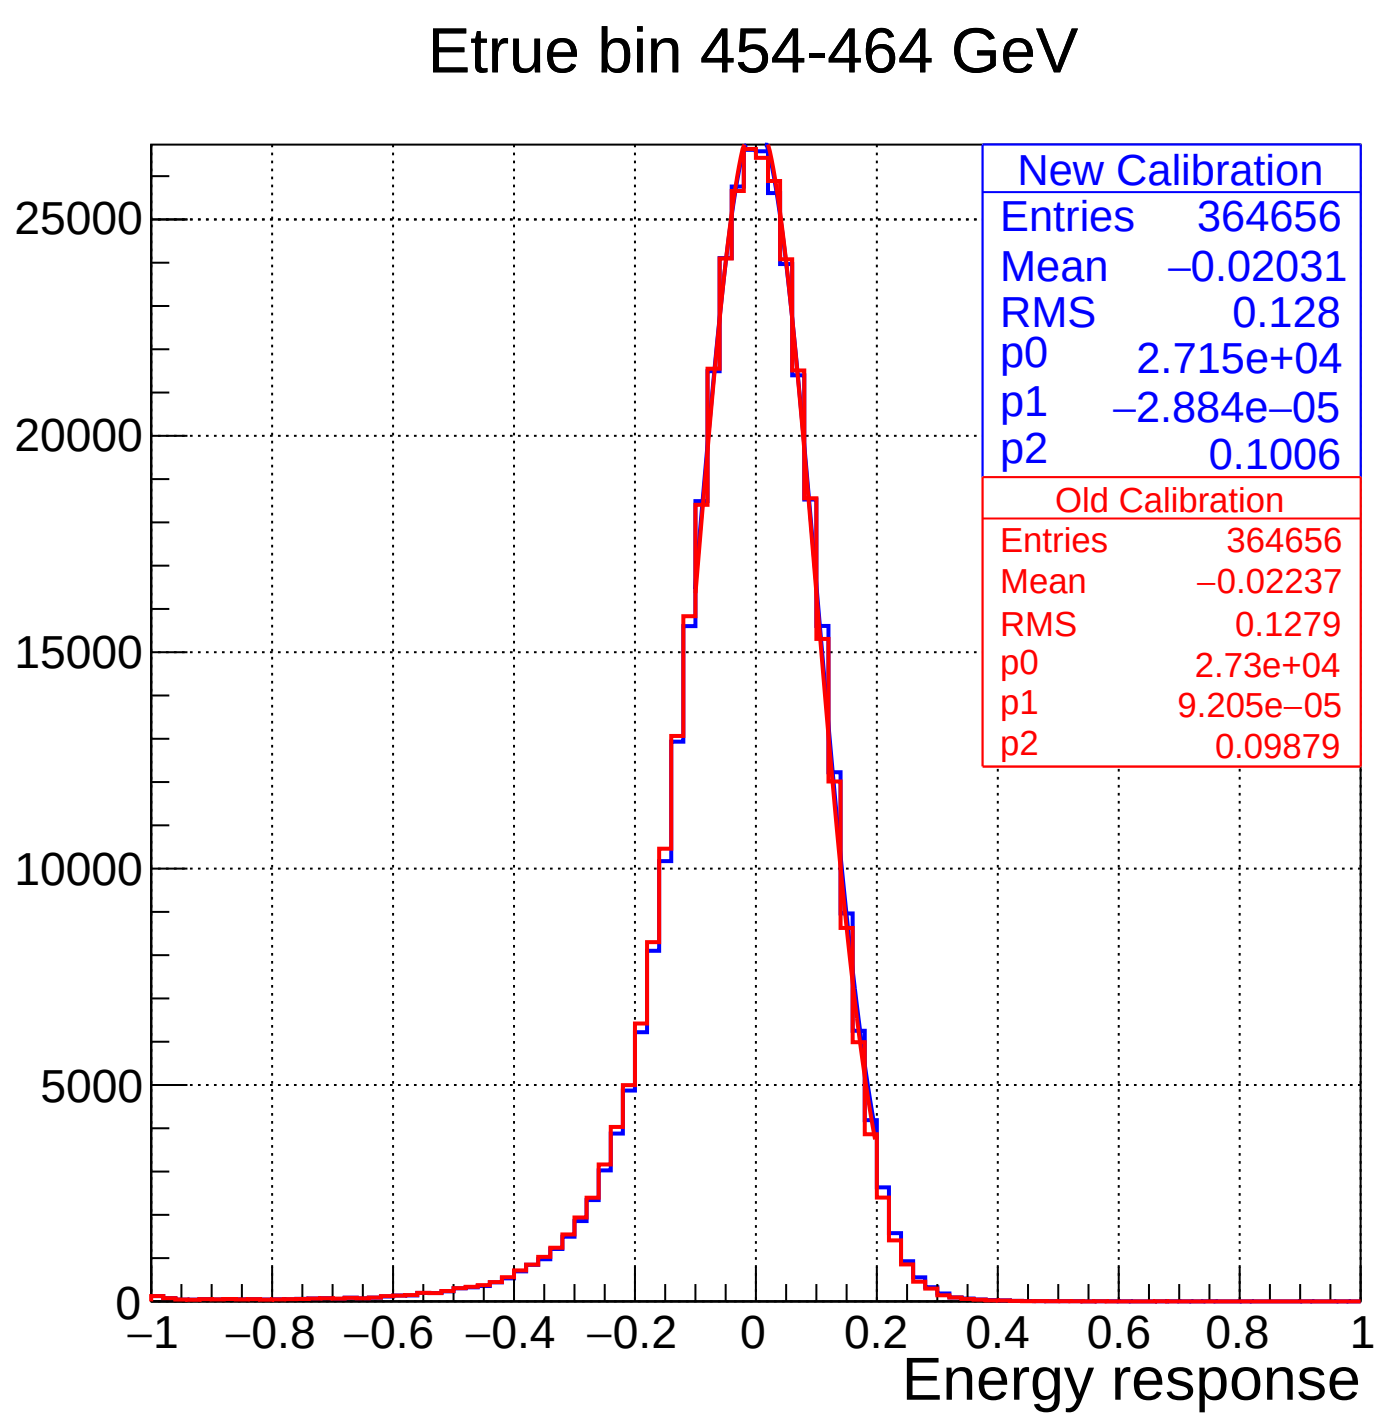
Etrue bin 454-464 GeV
New Calibration
Entries 364656
Mean –0.02031
RMS 0.128
p0 2.715e+04
p1 –2.884e–05
p2 0.1006
Old Calibration
Entries 364656
Mean –0.02237
RMS 0.1279
p0 2.73e+04
p1 9.205e–05
p2 0.09879
25000
20000
15000
10000
5000
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response