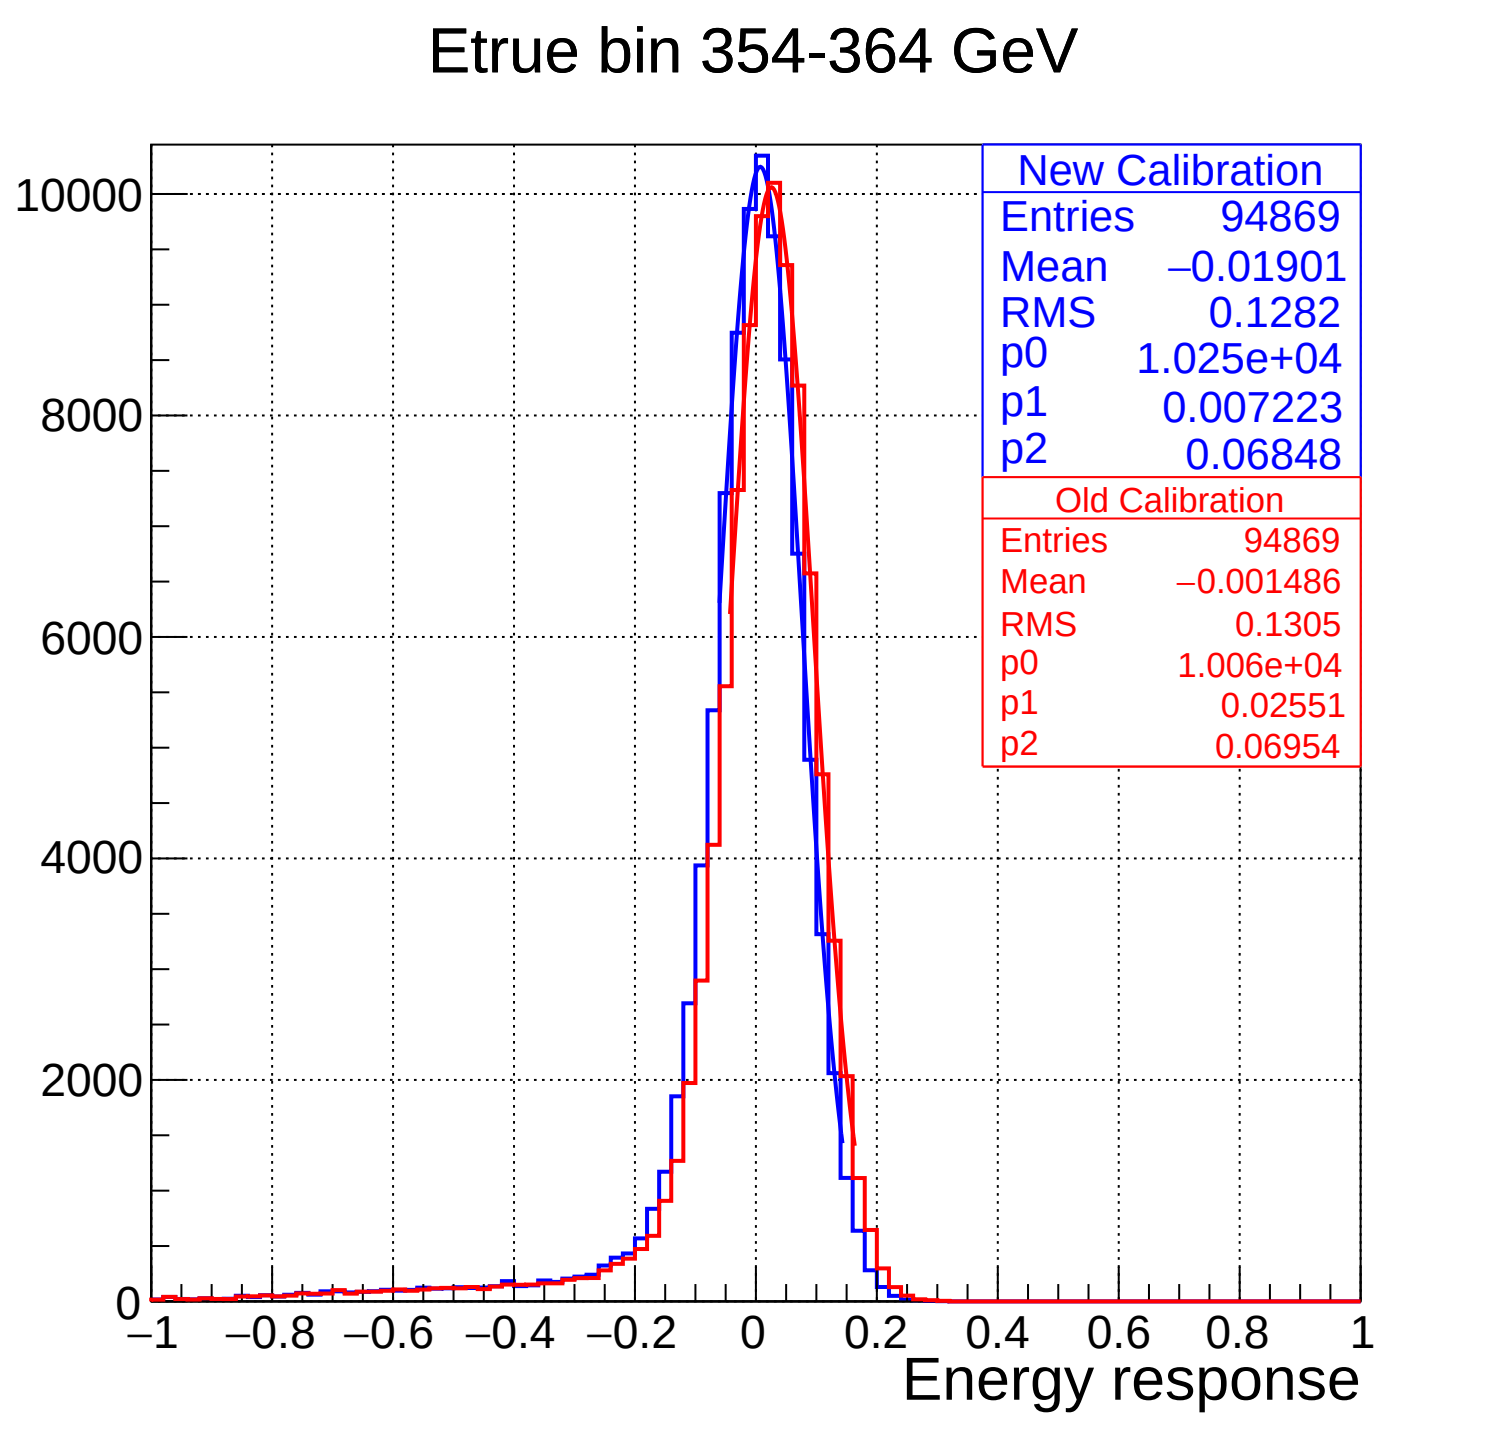
Etrue bin 354-364 GeV
New Calibration
Entries 94869
Mean –0.01901
RMS 0.1282
p0 1.025e+04
p1 0.007223
p2 0.06848
Old Calibration
Entries 94869
Mean –0.001486
RMS 0.1305
p0 1.006e+04
p1 0.02551
p2 0.06954
10000
8000
6000
4000
2000
0
–1
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Energy response