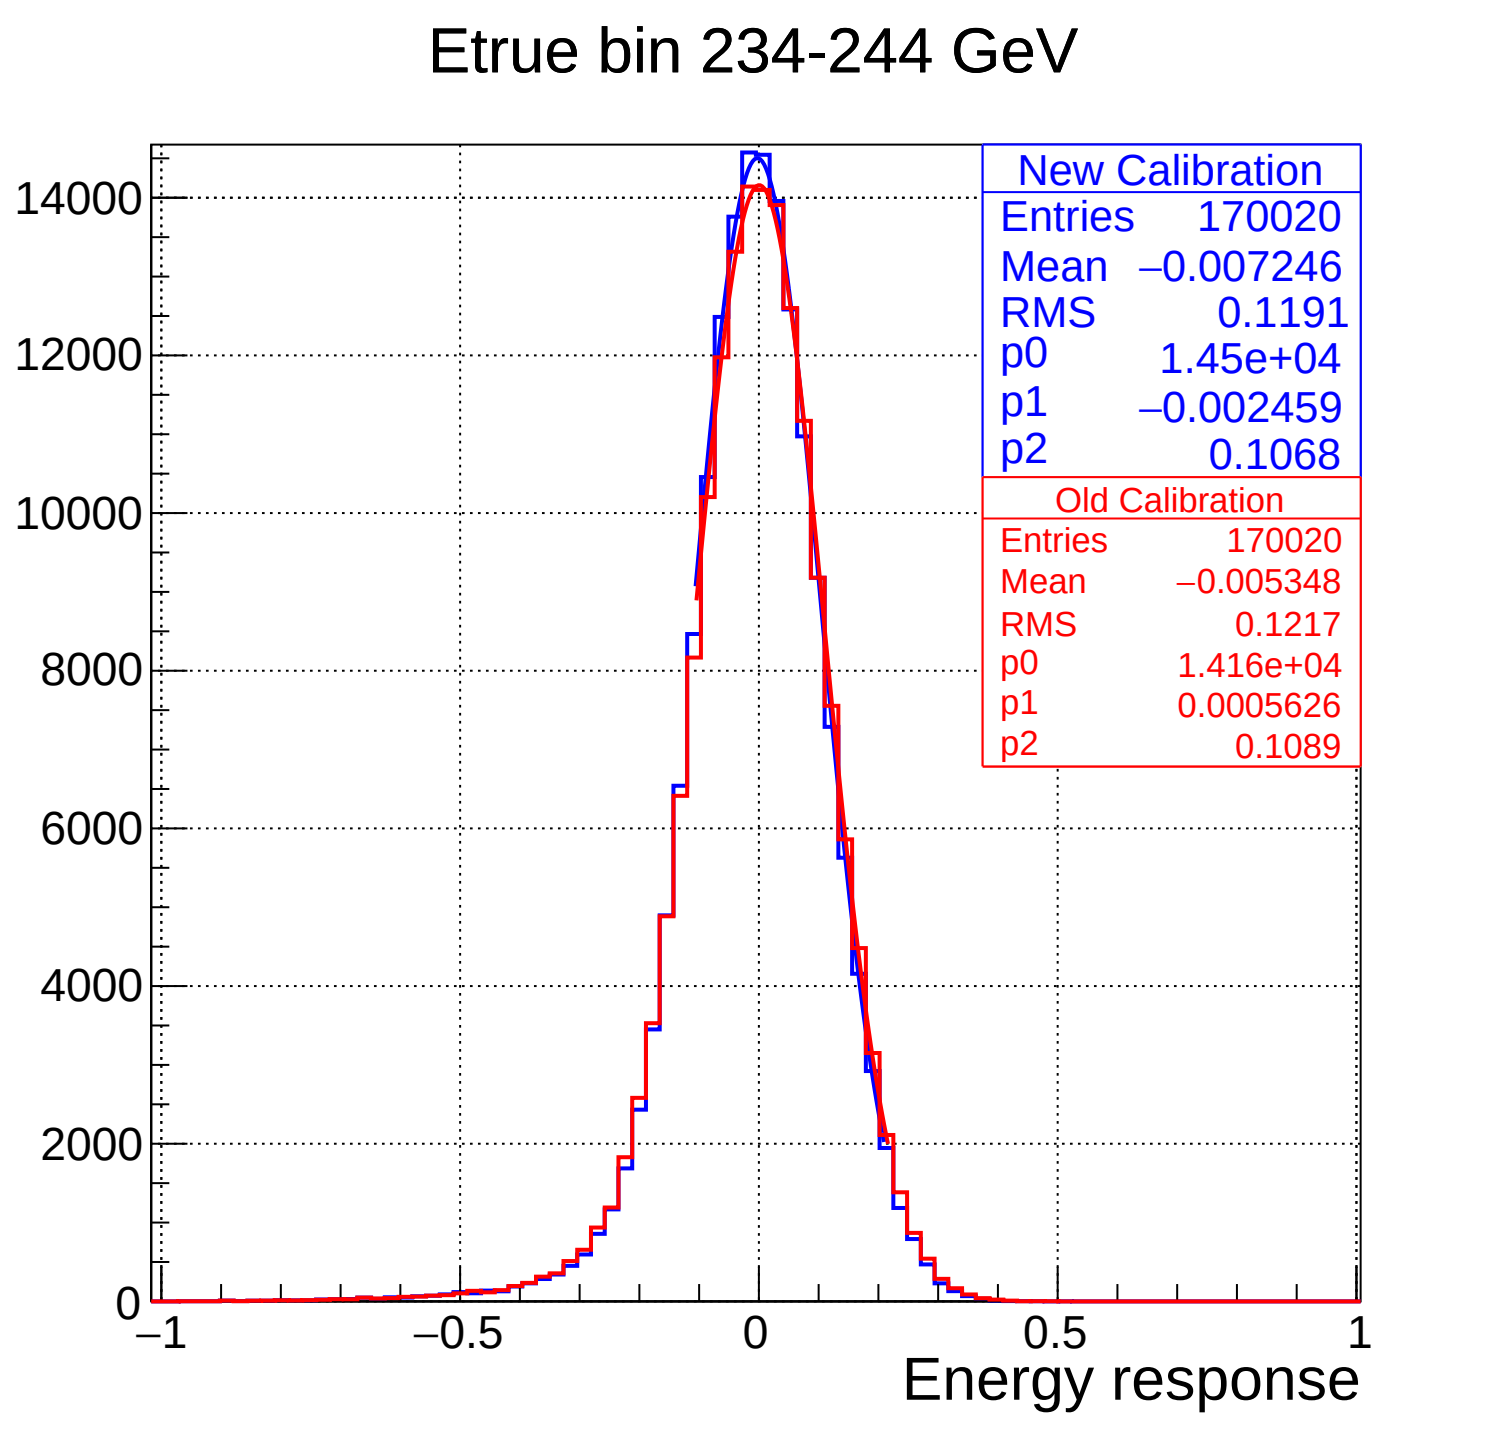
Etrue bin 234-244 GeV
New Calibration
Entries 170020
Mean −0.007246
RMS 0.1191
p0 1.45e+04
p1 −0.002459
p2 0.1068
Old Calibration
Entries 170020
Mean −0.005348
RMS 0.1217
p0 1.416e+04
p1 0.0005626
p2 0.1089
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
−1
−0.5
0
0.5
1
Energy response