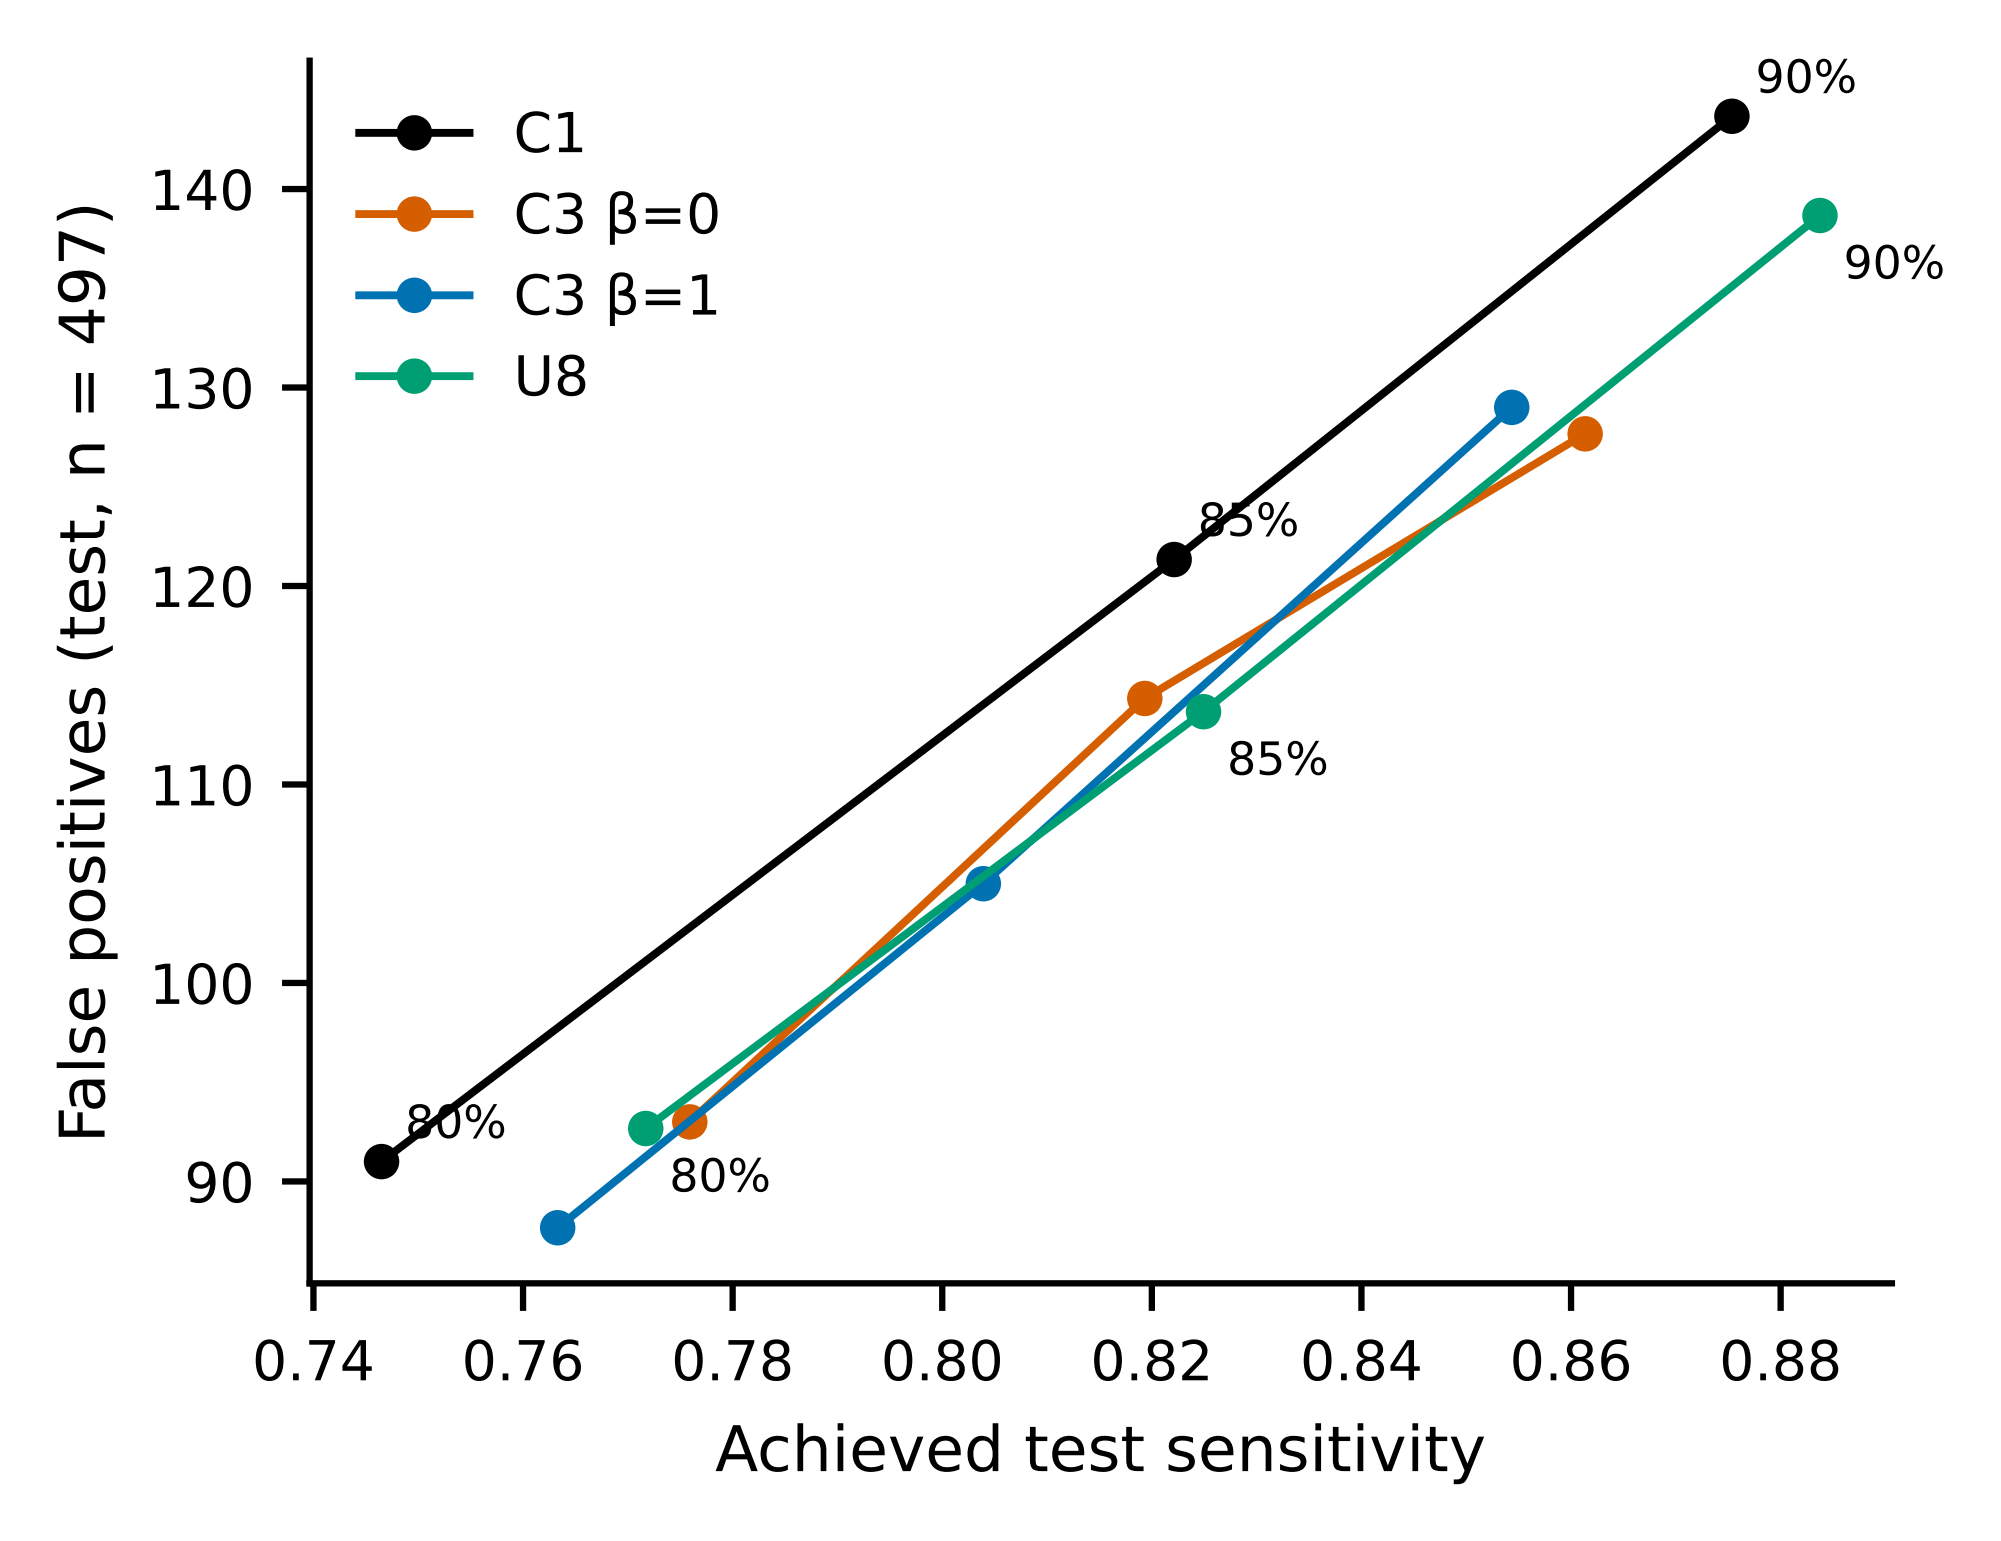
C1
C3 β=0
C3 β=1
U8
False positives (test, n = 497)
140
130
120
110
100
90
0.74
0.76
0.78
0.80
0.82
0.84
0.86
0.88
Achieved test sensitivity
80%
80%
85%
85%
90%
90%