




HOSPITAL EL ALTO SUR


ELECTROMEDICINA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

FORMULARIO DE FICHA TÉCNICA

Bomba de infusion

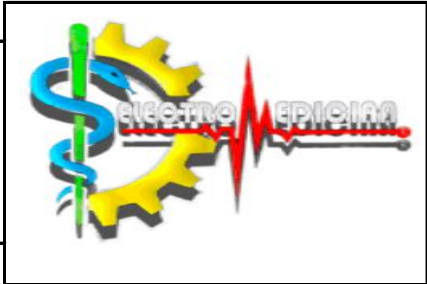

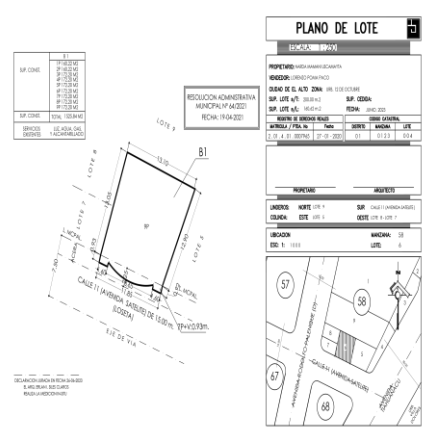DATOS DEL EQUIPO												
SERVICIO:	23123											
UBICACIÓN/ AREA:	231231											
MARCA:	HEPHO											
MODELO:	VG70											
SERIE/ COD. INT.	13243434235313462533											
PROCEDENCIA:	123123											
FABRICANTE:	1231											
GARANTIA:	Con Garantía											
DATOS PROVEEDOR:	123123											
CANTIDAD:	1											
AÑO FABRICACIÓN:	123123											
FECHA INSTALACIÓN:	2026-07-13											
DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO		TECNOLOGIA PREDOMINANTE		CATEGORIZACIÓN	I	II	III					
VOLTAJE:	POTENCIA REAL CONSUMIDA:	FRECUCENCIA DE RED:	PESO:	CORRIENTE:	PUERTOS PARA TRANSDUCTORES:	DIMENSIONES:	RESOLUCIÓN DEL MONITOR:	1	Intercambiabilidad			X
								2	Régimen operación			X
								3	Nivel de utilización			X
								4	Parámetro principal			X
								5	Mantenibilidad			X
EXISTENCIA DE INFORMACIÓN	Numeros de serie y codigos de activos fijos	COMPRAS:	COMODATOS:	DONACIONES:	FIJOS:	MOVILES:	PORTATILES:	6	Conservabilidad			X
								7	Grado de automatización	X		
								8	Valor de compra		X	
								9	Factibilidad apropto	X		
								10	Seguridad operacional	X		
11	Condiciones de explot.	X										
12	Protección de MA		X									
13	Edad del equipo		X									
				Categoría								

CONTEXTO OPERACIONAL	FUNCIONES DEL EQUIPO MEDICO	ACCIONES PREVENTIVAS	ACCIONES A REALIZAR SI EL FALLO NO SE PUEDE PREVENIR
FALLAS FUNCIONALES	CAUSAS DE FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTOS DEL FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTO DE FALLO DEL EQUIPO EN EL ENTORNO

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR	REVISADO POR