

N.




HOSPITAL EL ALTO SUR

ELECTROMEDICINA


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

FORMULARIO DE FICHA TÉCNICA

TA

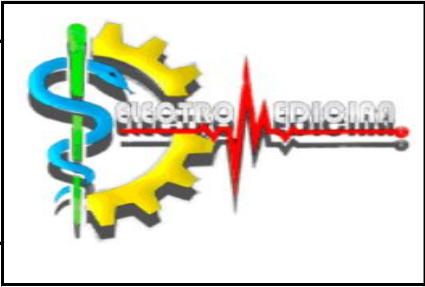

DATOS DEL EQUIPO			
UBICACIÓN:	Neo		
SERVICIO:	Neo		
MARCA:	Mindray		
MODELO:	vg600		
COD. ACTIVOS FIJOS:	FU Bajo		
PROCEDENCIA:	China		
FABRICANTE:	China		
GARANTIA:	Sin Garantía		
DATOS PROVEEDOR:	China		
SERIE:			
AÑO FABRICACIÓN:	2021		
FECHA INSTALACIÓN:	2026-06-08		

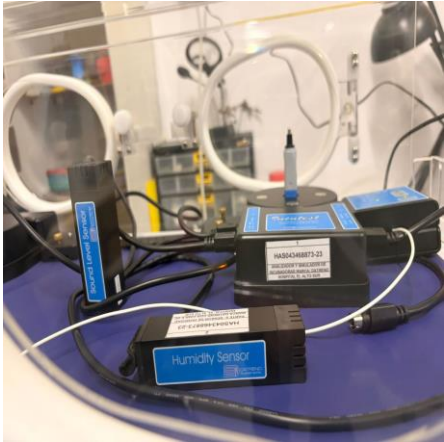

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO		TECNOLOGIA PREDOMINANTE		CATEGORIZACIÓN	I	II	III			
VOLTAJE: POTENCIA REAL CONSUMIDA: FRECUENCIA DE RED: PESO: CORRIENTE: PUERTOS PARA TRANSDUCTORES: DIMENSIONES: RESOLUCIÓN DEL MONITOR:	ELÉCTRICO:	☒	HIDRÁULICO:	☒	1	Intercambiabilidad			X	
	ELECTRÓNICO:	☒	NEUMÁTICO:	☐	2	Régimen operación			X	
	MECÁNICO:	☐	VAPOR:	☐	3	Nivel de utilización			X	
	TIPO ADQUISICIÓN		TIPO DE EQUIPO		4	Parámetro principal			X	
	COMPRA:	☒	FIJO:	☒	5	Mantenibilidad			X	
	COMODATO:	☐	MOVIL:	☒	6	Conservabilidad			X	
	DONACIÓN:	☐	PORTATIL:	☐	7	Grado de automatización			X	
	EXISTENCIA DE REPUESTOS				8	Valor de compra			X	
	1	mio			9	Factibilidad apropto			X	
	2				10	Seguridad operacional			X	
	3				11	Condiciones de explot.			X	
	4				12	Protección de MA			X	
	5				13	Edad del equipo			X	
				Categoría						

CONTEXTO OPERACIONAL	FUNCIONES DEL EQUIPO MEDICO	ACCIONES PREVENTIVAS	ACCIONES A REALIZAR SI EL FALLO NO SE PUEDE PREVENIR

FALLAS FUNCIONALES	CAUSAS DE FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTOS DEL FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTO DE FALLO DEL EQUIPO EN EL ENTORNO

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR	REVISADO POR