




HOSPITAL EL ALTO SUR


ELECTROMEDICINA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

FORMULARIO DE FICHA TÉCNICA

Bomba de infusion

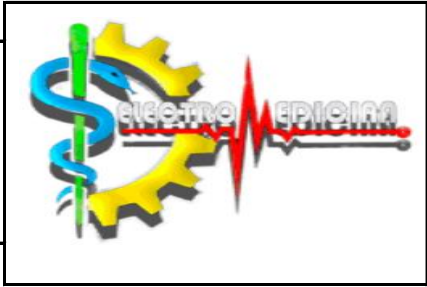

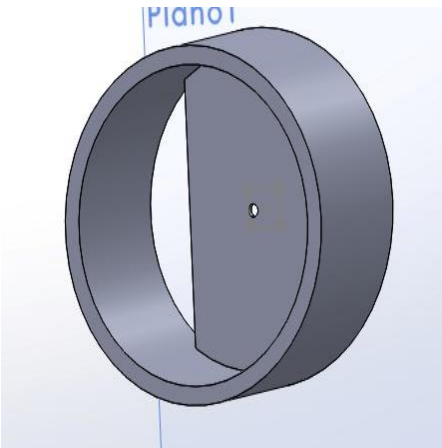DATOS DEL EQUIPO									
UBICACIÓN:	Oncología								
SERVICIO:	Oncoooo								
MARCA:	HEPHO								
MODELO:	VG70								
COD. ACTIVOS FIJOS:	HAso1231251								
PROCEDENCIA:	China								
FABRICANTE:	China								
GARANTIA:	Sin Garantía								
DATOS PROVEEDOR:	Chino								
SERIE:	98767698864								
AÑO FABRICACIÓN:	2021								
FECHA INSTALACIÓN:	2026-07-14								
DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO		TECNOLOGIA PREDOMINANTE		CATEGORIZACIÓN	I	II	III		
VOLTAJE: POTENCIA REAL CONSUMIDA: FRECUENCIA DE RED: PESO: CORRIENTE: PUERTOS PARA TRANSDUCTORES: DIMENSIONES: RESOLUCIÓN DEL MONITOR:	ELÉCTRICO:	☒	HIDRÁULICO:	☐	1	Intercambiabilidad			X
					2	Régimen operación			X
	ELECTRÓNICO:	☐	NEUMÁTICO:	☐	3	Nivel de utilización			X
					4	Parámetro principal			X
	MECÁNICO:	☒	VAPOR:	☐	5	Mantenibilidad			X
					6	Conservabilidad			X
					7	Grado de automatización			X
EXISTENCIA DE REPUESTOS		TIPO ADQUISICIÓN	TIPO DE EQUIPO	8	Valor de compra			X	
1	Cable	COMPRA:	☐	FIJO:	☐	9	Factibilidad apropto		X
2	Bateria	COMODATO:	☒	MOVIL:	☒	10	Seguridad operacional		X
3		DONACIÓN:	☐	PORTATIL:	☐	11	Condiciones de explot.		X
4						12	Protección de MA		X
5						13	Edad del equipo		X

CONTEXTO OPERACIONAL	FUNCIONES DEL EQUIPO MEDICO	ACCIONES PREVENTIVAS	ACCIONES A REALIZAR SI EL FALLO NO SE PUEDE PREVENIR
FALLAS FUNCIONALES	CAUSAS DE FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTOS DEL FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTO DE FALLO DEL EQUIPO EN EL ENTORNO

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR	REVISADO POR