

N.




HOSPITAL EL ALTO SUR

ELECTROMEDICINA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

FORMULARIO DE FICHA TÉCNICA

Bomba de infusion

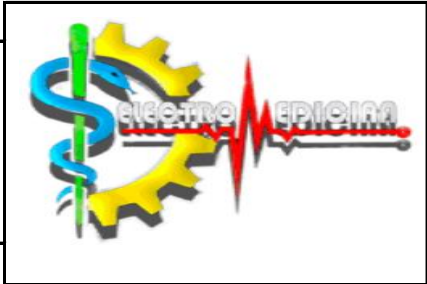

DATOS DEL EQUIPO									
UBICACIÓN:	Oncología								
SERVICIO:	Oncología								
MARCA:	HEPHO								
MODELO:	VG70								
COD. ACTIVOS FIJOS:	Hsao2111								
PROCEDENCIA:	China								
FABRICANTE:	China								
GARANTIA:	Con Garantía								
DATOS PROVEEDOR:	Chino								
SERIE:	98946548765								
AÑO FABRICACIÓN:	2024								
FECHA INSTALACIÓN:	2026-07-14								
DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO		TECNOLOGIA PREDOMINANTE		CATEGORIZACIÓN	I	II	III		
VOLTAJE: POTENCIA REAL CONSUMIDA: FRECUENCIA DE RED: PESO: CORRIENTE: PUERTOS PARA TRANSDUCTORES: DIMENSIONES: RESOLUCIÓN DEL MONITOR:	ELÉCTRICO:	☒	HIDRÁULICO:	☐	1	Intercambiabilidad			X
	ELECTRÓNICO:	☒	NEUMÁTICO:	☐	2	Régimen operación		X	
	MECÁNICO:	☐	VAPOR:	☐	3	Nivel de utilización	X		
	TIPO ADQUISICIÓN		TIPO DE EQUIPO		4	Parámetro principal	X		
	COMPRA:	☐	FIJO:	☒	5	Mantenibilidad		X	
	COMODATO:	☒	MOVIL:	☐	6	Conservabilidad		X	
	DONACIÓN:	☐	PORTATIL:	☐	7	Grado de automatización		X	
EXISTENCIA DE REPUESTOS				8	Valor de compra		X		
1	Bateria			9	Factibilidad aprovtto		X		
2	Cable			10	Seguridad operacional	X			
3				11	Condiciones de explot.	X			
4				12	Protección de MA	X			
5				13	Edad del equipo	X			
				Categoría					

CONTEXTO OPERACIONAL	FUNCIONES DEL EQUIPO MEDICO	ACCIONES PREVENTIVAS	ACCIONES A REALIZAR SI EL FALLO NO SE PUEDE PREVENIR
FALLAS FUNCIONALES	CAUSAS DE FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTOS DEL FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTO DE FALLO DEL EQUIPO EN EL ENTORNO

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR	REVISADO POR