

N.




HOSPITAL EL ALTO SUR

ELECTROMEDICINA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

FORMULARIO DE FICHA TÉCNICA

Autoclave

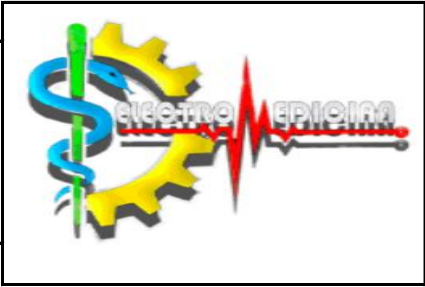

DATOS DEL EQUIPO											
UBICACIÓN:	Especialidades Clínicas										
SERVICIO:	asdasd										
MARCA:	Jibimed										
MODELO:	YX-24LD										
COD. ACTIVOS FIJOS:	asdqddsqdwdab 1										
PROCEDENCIA:	asdasd										
FABRICANTE:	asdasdasda										
GARANTIA:	Sin Garantía										
DATOS PROVEEDOR:	dsdasda										
SERIE:	asdas										
AÑO FABRICACIÓN:	sdadasd										
FECHA INSTALACIÓN:	2026-07-14										
DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO		TECNOLOGIA PREDOMINANTE		CATEGORIZACIÓN	I	II	III				
VOLTAJE: POTENCIA REAL CONSUMIDA: FRECUENCIA DE RED: PESO: CORRIENTE: PUERTOS PARA TRANSDUCTORES: DIMENSIONES: RESOLUCIÓN DEL MONITOR:	ELÉCTRICO:	☐	HIDRÁULICO:	☐	1	Intercambiabilidad			X		
					2	Régimen operación			X		
	ELECTRÓNICO:	☒	NEUMÁTICO:	☐	3	Nivel de utilización			X		
					4	Parámetro principal			X		
	MECÁNICO:	☐	VAPOR:	☐	5	Mantenibilidad			X		
					6	Conservabilidad			X		
					7	Grado de automatización			X		
					8	Valor de compra			X		
					9	Factibilidad apropto			X		
					10	Seguridad operacional			X		
EXISTENCIA DE REPUESTOS	COMPRA:	☐	FIJO:	☐	11	Condiciones de explot.			X		
1					12	Protección de MA			X		
2	COMODATO:	☒	MOVIL:	☒	13	Edad del equipo			X		
3					Categoría						X
4	DONACIÓN:	☐	PORTATIL:	☐							
5											

CONTEXTO OPERACIONAL	FUNCIONES DEL EQUIPO MEDICO	ACCIONES PREVENTIVAS	ACCIONES A REALIZAR SI EL FALLO NO SE PUEDE PREVENIR
FALLAS FUNCIONALES	CAUSAS DE FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTOS DEL FALLO EN EL EQUIPO	EFFECTO DE FALLO DEL EQUIPO EN EL ENTORNO

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR	REVISADO POR